Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

# Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

**Сборник методических указаний**
**МУК 4.1.1575—4.1.1614—03**

**Выпуск 38**

**Москва • 2003**

gost.e-ecolog.ru

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

# Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

**Сборник методических указаний**
**МУК 4.1.1575—4.1.1614—03**

**Выпуск 38**

ББК 51.21
И37

И37 **Измерение** концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник методических указаний. Вып. 38—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003.—198 с.

Настоящий сборник содержит копии оригиналов методических указаний по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (МУК 4.1.1575—4.1.1614—03).

Утверждены Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации, Председателем Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко в июне 2003 г.

Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (сборник 38) разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фактических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) – санитарно-гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного контроля.

Включенные в данный сборник 40 методик контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».

Методики выполнены с использованием современных методов исследования, метрологически аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических веществ на уровне и меньше их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны установленных в ГН 2.2.5.686—98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.687—98 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

**ББК 51.21**

**© Минздрав России, 2003**
**© Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003**

МУК 4.1.1594-03

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Министра
здравоохранения Российской Федерации
Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации
_____ Г.Г.Онищенко
29 июня 2003 г.
МУК 4.1.1594-03
Дата введения: с момента утверждения

4.1. Методы контроля. Химические факторы

# Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилметакрилата в воздухе рабочей зоны с применением для отбора проб пассивных дозиметров Р-1

$CH_2 = C(CH_3)COOCH_3$ М.м. 100,12

$C_5H_8O_2$

Метилметакрилат (метиловый эфир метакриловой кислоты, метакриловометиловый эфир) — бесцветная жидкость, $T_{кип.}$ 100°С, давление паров 35 мм рт.ст. (20°С), плотность 0,94; растворяется в воде 1,5% (30°С). смешивается во всех соотношениях со спиртом. В воздухе находится в виде паров. Наркотик. Раздражающее действие сравнительно слабое. Вызывает легкий дерматит и слабый конъюнктивит. ПДК — 10,0 мг/м$^3$.

---

* Методика применяется для определения среднесменных концентраций ММА в воздухе рабочей зоны

# МУК 4.1.

*Характеристика метода*

Метод основан на использовании газожидкостной хроматографии с применением пламенно-ионизационного детектора. Отбор проб с концентрированием на твердый сорбент.

Нижний предел измерения содержания вещества — 0,047 мкг в хроматографируемом объеме.

Нижний предел измерения концентрации вещества в воздухе — 0,24 мг/м$^3$ (при экспозиции пассивных дозиметров в течение 6 ч.).

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе — от 0,24 до 28,7 мг/м$^3$ (шкалы электрометра по току 100 х $10^{-12}$А и 10 х $10^{-10}$А).

Измерению не мешают акриловая и метакриловая кислоты.

Суммарная погрешность измерения не превышает ±15,0%.

Время выполнения измерения, включая отбор проб, — 6 ч 15 мин.

*Приборы, аппаратура, посуда*

Пассивный дозиметр, размеры и схема которого приведены на рис. 1. Приложение 3. Дозиметр имеет вид цилиндра и складывается из 3-х частей, изготовленных из дюраля, которые соединены друг с другом нарезкой. Дозиметр имеет внешний диаметр 1,9 см и высоту 2,5 см.

Хроматограф «Цвет» — 100 с ДИП

Хроматографическая набивная колонка 200х0,3 см

Секундомер, ГОСТ 5042-79

Лупа измерительная, ГОСТ 3309-76

Вакуумный насос ВН-46М

Трубка-концентратор из спецстали I34х 4 мм, см. рис. 2. Приложение 4.

Газометр стеклянный, вместимостью 20л
Шприцы вместимостью 5 мл и 150 мл, ГОСТ 8503-77
Чашка фарфоровая, ГОСТ 8147-80Е
Весы аналитические МДВ - 200М, ТУ 2506. 1131-76.
Микрошприц МШ-10, ТУ 2.88 3106

Реактивы, растворы, материалы

Метилметакрилат, ТУ ВП- 145-68
Этиловый спирт, ГОСТ 5963-67
Целит 545, зер. 60-80мм, твердый носитель для хроматографии
Диоктилсебацинат, чда, жидкая фаза ( 2,5% от массы целита )
Себациновая кислота, ч., жидкая фаза ( 2,5% от массы носителя)
Силохром -80, зер. 0,25-0,5мм, ТУ-6-09-17-48-74
Полиметилсилоксан ПМС-100, жидкая фаза (5% от массы силохрома 80 ).
Газообразные азот, ГОСТ 9292-74; водород, ГОСТ 3022-77, в баллонах с редукторами.
Воздух от компрессора СО -7А
Парогазовая смесь ММА с воздухом готовится введением 1 мкл ММА в газометр вместимостью 20л. Расчетная концентрация ММА-47,0мг/м$^3$
Бумажные фильтры "Красная лента".

## Отбор проб воздуха

Для отбора пробы камеру для сорбента в пассивном дозиметре заполняют сорбентом 5% ПМС-100 на силохроме-80 (навеска - 30 мг), закрывают мембраной- бумажным фильтром, навинчивают диффузную камеру, которую снова закрывают мембраной и навинчивают крышку с диффузным отверстием.

Пассивные дозиметры, заполненные сорбентом, укрепляют на спецодежде работающих на уровне груди. Отбор проб проводят в течение 6ч. После окончания отбора верхнюю крышку дозиметра с отверстием заменяют крышкой без отверстия. Срок хранения проб 1 сутки.

## Подготовка к измерению

Чистую хроматографическую колонку заполняют приготовленной хроматографической насадкой 10% диоктилсебацината + 2,5% себациновой кислоты на целите 545 с помощью вакуумного насоса. Колонку помещают в термостат хроматографа и, не соединяя ее с детектором, кондиционируют в токе газа-носителя в течение 12ч при 100$^0$С, после чего колонку подсоединяют к детектору и устанавливают в термостате рабочую температуру.

МУК 4.1.

Подготовку хроматографа к работе проводят в соответствии с инструкцией. Для построения градуировочного графика из газометра с парагазовой смесью ММА ( с= 47 мг/м³) на трубку-концентратор, заполненную приготовленным сорбентом 5% ПМС-100 на силохроме-80 (навеска 30мг), вводят 1,5мл, 2мл, 2,5мл и 3 мл ПГС ММА с содержанием последнего от 0,047 мкг до 0,141 мкг и вводят в испаритель хроматографа на анализ с использованием шкалы электрометра $100x10^{-12}$А. Для анализа на шкале $10x10^{-10}$А отбирают 20мл, 30мл, 60мл, 90мл и 120мл ПГС с содержанием ММА от 0,94 мкг до 5,64 мкг. После отбора пробы ПГС трубку-концентратор вставляют в испаритель хроматографа для термодесорбции ММА. Предварительно из испарителя хроматографа вынимают направляющую трубку, вместо в нее снизу испарителя вставляют "пяту", изображенную на рис.2, в которую при термодесорбции ММА вводят трубку-концентратор через верхнее отверстие испарителя. После ввода трубки-концентратора испаритель быстро закрывают.

На основе полученных хроматограмм строят градуировочный график зависимости площади пика ( S, см² ) от количества введенного вещества (мкг).

Построение градуировочного графика осуществляют по 5-ти точкам, проводя пять параллельных измерений для каждой концентрации. Условия хроматографирования смеси и анализируемых проб:

| | |
|---|---|
| температура термостата колонок | 60°С |
| температура испарителя | 150°С |
| скорость потока газа-носителя | 45,0 мл/мин |
| скорость потока водорода | 40,0 мл/мин |
| скорость потока воздуха | 400,0 мл/мин |
| скорость движения диаграммной ленты | 200,0 мм/час |
| время удерживания ММА | 5мин.06 сек. |

шкалы электрометра по току $100x10^{-12}$А и $10x10^{-10}$А

Проведение измерения

Сорбент с отобранной пробой из дозиметра пересыпают в трубку-концентратор, которую вводят в испаритель хроматографа для термодесорбции ММА. На полученной хроматограмме измеряют площадь пика и по градуировочному графику находят количество определяемого вещества.

Расчет концентрации

Концентрацию ММА в мг/м³ вычисляют по формуле:

$$C = \frac{M \cdot 10^3}{W_s \cdot \frac{A}{L} \cdot t \cdot D} \text{ мг/м}^3$$

где M - количество вещества в отобранной пробе, мкг

$W_s$ - выход дозиметра = 0,854

A - площадь сечения диффузной камеры = 0,196 см$^2$

L - длина камеры = 1,5 см

$\frac{A}{L}$ = 0,131 см

D- коэффициент диффузии 0,0812см$^2$/с

t - время экспозиции, с

МУК 4.I.

Приложение I

Приведение объёма воздуха к стандартным условиям (температура 20°С и давление 760 мм рт.ст.) проводят по формуле:

$$V_{20} = \frac{V_t \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t) \cdot 101{,}33}, \text{ где}$$

$V_t$ – объём воздуха, отобранный для анализа, л;

P – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 мм рт.ст.);

$t$ – температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчёта $V_{20}$ следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить $V_t$ на соответствующий коэффициент.


Приложение 2

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям

| °С | Давление Р, кПа/мм рт.ст. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97,33/ 730 | 97,66/ 734 | 98,4/ 738 | 98,93/ 742 | 99,46/ 746 | 100/ 750 | 100,53/ 754 | 101,06/ 758 | 101,33/ 760 | 101,86/ 764 |
| -30 | 1,1582 | 1,1646 | 1,1709 | 1,1772 | 1,1836 | 1,1899 | 1,1963 | 1,2026 | 1,2056 | 1,2122 |
| -26 | 1,1393 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1644 | 1,1705 | 1,1768 | 1,1831 | 1,1862 | 1,1925 |
| -22 | 1,1212 | 1,1274 | 1,1336 | 1,1396 | 1,1456 | 1,1519 | 1,1581 | 1,1643 | 1,1673 | 1,1735 |
| -18 | 1,1036 | 1,1097 | 1,1158 | 1,1216 | 1,1278 | 1,1338 | 1,1399 | 1,1460 | 1,1490 | 1,1551 |
| -14 | 1,0866 | 1,0926 | 1,0986 | 1,1045 | 1,1105 | 1,1164 | 1,1224 | 1,1284 | 1,1313 | 1,1373 |
| -10 | 1,0701 | 1,0760 | 1,0819 | 1,0877 | 1,0936 | 1,0994 | 1,1053 | 1,1112 | 1,1141 | 1,1200 |
| - 6 | 1,0540 | 1,0599 | 1,0657 | 1,0714 | 1,0772 | 1,0829 | 1,0887 | 1,0945 | 1,0974 | 1,1032 |
| - 2 | 1,0385 | 1,0442 | 1,0499 | 1,0556 | 1,0613 | 1,0669 | 1,0726 | 1,0784 | 1,0812 | 1,0869 |
| 0 | 1,0309 | 1,0366 | 1,0423 | 1,0477 | 1,0535 | 1,0591 | 1,0648 | 1,0705 | 1,0733 | 1,0789 |
| + 2 | 1,0234 | 1,0291 | 1,0347 | 1,0402 | 1,0459 | 1,0514 | 1,0571 | 1,0627 | 1,0655 | 1,0712 |
| + 6 | 1,0087 | 1,0143 | 1,0198 | 1,0253 | 1,0309 | 1,0363 | 1,0419 | 1,0475 | 1,0502 | 1,0557 |
| +10 | 0,9944 | 0,9999 | 0,0054 | 1,0108 | 1,0162 | 1,0216 | 1,0272 | 1,0326 | 1,0353 | 1,0407 |
| +14 | 0,9806 | 0,9860 | 0,9914 | 0,9967 | 1,0027 | 1,0074 | 1,0128 | 1,0183 | 1,0209 | 1,0263 |
| +18 | 0,9671 | 0,9725 | 0,9778 | 0,9830 | 0,9884 | 0,9936 | 0,9989 | 1,0043 | 1,0069 | 1,0122 |
| +20 | 0,9605 | 0,9658 | 0,9711 | 0,9763 | 0,9816 | 0,9868 | 0,9921 | 0,9974 | 1,0000 | 1,0053 |
| +22 | 0,9539 | 0,9592 | 0,9645 | 0,9696 | 0,9749 | 0,9800 | 0,9853 | 0,9906 | 0,9932 | 0,9985 |
| +24 | 0,9475 | 0,9527 | 0,9579 | 0,9631 | 0,9683 | 0,9735 | 0,9787 | 0,9839 | 0,9865 | 0,9917 |
| +26 | 0,9412 | 0,9464 | 0,9516 | 0,9566 | 0,9618 | 0,9669 | 0,9721 | 0,9773 | 0,9799 | 0,9851 |
| +28 | 0,9349 | 0,9401 | 0,9453 | 0,9503 | 0,9555 | 0,9605 | 0,9657 | 0,9708 | 0,9734 | 0,9785 |
| +30 | 0,9288 | 0,9339 | 0,9391 | 0,9440 | 0,9432 | 0,9542 | 0,9594 | 0,9645 | 0,9670 | 0,9723 |
| +34 | 0,9167 | 0,9218 | 0,9268 | 0,9318 | 0,9368 | 0,9418 | 0,9468 | 0,9519 | 0,9544 | 0,9595 |
| +36 | 0,9049 | 0,9099 | 0,9149 | 0,9199 | 0,9248 | 0,9297 | 0,9347 | 0,9397 | 0,9421 | 0,9471 |

Рисунок I

Пассивный дозиметр Р-I

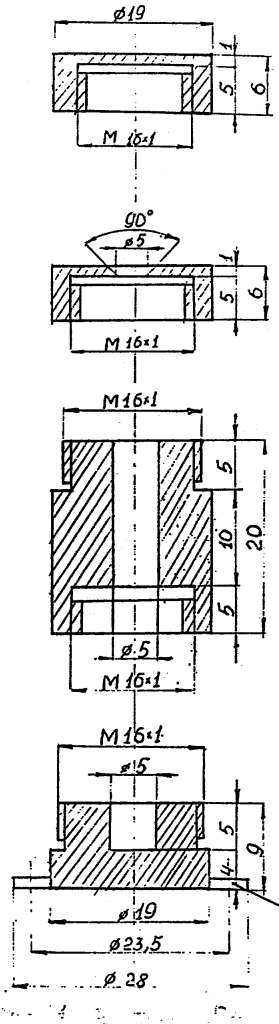


I - сплошная крышка


2- крышка с диффузным отверстием


3 - диффузная камера

4 - камера для сорбента

Рисунок 2


Устройство для концентрирования и ввода проб

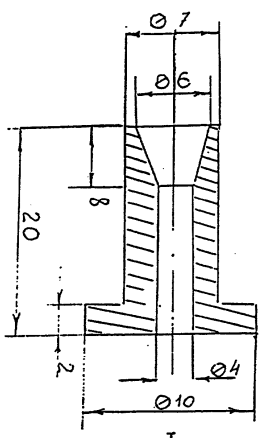

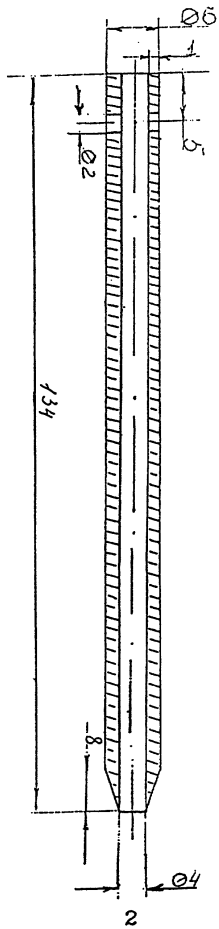
I-пята , 2-концентрационная трубка

Пассивный дозиметр Р-4

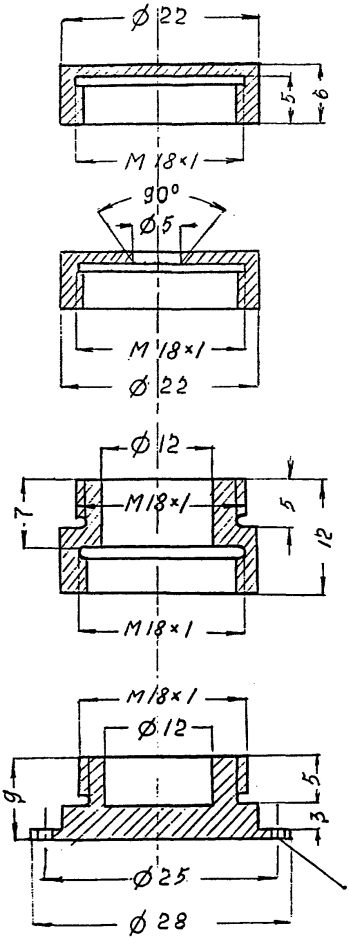


I – сплошная крышка
2 – крышка с диффузным отверстием
3 – диффузная камера
4 – камера для сорбента

Материал для изготовления дозиметра – дюраль или нержавеющая сталь.

Приложение 6.

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ.


| | Стр. |
|---|---|
| Белая магнезия | 87 |
| Бромгексин | 9 |
| Бура | I4I |
| Гидразинобензол солянокислый | I5I |
| Глибенкламид | I55 |
| Диэтиламинопропиламин | 77 |
| Иминодибензил | 30 |
| Лидокаин | 46 |
| Метаран | 50 |
| МЦ-I00 | I02 |
| Масло "Турбомас" | 73 |
| Неопентилгликоль | 68 |
| Нимодипин | 59 |
| Нитрендипин | 54 |
| Нитроглицерин | I3I |
| Оксипропилметилцеллюлоза | 2I |
| Ондансетрон | I45 |
| Ранитидин гидрохлорид | 35 |
| Реагент ААК или Таллактам | II8 |
| СМБА | I37 |
| Сульфаметоксазол | I2,I5 |
| Тамоксифен основание | 40 |
| Тамоксифен цитрата | 40 |
| Тиаприд | 82 |
| Триметоприм | 27 |
| Хладон-I4 | I48 |
| Ципрофлоксацин гидрохлорида моногидрат | I64 |
| Экосорб | I08 |
| Эналаприла малеат | I76 |
| Этиниловый спирт | I8I |

МУК 4.I.

Приложение 7.

Вещества, определяемые по ранее утверждённым Методическим указаниям по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

| Наименование вещества | Методические указания |
|---|---|
| I. Ароматизатор из мяты перечной I6433 | МУ по газохроматографическому измерению концентраций ментола (/ - 2-изопропил-5-метициклогексанола) в воздухе рабочей зоны. Вып.30. М. 2000, с.I89 , МУК 4.I.240-96. |
| 2. Ванадий-алюминиевая лигатура | Измерение концентрации ванадия методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Сб. "МУ по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле". М. I992 г., стр.67, МУ № 4945-88. |
| 3. Мультиинзимная композиция МЭК-СХ-I | МУ по спектрофотометрическому измерению концентраций амилазы в воздухе рабочей зоны. Вып. 38. |
| 4. Мультиинзимная композиция МЭК-СХ-2 | МУ по спектрофотометрическому измерению концентрации целлюлазы в воздухе рабочей зоны. Вып. 38. |
| 5. Опаспрей белый | МУ по газохроматографическому измерению метилового спирта в воздухе рабочей зоны. Вып.I9, М.I984, стр.I02, МУ |

| Наименование вещества | Методические указания |
|---|---|
| | № 2902-83. |
| 6. Опаспрей жёлтый | МУ по газохроматографическому измерению метилового спирта в воздухе рабочей зоны. Вып.I9, М.I984, стр.I02, МУ № 2902-83. |
| 7. Пыль периклазохромитовых и хромитопериклазовых огнеупорных изделий | МУ на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок. Вып.I-5, М.I98I, стр.235, МУ № I7I9-77. |
| 8. Хладон СМ-I | МУ по газохроматографическому измерению концентраций I,I,I,2--тетрафторэтана в воздухе рабочей зоны. Вып.35, МУК 4.I.860-99 утв. 30.I2.99 г. |
| 9. Биовит-I60 | МУ по фотометрическому измерению концентраций хлортетрациклина в воздухе рабочей зоны. Вып. II переработ., М.I992, стр.I49. № 5866-9I. |
| I0. М0624М смесь (смесь четвертичных аммониевых соединений) | МУ по фотометрическому измерению концентраций диалкилдиметиламмоний хлорида ($C_{I7}$-$C_{20}$) и алкилбензилдиметиламмоний хлорида ($C_{I0}$-$C_{I6}$)-дон-2, диалкилламинопропионитрила ($C_7$-$C_9$)-ибхангаз, алкилтриметиламмоний хлорида ($C_{I0}$-$C_{I6}$), дон-52 в воздухе рабочей зоны. Вып.25, М.,I989, стр.49,МУ№4905-88. |

Приложение 3.

Расчёт характеристик погрешности на основе данных, приведенных в НТИ ГХА.

| Приведено в НТИ | Принятые предположения | Расчёт составляющей погрешности |
|---|---|---|
| $\Delta$ (информация о структуре погрешности отсутствует) | $\Delta_c$ - незначимо | $\sigma(\hat{\Delta}) = \Delta / 1{,}96$ |

$\Delta$ - характеристика результатов ХХА (суммарная погрешность).

$\Delta_c$ - характеристика систематической составляющей погрешности.

$\sigma(\hat{\Delta})$ - характеристика случайной составляющей погрешности.

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВИ КХА.

| № | Алгоритм оперативного контроля | ВИД КОНТРОЛЯ | | Принятые обозначения |
|---|---|---|---|---|
| | | Внутренний оперативный контроль | Внешний контроль по схеме оперативного контроля | |
| 1 | С применением образцов для контроля (ОК) | $\lvert K_{кс}\rvert = \lvert X - C\rvert < K$ | | $K_{кс}$-результат контрольной процедуры; X-результат анализа пробы; C-аттестованное значение ОК, K-норматив оперативного контроля |
| | | $K = 0{,}84\,\Delta$ | $K = \Delta$ | |
| | | где $\Delta$ - характеристика погрешности, соответствующая содержанию компонента в ОК | | |
| 2 | С применением метода добавок | $\lvert K_{кс}\rvert = \lvert X' - X - C\rvert < K$ | | $K_{кс}$-результат контрольной процедуры; $\bar{X}$-результат анализа пробы без добавки; $\bar{X}'$-результат анализа пробы с добавкой; C-величина добавки K-норматив оперативного контроля |
| | | $K = 0{,}84\sqrt{(\Delta_{\bar{X}'})^2 + (\Delta_{\bar{X}})^2}$ | $K = \sqrt{(\Delta_{\bar{X}'})^2 + (\Delta_{\bar{X}})^2}$ | |
| | | где $\Delta_{\bar{X}'}$ ($\Delta_{\bar{X}}$) - характеристика погрешности, соответствующая содержанию компонента в пробе с добавкой (пробе без добавки) | | |
| 3 | С применением метода разбавления | $\lvert K_{кс}\rvert = \lvert KX' - X\rvert < K$ | | $X_{кс}$-результат контрольной процедуры; $\bar{X}$-результат анализа рабочей пробы; $\bar{X}'$-результат анализа разбавленной пробы K-коэффициент разбавления; K-норматив оперативного контроля |
| | | $K = 0{,}84\sqrt{R^2(\Delta_{\bar{X}'})^2 + (\Delta_{\bar{X}})^2}$, | $K = \sqrt{R^2(\Delta_{\bar{X}'})^2 + (\Delta_{\bar{X}})^2}$ | |
| | | где $\Delta_{\bar{X}'}$ ($\Delta_{\bar{X}}$) - характеристика погрешности, соответствующая содержанию компонента в разбавленной пробе (рабочей пробе) соответственно | | |
| 4 | С применением другой (контрольной) методики | $\lvert K_{кс}\rvert = \lvert X - X_{кс}\rvert < K$ | | $K_{кс}$-результат контрольной процедуры; $\bar{X}$ - результат анализа пробы по контролируемой методике анализа; $X_{кс}$ - результат анализа пробы по контрольной методике анализа; K-норматив оперативного контроля |
| | | $K = 0{,}84\sqrt{(\Delta_{\bar{X}_{кс}})^2 + (\Delta_{\bar{X}})^2}$ | $K = \sqrt{(\Delta_{\bar{X}_{кс}})^2 + (\Delta_{\bar{X}})^2}$ | |
| | | где $\Delta_{\bar{X}_{кс}}$ ($\Delta_{\bar{X}}$) - характеристика контрольной (контролируемой) методики, соответствующая содержанию компонента в пробе | | |

Оперативный контроль погрешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т.е. результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набора мерной посуды, одной партии реактивов и т.д.

Приложение 10.

## Расчёт норматива внутрилабораторного оперативного контроля (ВОК) воспроизводимости КХА ХХА.

ВОК воспроизводимости проводят с использованием рабочих проб путём сравнения результата контрольной процедуры, равного расхождению двух результатов ХХА ($x_1$ и $x_2$) содержания компонента в одной и той же пробе, с нормативом ВОК воспроизводимости Д.

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 \leqslant Д.$$

Норматив ВОК воспроизводимости рассчитывают по формуле:

$$Д = Q(P, m)\,\sigma(\Delta)$$

где $\sigma(\Delta)$ – показатель воспроизводимости (характеристика случайной составляющей погрешности, соответствующая среднему содержанию компонента в пробе):

$$\bar{x}_{ср} = \frac{\bar{x}_1 + \bar{x}_2}{2},$$

$Q(P, m) = 2{,}77$ при $m = 2$, $P = 0{,}95$.

При осуществлении ВОК воспроизводимости отбирают две пробы, объём которых равен объёму, необходимому для проведения анализа по методике, и анализируют в точном соответствии с прописью методики, максимально варьируя условия проведения анализа, т.е. получают два результата анализа, используя разные наборы мерной посуды, разные партии реактивов. В работе должны участвовать два аналитика.

При превышении норматива ВОК воспроизводимости эксперимент повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.

МУК 4.1.1575 —
4.1.1614 — 03

# СОДЕРЖАНИЕ


I. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации амилазы в воздухе рабочей зоны
( РГМУ, г.Москва ) МУК 4.1.1575 — 03 .... 3

2. Методические указания по измерению концентраций N -(2-амино-3,5-дибромбензил)-N-метилциклогексиламина гидрохлорида (бромгексина) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
( РГМУ, г.Москва ) МУК 4.1. 1576 — 03.... 9

3. Методические указания по измерению концентраций 4- амино-N -(5-метил-3-изоксазолил)-бензолсульфонамида (сульфаметоксазола) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
( РГМУ, г.Москва ) МУК 4.1.1577-03... I2

4. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 4-амино-N-(5-метил-3-изоксазолил)бензолсульфонамида (сульфаметоксазола) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1578 — 03 .... I5

5. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций гидроксипропилметилцеллюлозы (оксипропилметилцеллюлозы) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1579 — 03 .... 2I

6. Методические указания по измерению концентрации 2,4-диамино-5-(3',4',5'-триметоксибензил)-пиримидина (триметоприма) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
( РГМУ, г.Москва ) МУК 4.1. 1580 — 03 .... 27

7. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций [I0,II-дигидро-5-Н-дибенз (b ,f )] азепина (иминодибензила) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1581 — 03 .... 30

8. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций N- 2- [(5-(диметиламино)метил]-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитро-I,I-этилендиамина гидрохлорида (ранитидина гидрохлорида) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1582 — 03 .... 35

9. Методические указания по измерению концентраций 2 -[4 - (1,2-Дифенил-1-бутенил)ренокси] -N,N -диметилэтанамина- ( Z ) 2-гидрокси - 1,2,3 - пропантрикарбоксилата (тамоксифен цитрат и 2 - [4 - ( 1,2 - Дифенил-1-бутенил)фенокси] -N,N -диметил-этанамина (тамоксифен основания) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
( ВНЦ ЗАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1583 – 03... 40

10. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2,6-диметил-N-диэтиламиноацетанилида гидрохлорида (лидокаина) в воздухе рабочей зоны
( Латвийская медицинская академия, г.Рига ) МУК 4.1.1584-03... 45

11. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 0,0-диметилметилфосфоната (метаран) в воздухе рабочей зоны
(СЭС, г.Волгоград) МУК 4.1.1585-03... 50

12. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2,6-диметил-3-метоксикарбонил-4-(3-нитрофенил)-5-этоксикарбонил-1,4-дигидропиридина (нитрендипина) в воздухе рабочей зоны
( НИИ ГТ и ПЗ, г.Санкт-Петербург ) МУК 4.1.1586-03.... 54

13. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2,6-диметил-3-(2 метоксиэтоксикарбонил)-4-(3-нитрофенил)-5-изопропоксикарбонил-1,4-дигидропиридина (нимодипина) в воздухе рабочей зоны
( НИИ ГТ и ПЗ, г.Санкт-Петербург ) МУК 4.1.1587-03... 59

14. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диметилового эфира в воздухе рабочей зоны
( УкрНИИгинтокс, г.Киев ) МУК 4.1.1588-03.... 64

15. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 2,2-диметил-пропандиола-1,3 (неопентилгликоля) в воздухе рабочей зоны
( НПЦ "Экос", г.Москва) МУК 4.1.1589-03... 68

16. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций дифенил - (п-третбутилфенил)фосфата (основного компонента масла "Турбомас") в воздухе рабочей зоны
( НИИ ГТ и ПЗ, г.Санкт-Петербург ) МУК 4.1.1590-03 73

МУК 4.1.1575-4.1.1614-03

17. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 3-диэтиламино-пропил-амина-I (диэтиламинопропиламина) в воздухе рабочей зоны
( НПЦ "Экос", г.Москва ) МУК 4.1.1591-03 .... 77

18. Методические указания по экстракционно-фотометрическому измерению концентраций N-[2-(диэтиламино)-этил] -2-метокси-5-(метилсульфонил)-бензамида гидрохлорида (тиаприд) в воздухе рабочей зоны
( НИХФИ, г.Новокузнецк ) МУК 4.1.1592-03 .... 82

19. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций магния углекислого основного (белая магнезия) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1593-03 .... 87

20. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилметакрилата в воздухе рабочей зоны с применением для отбора пассивных дозиметров Р-I МУК 4.1.1594-03
(Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии г.Н-Новгород)....92

21. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилметакрилата в воздухе рабочей зоны с применением для отбора пассивных дозиметров Р-4 МУК 4.1.1595-03
(Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии,г.Н-Новгород)....97

22. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций метилцеллюлозы водорастворимой ( МЦ-100 ) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1596-03.... 102

23. Методические указания по газохроматографическому измернию концентрации смеси метоксигликолей (ди-, три-, тетрагликолей) (экосорба) в воздухе рабочей зоны
(НИИ гигиены, профпатологии и эколгии человека, Ленинградская область) МУК 4.1.1597-03 .... 108

24. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций надуксусной кислоты в воздухе рабочей зоны
(НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, Ленинградская область) МУК 4.1.1598-03 .... 114

25. Методические указания по измерению концентраций натриевой соли 6-амино-гексановой кислоты и натриевой соли 6-аминогексановой кислоты, ацилированной высшими кислотами ( реагент ААК или Таллактам), в воздухе рабочей зоны методом бумажной хроматографии
(Мосгорцентр Госсанэпиднадзора, г.Москва ) МУК 4.1.1599-03.. 118

МУК 4.I.1575-4.1.1674-03

25. Методические указания по измерению концентраций октафторпропана в воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии (РГМУ, г.Москва) МУК 4.1.1600 — 03... I23

27. Методические указания по измерению концентрации ортофосфористой и ортофосфорной кислот в воздухе рабочей зоны методом ионной хроматографии (РГМУ, НПЦ "Экос", г.Москва) МУК 4.1.1601 — 03.... I25

28. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций Пропан-I,2,3-триола тринитрата (нитроглицерина) в воздухе рабочей зоны ( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1602- 03... I3I

29. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций сульфата 3-броманилина (СМБА) в воздухе рабочей зоны ( НИХФИ, г.Новокузнецк ) МУК 4.1. 1603-03.. I37

30. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций тетрабората натрия (бура) в воздухе рабочей зоны ( Донецкий мединститут, г.Донецк ) МУК 4.1.1604-03.. I4I

3I. Методические указания по измерению концентрации I,2,3,9-тетрагидро-9-метил-3-[(2-метил-IH-имидазол-I-ил)метил]-4H-карбазол-4-она хлоргидрата дигидрата (ондансетрона) в воздухе рабочей зоны методом жидкостной хроматографии ( РГМУ, г.Москва ) МУК 4.1.1605-03... I45

32. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций тетрафторметана (хладона-I4) в воздухе рабочей зоны (НИИ гигиены,профпатологии и экологии человека, Ленинградская область ) МУК 4.1.1606 —03 .... I48

33. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций фенилгидразина солянокислого (гидразинобензол солянокислый) в воздухе рабочей зоны (М.п."Экологический центр, НИИБП, г.Москва) МУК 4.1.1607-03...I5I

34. Методические указания по хроматографическому измерению концентраций N -{4-[2-(5-хлор-2-метоксибензамидо)-этил]-бензол-сульфонил}-N'-циклогексилмочевины (глибенкламид) в воздухе рабочей зоны (НИХФИ, г.Новокузнецк) МУК 4.1.1608 —03... I55

МУК 4.1.1575-4.1.1614-03

35. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации целлюлазы в воздухе рабочей зоны
( РГМУ, г.Москва ) МУК 4.1.1609-03. 159

36. Методические указания по измерению концентрации ципрофлоксацина гидрохлорида моногидрата в воздухе рабочей зоны методом жидкостной хроматографии
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1610-03... 164

37. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этилового эфира α-бромизовалериановой кислоты в воздухе рабочей зоны МУК 4.1.1611-03
(Донецкий государственный медицинский институт,г.Донецк).. 168

38. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций 17α-этинилэстратриен-1,3,5(10)-диола-3,17В (этинилэстрадиол) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦА-ВНИИЛ, г.Москва) МУК 4.1.1612-03... 172

39. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций (S)-1-{N-[1-(Этоксикарбонил)-3 фенилпропил]-L-аланил}-L-пролина малеат (1:1) (эналаприла малеат) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) МУК 4.1.1613-03 .... 176

40. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций 1-(-2-этоксиэтил)-4-этинил-4-оксипиперидина (этиниловый спирт) в воздухе рабочей зоны
( НИХФИ, г.Новокузнецк ) МУК 4.1.1614-03 .... 181

Приложение 1 Приведение объема воздуха к стандартным условиям (температура 20°С и давление 760 мм рт.ст.) .... 185

Приложение 2 Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям .... 186

Приложение 3 Рисунок №1. Пассивный дозиметр Р-1 .... 187

Приложение 4 Рисунок №2. Устройство для концентрирования и ввода проб .... 188

Приложение 5 Рисунок №3. Пассивный дозиметр Р-4 .... 189

Приложение 6 Указатель основных синонимов, технических,торговых и фирменных названий веществ ....190

Приложение 7 Вещества, определяемые по ранее утвержденным Методическим указаниям .... 191

Приложение 8. Расчёт характеристик погрешности на основе данных, приведенных в МВИ ХХА . . . 192а

Приложение 9. Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВИ ХХА . . . 192б

Приложение 10. Расчёт норматива оперативного контроля (ВОК) воспроизводимости МВИ ХХА . . . 192в

gost.e-ecolog.ru