МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Выпуск 21/1

Москва 1987

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ВЫПУСК 21/1

Москва 1987

Сборник Методических Указаний составлен методической секцией по промышленной токсикологии при Проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профпатологии"

Настоящие Методические указания распространяются на измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны при санитарном контроле.

Ответственные за выпуск: С.И.Муравьева, Г.А.Дьякова, К.М.Грачева, В.Г.Овечкин.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного государственного санитарного врача СССР

А.И.Заиченко

"25" мая 1987 г.

№ 4309-87

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ТРИМЕЛЛИТОВОЙ КИСЛОТЫ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Структурная формула М.м. 210,15



Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота

/тримеллитовая кислота/

Сыпучее кристаллическое вещество белого цвета. Температура плавления 224-225°С, хорошо растворим в метиловом и этиловом спирте, умеренно - в эфире, трудно растворим в ацетоне.

В воздухе находится в виде аэрозоля.

Тримеллитовая кислота относится к умеренно токсичным соединениям, обладает аллергенным действием при различных путях поступления в организм.

ПДК в воздухе 0,05 мг/м^3.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДА

Метод основан на переведении триметиллитовой кислоты в сложный эфир воздействием диазометана с последующим газохроматографическим анализом на приборе с пламенно-ионизационным детектором.

Отбор проб проводят с концентрированием на фильтр АФА-ВП-20.

Нижний предел измерения в хроматографируемом объеме 0,05мкг.

Нижний предел измерения в воздухе 0,016 мг/м^3 (при отборе 300 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций в воздухе от 0,016 до 0,16 мг/м^3.

Измерению не мешают псевдокумол, уксусная кислота.

Измерению мешает тримеллитовый ангидрид.

Суммарная погрешность не превышает ± 20%.

Время выполнения измерения (включая отбор проб) около 45 мин.

ПРИБОРЫ, АППАРАТУРА, ПОСУДА

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором.

Хроматографическая колонка из нержавеющей стали длиной 1 м, диаметром 3 мм.

Весы лабораторные, аналитические, тип АДВ-200, ГОСТ 24104-80Е.

Микрошприц, МШ-10, ГОСТ 8043-74.

Аспирационное устройство.

Фильтродержатель.

Набор сит "Физприбор".

Шкаф сушильный.

Баня водяная.

Колбы круглодонные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100, 500 мл.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 25, 100 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1, 2, 5 мл.

Стаканы химические, ГОСТ 20292-74, вместимостью 50, 100 мл.

Лупа измерительная, ГОСТ 8309-75.

Секундомер.

Линейка измерительная.

РЕАКТИВЫ, РАСТВОРЫ И МАТЕРИАЛЫ

Бензол по ТУ 6-09-779-76, х.ч.

Калия гидроокись по МРТУ 6-09-578-69, ч.

Спирт метиловый по ТУ 6-09-1709-77, х.ч. (перегнанный).

Эфир серный по ГОСТ 2222-78Е, техн.(перегнанный).

Хлороформ по ТУ 6-09-4263-76, х.ч.

Хроматон N-AW-HMДS, 0,16-0,20 мм, фирма Chemapol Чехословакия, носитель для газовой хроматографии.

Полисилоксан типа SE-30, ПМС, неподвижная жидкая фаза.

Гидразин гидрат, по ГОСТ 5832-76, ч.

Диметиловый эфир терефталевой кислоты по ГОСТ 11363-80, х.ч.

Фильтры АФА-ВП-20, ТУ 95Т186-76.

Аргон в баллонах с редуктором по ГОСТ 10157-79.

Гелий в баллонах с редуктором, по ТУ 51889-75.

Водород технический в баллонах с редуктором по ГОСТ 3022-80.

Воздух в баллонах с редуктором по ГОСТ 11882-73.

Диазометан. Синтезируют с помощью установки (рис.1) согласно описанию. Для получения эфирного раствора диазометана в круглодонную колбу вместимостью 100 мл помещают 30 г КОН и приливают 20-25 мл смеси гидразина гидрата и метанола, взятых в соотношении 1:1, так чтобы вся щелочь была смочена. В ту же колбу

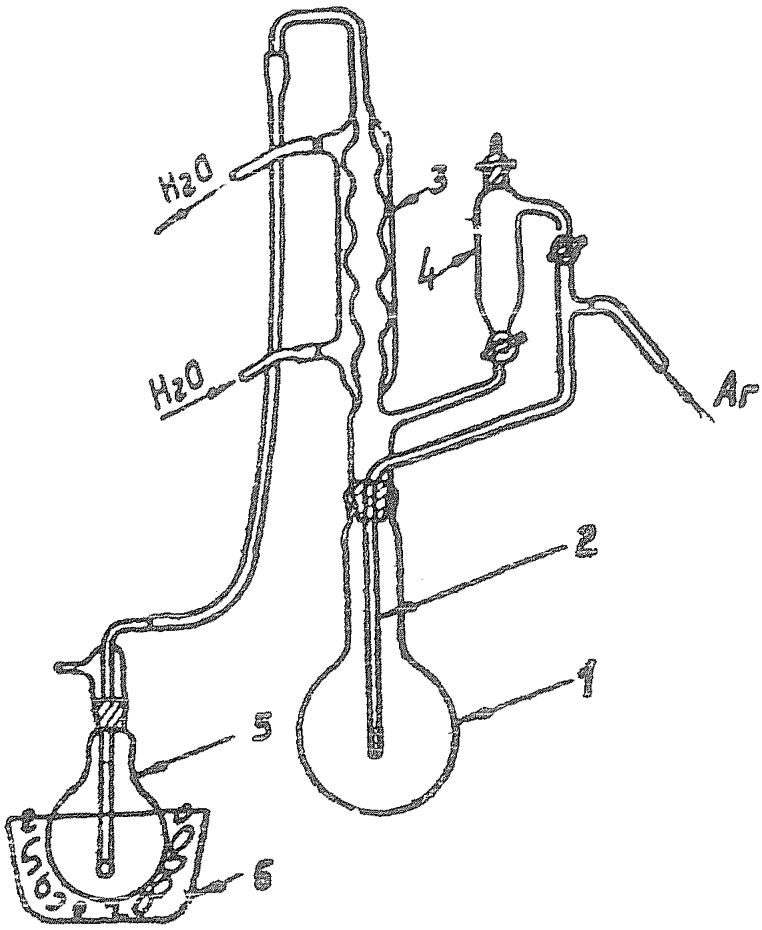

Рис.1. Установка для получения диазометана

1 - Реакционная колба
2 - барбатер
3 - обратный холодильник
4 - капельная воронка
5 - приемник
6 - кристаллизатор со льдом

через барботер /2/ пропускают аргон. Приливают по каплям из капельной воронки /4/ 10-12 мл хлороформа. Выделяющийся в результате реакции газ через обратный холодильник /3/ собирают в приемник /5/, содержащий серный эфир и помещенный в кристаллизатор со льдом /6/. Приемником может служить круглодонная или коническая колба вместимостью 300-500 мл, снабженная барботером. Шлифы смазывают силиконовой смазкой и тщательно притирают. Перед приливанием хлороформа в капельную воронку, нужно проверить закрыт ли кран. В случае попадания хлороформа в реакционную колбу в больших количествах возможна бурная реакция со взрывом. Для метилирования используют только свежеприготовленный раствор диазометана в эфире, который можно хранить при температуре около 0^{0}C /кристаллизатор со льдом/ в течение рабочего дня.

Стандартный раствор тримеллитовой кислоты с концентрацией 1 мг/мл готовят растворением точной навески (100 мг) в метиловом спирте в мерной колбе на 100 мл.

Стандартный раствор диметилового эфира терефталевой кислоты с концентрацией 0,1 мг/мл готовят растворением в мерной колбе на 100 мл 10 мг вещества в метиловом спирте. Растворы устойчивы в течение 3 суток в холодильнике при температуре $+4^{0}$C.

ОТБОР ПРОБЫ ВОЗДУХА

Воздух с объемным расходом 15 л/мин аспирируют через фильтр АФА-ВП-20, закрепленный в фильтродержателе. Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 200 л воздуха.

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Взвешивают хроматон N-Aw-H-MDS -50 $см^{3}$. Полиметилсилоксан в количестве 5% от веса носителя растворяют в 100 $см^{3}$ бензола в

круглодонной колбе. В полученный раствор вносят приготовленный носитель небольшими порциями и осторожно перемешивают. Бензол испаряют в вытяжном шкафу при 80°С до состояния сыпучести носителя. В промытую и высушенную колонку, согласно инструкции к хроматографу, засыпают приготовленную насадку /механически с применением вакуума/, концы закрывают стеклотканью. Заполненную колонку подсоединяют одним концом к испарителю хроматографа и кондиционируют в токе газа-носителя первые 2 часа при 100°С, затем 2 часа при 150°С и 2 часа при 250°С, при скорости газа-носителя 40 мл/мин. Затем подключают второй конец колонки к детектору.

Для определения градуировочного коэффициента, необходимого при расчете хроматограмм, готовят градуировочные растворы тримеллитовой кислоты в мерных колбах на 25 мл с содержанием: 0,01; 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1 мг/мл. Градуировочные растворы устойчивы 1 сутки. Проводят этерификацию и прибавляют внутренний стандарт. Концентрация внутреннего стандарта во всех пробах постоянна - 0,05 мг/мл. Вводят по 5 мкл каждого раствора в хроматограф через самоуплотняющуюся мембрану, проводя 5 параллельных определений для каждой концентрации. Записывают хроматограмму и вычисляют площади пиков внутреннего стандарта и определяемого компонента /мм^2/. Площадь пика получают умножением высоты пика на его ширину, измеренную на половине высоты.

Условия хроматографирования градуировочных растворов и анализируемых проб:

Температура термостата колонок	150°С
Температура испарителя	250°С
Скорость потока газа-носителя	40 мл/мин
Скорость потока водорода	30 мл/мин

Скорость потока воздуха	150 мл/мин
Скорость движения диаграммной ленты	240 мм/час
Время удерживания:	
Диметилового эфира терефталевой кислоты	2 мин.52 сек.
Эфира тримеллитовой кислоты	12 мин.45 сек.
Время выхода метилового спирта	1 мин.15 сек.

Расчет градуировочного коэффициента проводят по формуле:

$$K = \frac{S_{ст}}{S_{тмк}} \cdot \frac{C_{тмк}}{C_{ст}}, \text{ где}$$

$S_{ст}$, $S_{тмк}$ – площадь пиков внутреннего стандарта и определяемого компонента, $мм^2$;

$C_{ст}$, $C_{тмк}$ – концентрации внутреннего стандарта и определяемого компонента, мг/мл.

Фильтр с отобранной пробой осторожно освобождают из пакета, помещают в химический стакан, добавляют 5 мл метанола, встряхивают и приливают 2-3 мл раствора диазометана в серном эфире до получения устойчивой желтой окраски, которая свидетельствует о том, что метилирование прошло полностью.

К анализируемой пробе после этерификации прибавляют 0,25 мл внутреннего стандарта. Избыток диазометана и растворителей удаляют упариванием в вытяжном шкафу до объема 0,5 мл.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Анализируемую пробу в количестве 5 мкл вводят с помощью микрошприца в хроматограф через самоуплотняющуюся мембрану. Записывают хроматограмму и вычисляют площади пиков внутреннего стандарта и определяемого компонента.

РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ

Концентрацию тримеллитовой кислоты в мг/м^3 (С) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{S_{тмк} \cdot m_{ст} \cdot K \cdot 1000}{S_{ст} \cdot V}$$, где

$S_{ст}$, $S_{тмк}$ – площади пиков внутреннего стандарта и определяемого компонента /мм^2/;

$m_{ст}$ – количество введенного в пробу внутреннего стандар мг;

K – градуировочный коэффициент для определяемого компонент.

V – объем воздуха, отобранный для анализа, приведенный к стандартным условиям /см.Приложение1 /.

Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t^{0}) \cdot 101{,}33}, \quad \text{где}$$

V – объем воздуха, отобранный для анализа, л.

P – барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 мм рт.ст.)

t – температура воздуха в месте отбора пробы, ^{0}C

Для удобства расчета V_{20} следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить V на соответствующий коэффициент.

Коэффициент К для приведения объема воздуха к стандартным условиям

°С	Давление Р, кПа/мм рт.ст									
	97,33/730	97,86/734	98,4/738	96,93/742	99,46/746	100/750	100,53/754	101,06/758	101,33/760	101,86/
-30	I,I582	I,I646	I,I709	I,I772	I,I836	I,I899	I,I963	I,2026	I,2058	I,2122
-26	I,I593	I,I456	I,I5I9	I,I58I	I,I644	I,I705	I,I768	I,I83I	I,I862	I,I926
-22	I,I2I2	I,I274	I,I336	I,I396	I,I458	I,I5I9	I,I58I	I,I643	I,I673	I,I735
-I8	I,I036	I,I097	I,II58	I,I2I8	I,I278	I,I338	I,I399	I,I400	I,I490	I,I55I
-I4	I,0866	I,0926	I,0986	I,I045	I,II05	I,II64	I,I224	I,I284	I,I3I3	I,I373
-I0	I,0701	I,0760	I,08I9	I,0877	I,0936	I,0994	I,I053	I,III2	I,II4I	I,I200
- 6	I,0540	I,0599	I,0657	I,07I4	I,0772	I,0829	I,0887	I,0945	I,0974	I,I032
- 2	I,0385	I,0442	I,0499	I,0556	I,06I3	I,0669	I,0726	I,0784	I,08I2	I,0869
0	I,0309	I,0366	I,0423	I,0477	I,0535	I,059I	I,0648	I,0705	I,0733	I,0789
+ 2	I,0234	I,029I	I,0347	I,0402	I,0459	I,05I4	I,057I	I,0627	I,0655	I,07I2
+ 6	I,0087	I,0I43	I,0I98	I,0253	I,0309	I,0363	I,04I9	I,0475	I,0502	I,0557
+I0	0,9944	0,9999	I,0054	I,0I08	I,0I62	I,02I6	I,0272	I,0326	I,0353	I,0407
+I4	0,9806	0,9860	0,99I4	0,9967	I,0027	I,0074	I,0I28	I,0I83	I,0209	I,0263
+I8	0,967I	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	I,0043	I,0069	I.0I22
+20	0,9605	0,9658	0,97II	0,9783	0,98I6	0,9868	0,992I	0,9974	I,0000	I,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,963I	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,99I7
+26	0,94I2	0,9464	0,95I6	0,9566	0,96I8	0,9669	0,972I	0,9773	0,9799	0,985I
+28	0,9349	0,940I	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,989I	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9I67	0,92I8	0,9268	0,93I8	0,9368	0,94I8	0,9468	0,95I9	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9I49	0,9I98	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,942I	0,947I

Приложение 3

П Е Р Е Ч Е Н Ь

учреждений представивших Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе

№№ пп	Методические указания	Учреждения, представившие Методические указания
I	2	3
I.	Фотометрическое измерение концентрации алкилпропилендиамина	Медицинский институт г. Ростов-на-Дону
2.	Фотометрическое измерение концентрации бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-метилпиридий) дисульфида дигидрохлорида (пиридитол)	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва Медицинский институт г.Курск
3.	Газохроматографическое измерение концентрации бутоксибутенина	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва ГОСНИИметанолпроект
4.	Фотометрическое измерение концентрации I,IO декандикарбоновой кислоты (I,IO ДДК)	ГорСЭС, г. Москва
5.	Фотометрическое измерение концентрации диборида магния, диборида титана-хрома и металлокерамического сплава (на основе диборида титана-хрома)	НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Свердловск
6.	Фотометрическое измерение концентрации диморфолинфенилметана (ингибитора ВНХ-Л-20)	НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Киев
7.	Газохроматографическое измерение концентраций метилизобутилкарбинола	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва

I	2	3
8.	Газохроматографическое измерение концентрации метилцеллозольва	Киевский филиал ГОСНИИхлорпроект г.Киев
9.	Пламеннофотометрическое измерение концентрации стронция фосфорнокислого двухзамещенного	Медицинский институт г. Ставрополь
10.	Газохроматографическое измерение концентрации фенетола	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва
11.	Газохроматографическое измерение концентрации циклододеканола и циклододеканона	ГорСЭС, г.Москва
12.	Газохроматографическое измерение концентрации денацила и додецилового спирта	Рязанский мединститут
13.	Спектрофотометрическое измерение концентрации диэтилентриаминпентаацетата меди тринатриевой соли	ГорСЭС, г.Москва
14.	Газохроматографическое измерение концентрации карбамоил-3(5)-метилпиразола	Армянский НИИ ГТ и ПЗ
15.	Газохроматографическое измерение концентрации триметилфосфита	НИИ гигиены им.Ф.Ф. Эрисмана, ВНИИХСЗР
16.	Фотометрическое измерение концентраций цинкового комплекса нитрилотрифенилфосфоновой кислоты тринатриевой соли и растворимого железного комплекса нитрилотриметилфосфоновой кислоты динатриевой соли	ГорСЭС, Москва
17.	Газохроматографическое измерение концентраций алкилдифенилоксидов (Алотрема-I)	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР
18.	Спектрофотометрическое измерение концентрации ангидрида тримеллитовой кислоты	Уфимский НИИНЕФТЕХИМ
19.	Газохроматографическое измерение концентрации Бис-N,N-гексаметиленкарбамида (карбоксида)	Рижский мединститут

I	2	
20.	Хроматографическое измерение концентрации Бис-фосфита	Львовский мединститут
21.	Газохроматографическое измерение концентрации диметилсебацината	Ростовский-на-Дону мединститут
22.	Газохроматографическое измерение концентрации диметилфосфита	Львовский мединститут
23.	Газохроматографическое измерение концентрации изопропенилацетилена	НИИ ГТ и ПЗ АМН СССР НПО "НАИРИТ" г.Ереван
24.	Фотометрическое измерение концентраций красной и желтой кровяной соли	Донецкий мединститут
25.	Фотометрическое измерение концентрации лиминофора Р-385	Ставропольский мединститут
26.	Газохроматографическое измерение концентрации монобензилтолуола	Донецкий мединститут
27.	Фотометрическое измерение концентрации 3-нитро-4-хлоранилина	Казанский университет Н.И.Савельева
28.	Пламенно-фотометрическое измерение концентрации растворимых соединений рубидия	I-ый Московский мединститут
29.	Хроматографическое измерение концентрации тиотреххлористого фосфора	Львовский мединститут
30.	Газохроматографическое измерение концентрации тримеллитовой кислоты	Уфимский НИИНЕФТЕХИМ
31.	Хроматографическое измерение концентрации триметилфосфита	Львовский мединститут
32.	Газохроматографическое измерение концентрации триэтилортоацетата	Университет дружбы народов им. П.Лумумбы
33.	Газохроматографическое измерение концентрации 3-феноксибензальдегида	Университет дружбы народов им. П.Лумумбы
34.	Флуориметрическое измерение концентрации фенибута	Рижский мединститут

I	2	3
35.	Полярографическое измерение концентрации фосфида цинка	ЦОЛИУВ, Москва Киевский НИИ ГТ и ПЗ
36.	Фотометрическое измерение концентрации фталазола	ВНИХФИ, г.Купавна
37.	Хроматографическое измерение концентрации хардина	Львовский мединститут
38.	Фотометрическое измерение концентрации хлористого аммония	Армянский НИИ ГТ и ПЗ
39.	Газохроматографическое измерение концентрации циклогесена	НИИ ГТ и ПЗ

Приложение 4

Вещества, определяемые по ранее утвержденным методическим указаниям

Наименование вещества	Методические Указания
I	2
Сополимеры и полимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок М., 1981, с. 235 (переиздание сборник МУ, выпуски I-5)
Полиамфолиты ПА-I, ПА-IМ, ПА-I2I	- " -
лагоден	- " -
оксалон	- " -
катализатор ИМ-220I	Методические указания на фотометрическое определение окиси хрома, выпуск М., 1979, с. I08
Титана сульфид и дисульфид	Методические указания по полярографическому измерению вольфрама в воздухе рабочей зоны, выпуск XIX, М.,1984, с.I3
Вольфрама сульфид и дисульфид	Методические указания по полярографическому измерению концентраций титана в воздухе рабочей зоны, выпуск XIX, М., 1984, с. I29
Сварочный аэрозоль при содержании марганца до 20 %	Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), М., 1981, с.
Сварочный аэрозоль при содержании марганца от 20 до 30 %	

Приложение 5

Указатель определяемых веществ

Аллилдифенилоксид (Алотерм-I) 86
Аллилпропилендиамин I
Ангидрид тримеллитовой кислоты 91
Бис-N,N-гексаметиленкарбамид (карбоксид) 96
Бис- (2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-метилпиридил) дисульфида дигидрохлорида (пиридитол) 5
Бис-фосфит I02
Бутоксибутенин I0
1,I0-декандикарбоновая кислота I7
Декацил 58
Диборид магния 22
Диборид титана-хрома 22
Диметилсебацинат I07
Диметилфосфит II2
Дихлорфенилметан (ингибитор ВНХ-Ф 20) 27
Диэтилентриаминпентаацетата меди тринатриевая соль 64
Децениловый спирт 58
Изопропенилацетилен II8
Карбамоил-3(5)-метилпиразол 70
Красная и желтая кровяная соль I22
Люминофор Р-385 I27
Метилизобутилкарбинол 32
Метилцеллозольв 36
Монобензилтолуол I32
3-нитро-4-хлоранилин I37
Рубидия растворимые соединения I45
Стронция фосфорнокислый двузамещенный 42
Тетрахлористый фосфор I50
Тримеллитовая кислота I54
Триметилфосфит 75
Триэтилортоацетат I65
Фенетол 46
Фенибут I79
3-феноксибензальдегид I69
Фосфид цинка I78
Фтивазол I84

Хардин 189
Хлористый аммоний 193
Циклододеканол 50
Циклододеканон 50
Циклогексен 198
Цинковый комплекс нитрилотрифенилфосфоновой кислоты тринатриевой соли и растворимого железного комплекса нитрилотриметилфесфоновой кислоты динатриевой соли 80

Содержание.

I. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций алкилпропилендиамина в воздухе рабочей зоны I

2. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-4-метилпиридин) дисульфида дигидрохлорида (пиридитол) в воздухе рабочей зоны 5

3. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации бутоскибутенина в воздухе рабочей зоны I0

4. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций I,I0 декандикарбоновой кислоты (I,I0 ДДК) в воздухе рабочей зоны I7

5. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации диборида магния, диборида титана-хрома и металлокерамического сплава (на основе диборида титана-хрома) в воздухе рабочей зоны 22

6. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций диморфолинфенилметана (ингибитора ВИХ-Л-20) в воздухе рабочей зоны 27

7. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилизобутилкарбинола в воздухе рабочей зоны 32

8. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилцеллозольва в воздухе рабочей зоны 36

9. Методические указания по пламеннофотометрическому измерению концентраций стронция фосфорнокислого двузамещенного в воздухе рабочей зоны 42

I0. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации фенетола в воздухе рабочей зоны 46

II. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций циклододеканола и циклододеканона в воздухе рабочей зоны 50

I2. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций деканола и додецилового спирта в воздухе рабочей зоны 58
I3. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации диэтилентриаминпентаацетата меди тринатриевой соли (ДТПА Э/а) в воздухе рабочей зоны 64
I4. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации карбамоил-3(5)-метилпиразола в воздухе рабочей зоны 70
I5. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций триметилфосфита в воздухе рабочей зоны 75
I6. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации цинкового комплекса нитрилотрифенилфосфоновой кислоты тринатриевой соли и растворимого железного комплекса нитрилотриметилфосфоновой кислоты динатриевой соли в воздухе рабочей зоны..... 80
I7. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций алкилдифенилоксидов (Алотерма-I) в воздухе рабочей зоны 86
I8. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентраций тримеллитовой кислоты в воздухе рабочей зоны 9I
I9. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций бис-1,1-гексаметиленкарбамида (карбоксида) в воздухе рабочей зоны 96
20. Методические указания по измерению концентраций бис-фосфита в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии I02
2I. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диметилсебацината в воздухе рабочей зоны I07
22. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций диметилфосфита в воздухе рабочей зоны II2

23. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций изопропенилацетилена в воздухе рабочей зоны 118
24. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций красной и желтой кровяной соли в воздухе рабочей зоны 122
25. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций люминофора Р-385 в воздухе рабочей зоны 127
26. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций монобензилтолуола (МБТ) в воздухе рабочей зоны 132
27. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций 3 нитро-4-хлоранилина в воздухе рабочей зоны 137
28. Методические указания по пламенно-фотометрическому измерению концентраций растворимых соединений рубидия в воздухе рабочей зоны 145
29. Методические указания по измерению концентраций тиотреххлористого фосфора методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны 150
30. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций тримеллитовой кислоты в воздухе рабочей зоны 154
31. Методические указания по измерению концентраций трифенилфосфита методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны..... 161
32. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций триэтилортоацетата (ТЭОА) в воздухе рабочей зоны 165
33. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 3-феноксибензальдегида (3-ФБА) в воздухе рабочей зоны 169
34. Методические указания по флуориметрическому измерению концентрации фенибута в воздухе рабочей зоны 173
35. Методические указания по полярографическому измерению концентрации фосфида цинка в воздухе рабочей зоны 178

36. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций фталазола в воздухе рабочей зоны 184
37. Методические указания по измерению концентраций хлодина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии 189
38. Методические указания по фотометрическому измерению концентраций хлористого аммония в воздухе рабочей зоны 193
39. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации циклогексена в воздухе рабочей зоны 198
40. Приложение I 202
41. Приложение 2 203
42. Приложение 3 204
43. Приложение 4 208
44. Приложение 5 209

gost.e-ecolog.ru

29 от. 30.07.85 п. л. Зак. №1576 тир. 6250
Типография Министерства здравоохранения СССР