УДК 621.643.3.002.72:629.7

Группа Д 15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10009-79

РУКАВА
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1988 г.

Распоряжением Министерства от 29 ноября 1979 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на рукава для кислородных приборов (РКП).

Издание официальное ★ ГР 8148506 от 27.12.79

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1 2
№ изв. 10234 11071
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 4197

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры рукавов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

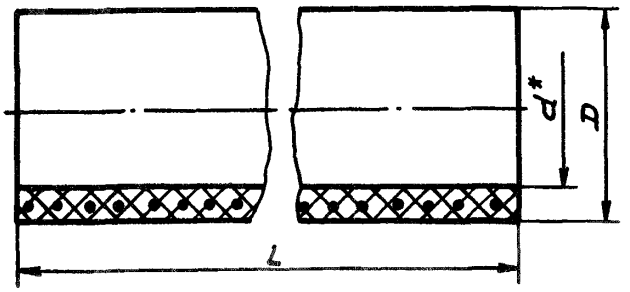

Размеры, мм

d	D по категориям				Масса 1 м, кг
	1	2	3	4	
6	-	11,5-11,9	12,0-12,5	-	0,142
8	13,0-13,4	13,5-13,9	14,0-14,4	14,5-15,0	0,158
10	16,0-16,4	16,5-16,9	17,0-17,4	17,5-18,0	0,180
12	19,0-19,4	19,5-19,9	20,0-20,4	20,5-21,0	0,230
14	20,0-20,4	20,5-20,9	21,0-21,4	21,5-22,0	0,313

3. Рукава должны соответствовать ТУ 105566-85.

4. На торце рукава после обрезки не допускается выступание спирали.

5. Рукава после резки на необходимую длину и измерения диаметров концов разбить на категории согласно таблице и замаркировать.

6. Длина L устанавливается конструктором.

7. Маркировать категорию рукава и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения рукава с внутренним диаметром d = 12 мм рабочим давлением 1,2 МПа (12 кгс/см^2) длиной L = 200 мм:

Рукав 12-1,2-200-ОСТ 1 10009-79

*Размер для справок.

№ изм. 1 10234
2 11071
№ изв.
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 4197

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме-ненных	заме-ненных	новых	анну-пиро-ванных				

Инв. № д...иката

Инв. № п...инника

4197

gost.e-ecolog.ru