СОДЕРЖАНИЕ

1. АППАРАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ 3
2. АППАРАТЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ, РЕАНИМАЦИИ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ 8
3. ПРИБОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ 21
4. ОБОРУДОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 32
5. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ 41
6. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ 43
7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 55
8. АППАРАТУРА ФИЗИОТЕРАПИИ И СВЕТОЛЕЧЕБНАЯ 59
9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ 63
10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ 68
11. МЕБЕЛЬ МЕДИЦИНСКАЯ 75
    - 11.1. Мебель медицинская общего назначения 75
        - 11.1.1. Кровати 75
        - 11.1.2. Столы операционные, перевязочные, инструментальные и др., средства для доставки больных и грузов 78
        - 11.1.3. Мебель общебольничная 83
    - 11.2. Шкафы медицинские для поликлиник ШМП-446 87
    - 11.3. Встроенные шкафы для больниц и поликлиник 88
    - 11.4. Шкафы медицинские ШМ-440 88
    - 11.5. Мебель аптечная НАМ-426 89
    - 11.6. Мебель для кабинетов физиотерапии МФК-413 89
    - 11.7. Ширмы, штативы 89
    - 11.8. Набор мебели для клинико-диагностических лабораторий КДЛ-423 90
    - 11.9. Набор мебели для клинико-диагностических лабораторий КДЛ-455 91
12. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ АПТЕК 93
13. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 97
14. АДРЕСА ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ 99

С выпуском данного перечня считать утратившим силу перечень ПО-09.07.09-99 «Оборудование медицинское»

Замечания и предложения просьба сообщать в наш адрес 119121 г Москва, Г-121, ФГУП «31 ГПИ СС Минобороны России» или по телефону – 241-39-40

gost.e-ecolog.ru

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб. с НДС
1.	**Стол операционный универсальный** (см также на стр 78)	**СОУр-1**		**ОАО «ПроМеТеИ-плюс», г Елец**	Предназначен для проведения общехирургических, нейро-челюстных, гинекологических, проктологических, урологических операций Легкость в управлении, возможность регулировок в широких пределах, большой выбор съемных приспособлений и принадлежностей позволяет обеспечить больному необходимое пложение Конструкция стола обеспечивает его устойчивое положение и удобство работы медперсоналу Все органы управления расположены со стороны головной секции, что позволяет управлять столом вне пределов операционной зоны Панель стола изготовлена из алюминиевого сплава, покрытого пластиком, и состоит из четырех секций· головной, спинной, тазобедренной ножной и удлиненной Головная и ножная секции съемные Изменение положение спинной секции производится вращением рукоятки, расположенной под спинной секцией Регулировка наклонов панели осуществляется при помощи рукоятки и переключателя	53 130
2.	**Стол перевязочный** (см рис на стр 81)	**ПН**		**ОАО «ПроМеТеИ-плюс», г Елец**	Предназначен для проведения перевязок и несложных хирургических операций Применяется в хирургических отделениях лечебных учреждений Привод подъема панели гидравлический, ножной ***Основные узлы*** основание, механизм подъема-опускания с гидроприводом, рама с двухсекционной панелью головной и спинной В основание, установленное на два колеса и две опоры, вмонтирован механизм подъема-опускания панели и его гидропривод Механизм подъема-опускания представляет собой устройство состоящее из двух пар рычагов, соединенных крестообразно Между колесами имеется самоориентирующееся колесо, которое поднимается и опускается с помощью подпружиненного эксцентрика Стол снабжен подлокотниками Угол наклона головной секции, град. 45 Угол наклона спинной секции, град 20 Усилие на педаль для подъема панели с ном. нагрузкой 80 кг, кг/с 300 Допустимая нагрузка на панель, кг 160 Габариты мм 2062 x 600 x 530-930 Масса (в комплекте с приспособлениями), кг 130 Высота максимальная, мм 930 ± 30 минимальная, мм 530 ± 30	20 920

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Макс. освещенность рабочего поля, люкс	Количество ламп	Потребляемая мощность, В А	Перемещение осветителя по вертикали, мм	Масса, кг	Цена, руб.
3.	Светильники хирургические стационарные	СР-2М		ЗАО «Завод ЭМА», г. Екатеринбург	Предназначены для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях					
					160 000	9	450	620	95	50 928
		СР-4М			100 000	6	300	620	65	33 216
		СР-5М			60 000	3	150	620	50	17 964
					Размер рабочего поля, см			10 25		*в т.ч. НДС*
					Источник света Тип лампы			КГМ 12-40		
					Питание от сети переменного тока			50 Гц, 220В		
					Минимальная высота помещения, м			2,9		
					Диаметр действия, м			2 8		
4.	Светильник хирургический передвижной	ПР-5			Предназначен для освещения операционного поля в качестве вспомогательного аппарата при хирургических операциях в условиях стационара и перевязочных					
					60 000	3	150	500	50	21 756
					Размер рабочего поля, см			10 25		*в т.ч НДС*
					Источник света Тип лампы			КГМ 12-40		
					Питание от сети переменного тока			50 Гц, 220В		
5	Светильники хирургические стационарные	«Эмалюкс» 80/80			Предназначены для освещения операционного поля при хирургических операциях и диагностических исследованиях Высокоинтенсивный источник света и фацетный интерференционный отражатель большого диаметра обеспечивают равномерную освещенность операционного поля Свет излучаемый светильником близок по спектру к солнечному, хорошая цветопередача минимальный нагрев операционного поля					
					160 000		360			130 000
		«Эмалюкс» 80/30			110 000		290			110 000
		«Эмалюкс» 80			80 000		200			70 000
					Диаметр рабочего поля, см	80, 80/80		18		*НДС не облагается*
						80/30		80/15		
					Рабочее расстояние, см			70 - 130		

№ п/п	Код оборудования	Наименование и краткая техническая характеристика оборудования	Тип, марка оборудования	ГОСТ, нормаль, ТУ или каталог	Завод-изготовитель.	Основные параметры и размеры	Масса единицы оборудования, кг	Цена единицы оборудования, руб.	Гарант. срок службы, год	Примечание
						Техническая характеристика				
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
	945255	Светильник медицинский бестеневой передвижной с аварийным питанием	СБПА-I5	ТУ64-I--483-77	ЗАО"Завод электромедицинской аппаратуры" г.Екатеринбург	Род тока - переменный, 220В; I27В; 50 Гц Потребляемая мощность, В.А - в основном режиме I00; в аварийном режиме 200 Освещенность операционного поля в основном режиме при рабочем диаметре светового пятна I00 мм,лк - - не менее 4000 Наиболее освещенное место в аварийном режиме,лк- - I500 Источник аварийного питания - аккумуляторная батарея Предназначен для освещения операционного поля при хирургических операциях в условиях стационара, а также в полевых условиях. При аварии в осветительной сети или перегорании в лампе нити накала питание с помощью реле автоматичкски подается на ее вторую нить от аккумулятора.	75	I7700 (с НДС)		
7.		Аппарат электрохирургический высокочастотный Предназначены для резания и коагуляции мелких тканей и мелких кровеносных сосудов с помощью электродов.	ЭХВЧ-20-04		Завод"ЭМА", г.Москва	Максимальная выходная мощность:в непрерывном режиме не более 25 Вт;в импульсном режиме не более I0 Вт. Средняя потребляемая мощность 50 Вт. Габаритные размеры,мм - 34Ix290xI42 Применяются в офтальмологических центрах,в стоматологии,микрохирургии и дерматологии.	5	9000		

№ п/п	Код оборудования	Наименование и краткая техническая характеристика	Тип, марка оборудования	ГОСТ, нормаль, ТУ или каталог	Завод-изготовитель	Основные параметры и размеры: Техническая характеристика	Масса единицы оборудования, кг	Цена единицы оборудования, руб.	Гарант. срок службы, год	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	945I42	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума	ЦСР-I	ТУ64-I-2646-8I	ОАО «Казанский завод медаппаратуры» г.Казань	Применяется в реанимационных, операционных и больничных палатах. Подача кислорода и закиси азота от баллонов, устанавливаемых в рампах по 3 и 5 штук и располагаемых в специальном помещении, производится через блоки, обеспечивающие распределение газов, контроль, автоматическое переключение рамп и регулирование давления газов в пределах от I до 6 кгс/см^2. Вакуум создается вакуумной установкой. Разрежение у потребителя регулируется в пределах от 0,02 до 0,8 кгс/см^2. Электропитание блоков кислорода и закиси азота от однофазной сети переменного тока: 220 В, 50 Гц. Электропитание вакуумной установки от трехфазной сети переменного тока: 380/220 В, 50 Гц. В операционных, перевязочных и на постах держурного персонала устанавливаются панели дублирующей сигнализации.		I855[illegible] (с НДС)		

Наименование сборочных единиц	Габаритные размеры, мм	
Блок кислорода	560x200x530	23
Блок закиси азота	560x200x530	25
Блок вакуумных насосов	725x725x850	I80
Рейсвер	425x425xI400	25
Панель дублирующей сигнализации	46x62xI35	0,I5

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Аппарат для внутривенного вливания	"Дозатор"		АО "Утес" г. Ульяновск	Предназначен для дли[illegible]льного введения лекарств в организм пациента. Рекомендуется для применения в педиатрии, анестезиологии и реаниматологии, неврологии и нейрохирургии, а также в общих разделах хирургии и терапии. Аппарат обеспечивает: работу аппарата с двумя шприцами в медленном и равномерном темпе; регулировку объема лекарства с помощью передвижной установочной втулки; звуковую и световую сигнализацию окончания введения лекарственного раствора или возникновения аварийного режима; возможность оперативного измерения скорости введения лекарственного раствора в процессе работы; автоматическое отключение режима вливания. Питание от сети переменного тока, В — 220 с частотой, Гц — 50 Потребляемая мощность, ВА, не более — 5 Диапазон измерения скоростей, мл/ч — 0,6 – 70 Габаритные размеры, мм — 320x125x185	3	7 080
10.	Отсасыватель медицинский	ОМ-I		то же	Предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время операций, для отсасывания секрета из дыхательных путей при наркозе, дыхательных параличах и при отсутствии кашлевого рефлекса. Отсасыватель обеспечивает: регулировку вакуума с контролем по стрелочному индикатору; дистанционное включение отсасывателя ножной педалью; регулировку величины потока отсасываемой жидкости ручкой "Скорость отсасывания" при отсасывании жидкости в мягких тканях, а также манипулированием отверстием наконечника при отсасывании жидкости из полости. Максимальная производительность, л/мин — 6 Минимальное остаточное давление в банке-сборнике, кПа (кгс/см^2) — I6 (0,I7) Питание от сети переменного тока, В — 220 Мощность, ВА, не более — 60 Габаритные размеры, мм — 500x250x360	II	5 095

2. АППАРАТЫ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ, РЕАНИМАЦИИ И КИСЛОРОДНОЙ ТЕРАПИИ.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб. (до 03 03г)
1.	**Аппарат ингаляционного наркоза портативный**	**АН-8**		**ОАО «ПКП «Респиратор», г.Орехово-Зуево**	***Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО4.В02453*** *действует до 05 03 2004г* Предназначен для проведения ингаляционного наркоза при оказании скорой медицинской помощи в машине скорой помощи или на дому у пациента Аппарат снабжен двумя однолитровыми баллонами с газом под высоким давлением один с кислородом, другой с закисью азота Сопротивление дыханию, мм вод ст 10 Максимальное давление в линии дыхания, мм вод ст 300±30 Пределы регулируемой подачи кислорода и закиси азота л 1 – 10 Экстренная подача кислорода, л/мин 30 Габаритные размеры, мм 230 x 270 x 370 Масса, кг 12	23 280
2.	**Ингалятор кислородный**	**КИ-3М**		**то же**	***Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО4.В02455*** *действует до 05 03 2004г* Предназначен для подачи кислорода и кислородно-воздушной смеси (70%) одному или двум больным одновременно при острых приступах удушья или растройствах дыхания в медицинских учреждениях и в полевых условиях, преимущественно в незараженной среде В случае крайней необходимости КИ-3М можно пользоваться и в зараженной среде Запас кислорода в баллоне, л 195 Сопротивление дыханию, мм вод.ст при вдохе 15 при выдохе 8 Габаритные размеры, мм 660x240x120 Масса, кг 6,5	7 600
3.	**Аппарат портативный ручной для искусственной вентиляции легких**	**ДП-10.02**		«	Предназначен для выполнения кратковременного искусственного дыхания с активным вдохом и пассивным выдохом в условиях скорой помощи, в отделениях реанимации и в полевых условиях Минутная вентиляция, л/мин 25 – 30 Имеется возможность подключения подпитки кислородом Макс дыхательный объем резинового баллона, л 1,2 Сопротивление выдоху, мм вод ст 10 Габаритные размеры мм 350 x 265 x 170 Масса, кг 3,5	8 300

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб. (до 03 03г)
4.	**Станция кислородная стационарная**	**КСС-2**		**ОАО «ПКП «Респиратор», г.Орехово-Зуево**	***Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО4.В02454*** *действует до 05 03 2004г* Предназначена для централизованной подачи кислорода непосредственно в палаты лечебного учреждения для ингаляции больных кислородом или кислорднО-воздушной смесью получения аэрозолей лекарственных веществ и аспирации Кислородная рампа рассчитана на одновременное снабжение кислородом 15 коек Содержание кислорода в кислородно-воздушной смеси, % 60, 75 85, 100 Подача кислорода по дозиметру, л/мин 1 – 14 Разрежение, создаваемое при аспирации, при подводимым давлении 6 кгс/см^2, не менее, кгс/см^2 0,72 Величина частиц аэрозоля мкм до 10 Масса кг 30	56 650
5.	**Кислородная ингаляционная станция**	**КИС**		то же	***Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО4.В02461*** *действует до 05 03 2004г* Предназначена для обеспечения чистого кислорода, кислородно-воздушной смеси больным для дыхания в условиях стационара или в полевых госпиталях Содержание кислорода в смеси с воздухом, % 50 – 70 Сопротивление индивидуального ингалятора вдоху мм вод ст 10 Количество одновременно обслуживаемых пациентов 7 человек Габаритные размеры, мм 1000 x 585 x 360 Масса, кг 75	56 650
6	**Аппарат кислородной терапии для детей**	**ДКП-1**		«	Аппарат позволяет получать для дыхания газовую смесь с содержанием кислорода 45%, 60%, 80% и чистый кислород Предназначен для индивидуальной кислородной терапии больных детей любого возраста, в том числе и новорожденных при легочной и сердечной недостаточности	11 850

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8
7.	Аппарат ингаляционного наркоза	"АИН-I (Полинаркон-I2)" 94 4460	ТУ9444-001-33142139-95	ЗАО "Электромедоборудование", г.Санкт-Петербург	Аппарат предназначен для проведения ингаляционного наркоза (ИН) фторотаном, эфиром для наркоза и медицинской закисью азота по нереверсивному и частично-реверсивному контурам дыхания. Аппарат рассчитан на эксплуатацию в стационарных хирургических операционных при температуре окружающего воздуха 25°С, относительной влажности 80% при температуре 25°С без динамических механических воздействий. Экстренная (не дозированная) подача кислорода, л/мин — от 45 до 75 Общая вместимость поглотителя двух камер адсорбента выдыхаемой углекислоты, л — I,5 Климатическое исполнение аппарата — УХЛ 4.2 Давление сжатых газов питания, кПа (кгс/см²) — 400 (4) Габаритные размеры аппарата, мм: тип I — 800x600xI440 тип 2 — 800x400x580 Аппарат имеет два типа: тип I – на стойке с колесами, с баллоном для закиси азота или без него; тип 2 – без стойки и баллона: настольный; наркозный блок. Тип I имеет 7 комплектов поставки: с баллоном или без него, с двумя или одним из испарителей, комплект для экспорта. Тип 2, настольный, имеет 3 комплекта поставки: с двумя или одним из испарителей. Каждый тип и комплект поставки имеют отдельные обозначения.: тип I – ИЮТЕ 94I62I.001 ; тип 2 – ИЮТЕ 94I62I.002.	70 (с баллоном) 50 (без баллона)	Цена-72 500 руб (модель 301)

Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО4.В03159
действует до 27 02 2003г.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
8.	**Аппарат-приставка искусственной вентиляции легких**	**«Диана»** 94 4460	**ТУ 9444-003-33142130-95**	**ЗАО«Электромедоборудование», г.Санкт-Петербург**	***Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО4.В02461*** *действует до 05 03 2004г* Аппарат-приставка ИВЛ «Диана» имеет предохранительный клапан на линии вдоха, ограничивающий максимальное давление на уровне 6 кПа Аппарат-приставка ИВЛ имеет следующие сигнализации тревожных состояний низкое давление управляющего газа (визуальная-«Р», звуковая сигнализация), длительность фазы вдоха больше 5 с (визуальная-«V», звуковая сигнализация), задержка выдоха более 1 с (визуальная-«V», звуковая сигнализация), частота вентиляции менее 6 дыханий в минуту или более 60 (визуальная сигнализация «F» и «Vm»), задан дыхательный объем менее 0,2 л (звуковая сигнализация), давление в дыхательном контуре ниже уровня 0,2 кПа (визуальная, звуковая сигнализация «V» и «Vm») Vm – дыхательный объем, л, V – минутная вентиляция л/мин, F – частота дыханий, 1/мин Объем минутной вентиляции, л/мин 3 - 50 Объем вдоха, л от 0,2 до 1,4 Частота дыхания – от 6 до 60/1 мин Соотношение вдоха/выдоха 1 2 Максимальное давлении в линии вдоха, кПа 6 Габаритные размеры, мм 215 x 315 x 445 Масса, кг 8,5	35 500 (модель 303)
9.	**Испарители анестетиков**	**«Анестезист-4»**		**то же**	Предназначены для формирования и стабильного дозирования паров жидких анестетиков (фторотана, эфира, энфлюрана) с газом-носителем (кислородом и закисью азота) Испарители выпускаются на каждый анестетик отдельно, устанавливаются в аппаратах ингаляционного наркоза автономно вне дыхательного контура Конструкция обеспечивает плавную дозировку и автоматическую термокомпенсацию установленной концентрации анестетика Испаритель обеспечивает дозирование паров жидких анестетиков в диапазоне концентраций, об % - эфира от 0,5 до 15 - фторотана от 0,1 до 4,5 - энфлюрана *от 0,1 до 5,0* Утечка газа из испарителя при давлении **20 кПа, л/мин** 0,2 Климатическое исполнение УХЛ 4,2 Габаритные размеры испарителя, мм 240 x 137 x 186 Масса испарителя без анестетика, кг 7,5	14 890*

** Приведена цена на модели 304 ФТ, 305 ЭФ, 307ЭН.*

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
10.	**Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных**	**«АДР-125»** 94 4460	**ТУ 25-2005.0029-89**	**ЗАО Электромедоборудование», г.Санкт-Петербург**	***Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО4.В03157*** *действует до 27 02 2003г* Предназначен для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) вручную у новорожденных детей и детей первого года жизни при реанимации и интенсивной терапии в родильных домах и отделениях отделениях реанимации и интенсивной терапии детских больниц и клиник Максимальная минутная вентиляция, л/мин — не более 3 Максимальный объем вдыхаемого газа, мл — не менее 150 *Примечание величины минутной вентиляции и дыхательного объеца определяются оператором* Потеря давления газа в линии пассивного выдоха при измерении на постоянном потоке газа 5 л/мин кПа (мм вод ст) — 0,04 (4) Давление срабатывания предохранительного клапана на вдохе, кПа (мм вод ст) — **4,05**-0,5 (450-**50**) Утечка газа через аппарат при давлении внутри мешка 3 кПа (300 мм вод ст), л/мин — 0,5 Средняя наработка на отказ – не менее $1,7 \times 10^6$ дыхательных циклов Климатическое исполнение — УХЛ 4,2 Габаритные размеры, мм — 350 х 225 х 105 Масса аппарата в полном комплекте поставки, кг — 2 0	7 610 (модель 381)
	Комплект аппарата ИВЛ для новорожденных может быть сформирован по желанию заказчика из следующих элементов (упаковка – пластиковый пакет): мешок типа Амбу маски, воздуховоды, инстубационные трубки, коннекторы, ларингоскоп					
11.	**Комплекс анестезиологический**	**Полинаркон-Э-«Вита»**		**ЗАО «ВНИИМП-ВИТА», Г.Москва**	Комплекс анестезиологический для взрослых и детей (с аппаратом ИВЛ с электромеханическим приводом «Элан-НР») предназначен для проведения ингаляционного наркоза по любому дыхательному контуру с применением самостоятельного дыхания, а также ИВЛ с помощью специального блока или вручную Диапазоны установки подачи газов - кислород – 0,2-2 1-10 л/мин - закись азота – 1-10л/мин Диапазоны подачи паров анестетиков фторотан (галотан) – 0,1-4,5 % об , - энфлюран - 0,1-5 % об , -изофлюран - 0,1-5 % об Габаритные размеры аппарата мм — 750 х 1220 х 700 Масса, кг — 70 Электропитание — ~ 220 В 50 Гц Потребляемая мощность, ВА — 130 Аварийное питание обеспечивается в течение не менее 45 минут	178 000
	Комплектация: Комплекс состоит из аппарата ингаляционного наркоза и аппарата ИВЛ «Элан-НР»(без увлажнителя) Комплектуется дыхательными и газоподводящими шлангами, тройниками пациента коннекторами мешками масками угольниками, баллоном для закиси азота с редуктором					

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
12.	**Аппарат ИВЛ без расхода кислорода на привод ЭЛАН-НР**			**ЗАО «ВНИИМП-ВИТА», Г.Москва**	Аппарат (в комплекте с увлажниетелем «Fisher &Paykel MR 410) предназначен для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у взрослых и детей старше 1 года Электрическое управление аппаратом с использованием управляемого микропроцессором двигателя исключает необходимость расхода сжатых газов на привод Режимы вентиляции – управляемая, вспомогательная задержка на вдохе, ИВЛ вручную, самостоятельное дыхание, переключение со вдоха на выдох по объему или давлени Диапазон установки дыхательного объема, л: 0,03 – 1,5 Диапазон установки частоты вентиляции, 1/мин: от 6 до 80 Минутная вентиляция, л/мин: 0,5 – 30 Габариты основного блока, мм: 360 x 290 x 275 Масса основного блока, кг: 16,5 Электропитание: ~ 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, ВА: 130 Аварийное питание обеспечивается в течение не менее 45 минут.	150 000
	Комплектация: По желанию заказчика аппарат может быть укомплектован монитором измерения содержания кислорода во вдыхаемом газе МИК-01 «ВИТА» и пульсовым оксиметром «Оксипульс-02».					
13.	**Аппараты ИВЛ с ручным приводом**	**АДР**		**то же**	Предназначены для искусственной вентиляции легких при острой дыхательной недостаточности в любых случаях экстренной помощи – в транспортных средствах и стационарах скорой помощи, в экстремальной медицине, родильных домах и отделениях, а также как страховочное устройство – в отделениях интенсивной терапии, реанимации и анестезиологии Для различных возрастных групп пациентов предусмотрены 3 модели отличающиеся конструкцией основной части – масорасправляющегося мешка.	

Характеристика	АДР-300	АДР-600	АДР-1500/500
Возраст пациента	Новорожденные и дети до 3-х лет	Дети от 1 года до 8 лет	Дети от 1 года и взрослые
Макс дыхательный объем, мл	не менее 140	не менее 300	900 / 400
Макс минутная вентиляция, л/мин	3	не менее 6	не менее 25
Объем мешка, мл	300	600	1500/500
Макс давление вдоха, ограничиваемое предохр клапаном, гПа	45	45	60
	возможность блокировки оператором		
Условия эксплуатации	Температура окружающего воздуха от 0 до +40°С		
Масса в футляре из пластмассы/металлическом	1,4 / 3,5 кг	1,6 / 3,5 кг	2,0 / 3,5 кг
Цена . руб.	**4 800**	**4 800**	**4 900**

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
14.	Монитор анестезиологический пятиканальный	МА-509-«ВИТА»		ЗАО «ВНИИМП-ВИТА», Г.Москва	Предназначен для непрерывного неинвазивного и комплексного контроля показателей состояния пациентов в процессе анестезии вентиляционной поддержки, интенсивной терапии и амбулаторной помощи Монитор осуществляет комплексный контроль состояния пациента Насыщение артериальной крови кислородом (SpO_2) Погрешность в диапазоне 85-99% - ±2% (абс), в диапазоне 60-84% - ±2% (абс) Частота пульса (PR) и частота сердечных сокращений (HR) в диапазоне 30-240 1/мин с погрешность ±2 1/мин Содержание CO_2 в конце выдоха ($ETCO_2$) в диапазоне (0-76) мм рт ст с погрешность ±2 мм рт ст Содержание N_2O на вдохе ($Fi\ N_2O$) в диапазоне 0-99% с погрешностью ±5% отн Частота дыхания (RR) в диапазоне 5-60 1/мин с погрешностью ±1 1/мин Артериальное давление (неинвазивное) NiBP SIS, DIA среднее Диапазон измерения Р в манжете 20-280 мм рт ст с погрешностью ±3 мм рт ст Измерение температуры тела в диапазоне 20-45°С Наличие звуковых и световых сигналов тревоги Габаритные размеры мм — 340 x 320 x 150 Масса, кг — 7 Электропитание — ~ 220 В 50 Гц Встроенный аккумулятор — 12 – 14 В Потребляемая мощность от сети ВА — 45	144 00
	<u>Комплектация.</u> Прибор укомплектован датчиками и частями для их присоединения					
15.	Пульсовой оксиметр	ОКСИПУЛЬС-02		то же	Предназначен для непрерывного неинвазивного измерения насыщения кислородом артериальной крови (SpO_2), а также частоты (PR) и наполнения пульса Диапазон измерения SpO_2 – 0 –100% Абсолютная погрешность в диапазоне от 85 до 100% — ± 2% в диапазоне от 60 до 85% — ± 3% Диапазон измерения частоты пульса (PR), 1/мин — 30 – 240 Абсолютная погрешность PR, 1/мин — ± 1 Габаритные размеры, мм — 100 x 200 x 40 Масса, кг — 0 8 Электропитание — ~ 220 В, 50 Гц Встроенный аккумулятор — 12 – 14 В Потребляемая мощность от сети, ВА — 16	19 800

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
I6.	Аппарат искусственной вентиляции легких	ФАЗА-5		ОАО «Уральский приборостроительный завод», г.Екатеринбург	Предназначен для проведения ингаляции кислородно-воздушной смесью, ингаляционного наркоза или длительной управляемой вентиляции легких (ИВЛ). Аппарат выпускается в трех исполнениях: ФАЗА-5НР - для использования в отделениях анестезиологии и реанимации; в комплект входят непосредственно аппарат ИВЛ, наркозная приставка, увлажнитель, адсорбер CO_2;		I54 000
					ФАЗА-5 Н - для использования только в отделениях анестезиологии; в комплект входят непосредственно аппарат ИВЛ с наркозным блоком, увлажнитель, адсорбер CO_2;		
					ФАЗА-5Р - для использования только в отделениях реанимации; в комплект входят непосредственно аппарат ИВЛ, увлажнитель, смеситель.		I17 700
					Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин: от 2 до 37 Диапазон регулирования частоты дыхания, I/мин: автоматическое управление: от I0 до 40 высокочастотный режим: от 40 до I60 Продолжительность вдоха в дыхательном цикле, %: от 30 до I0 Выдох: пассивный Максимальное давление вдоха, см вод. ст.: 60 Температура дыхательной смеси на выходе увлажнителя, °С: от 32 до 38 Привод: электросеть, 220В, 50 Гц Потребляемая мощность, ВА, не более: собственно аппарат ИВЛ: 80 в полном комплекте поставки: 900 Режим работы: длительный Габаритные размеры, мм, не более : непосредственно аппарата ИВЛ: 365х330х280 — I8 наркозной приставки: 385х260хI85 полный комплект в рабочем положении: 700х600хII00 — 70		

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Аппарат искусственной вентиляции легких	"Фаза-9"		ОАО «Уральский приборостроительный завод», г.Екатеринбург	Предназначен для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у новорожденных детей и для детей до 14 лет, обеспечивает проведение ИВЛ с пассивным выдохом, регулируемым сопротивлением выдоху, подогревом и увлажнением дыхательной смеси, подаваемой пациенту. Аппарат имеет пять основных режимов ИВЛ: автоматическую ИВЛ, ИВЛ с периодическим раздуванием легких, спонтанную ИВЛ, синхронизированную перемежающуюся принудительную вентиляцию легких, тригерную ИВЛ. Диапазон регулирования минутной вентиляции при автоматическом режиме, л/мин 0,5 - 10 Диапазон регулирования частоты дыхания, 1/мин 20 - 120 Продолжительность вдоха в дыхательном циклу,% 20 - 80 Переключение дыхательных циклов по времени; по давлению Максимальное давление вдоха (ограничиваемое предохранительным клапаном), см вод.ст. 50 Температура дыхательной смеси тройника пациента, °С 32 - 36 Привод электросеть, 220В, 50Гц Потребляемый ток, А, не более: без увлажнителя 0,5 с увлажнителем 2,0 в режиме дезинфекции 5,0 Масса (непосредственно аппарата), кг 45 Масса комплекта поставки, кг 80 Габаритные размеры, мм - 600x550x1300		162 000
18.	То же, для скорой медицинской помощи	"Фаза-11"		то же	Предназначен для проведения кратковременной управляемой искусственной вентиляции легких у взрослых пациентов во время транспортирования, а также на месте происшествия или на дому (совместно с блоком питания 220/12В). Аппарат имеет три режима ИВЛ: автоматическую ИВЛ, спонтанную ИВЛ с поддержкой потоком газа, ИВЛ с ручным управлением частотой дыхания. Диапазон регулирования минутной вентиляции на режиме "Автомат", л/мин 3 - 25 Диапазон регулирования потока поддержки на режиме "Спонтанное", л/мин 5 -60	11	63 800

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
					Диапазон регулирования частоты вентиляции на режиме «Автомат», 1/мин — от 10 до 60 *Переключение дыхательных циклов – по времени или ручное* Привод – от бортовой сети автомобиля напряжением 12 В Масса аппарата, кг — 10 Масса комплекта поставки, кг — 22	
19.	**Приставка наркозная**	**«ФАЗА-5ПН»**		**Уральский приборостроительный завод, г.Екатеринбург**	Предназначена для создания анестезирующих парогазовых смесей и подачи их через дыхательный контур пациенту Применяется при проведении ингаляционного наркоза закисью азота и жидким анестетиком – фторотаном и позволяет работать как по полуоткрытому, так и по полузакрытому дыхательному контуру. Аппарат может использоваться в автономном режиме, а также в качестве наркозного блока аппаратов ИВЛ (типа «ФАЗА-5», «ФАЗА-11») Дозированный расход газов через приставку, л/мин. - кислород — от 0,2 до 10 - закись азота — от 1 до 10 Диапазон регулирования объемной концентрации паров фторотана, % — от 0,4 до 5 Потребляемая мощность, ВА — 100 Габариты, мм — 385 x 260 x 185 Масса, кг — 7,2	41 800
20.	**Увлажнитель**	**«ТЕРМОФА-ЗА-12»**		**то же**	Предназначен для подогрева и увлажнения дыхательной смеси, поступающей пациенту от аппаратов искусственной вентиляции легких, не укомплектованных собственными увлажнителями , а также для применения в режиме спонтанного дыхания Температура дыхательной смеси на выходе подающего шланга, °С — от 28 до 38 Относительная влажность дыхательной смеси, % — от 80 до 100 Питание — 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, ВА: - в рабочем режиме — 270 - в режиме дезинфекции — 990 Габариты, мм — 235 x 260 x 337 Масса (без воды) кг — 5	25 500

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб. (с 1 09 2002г.)
21.	**Аппарат искусственной вентиляции легких**	**«Фаза-7»**		**ОАО «Уральский приборостроительный завод», г.Екатеринбург**	Предназначен для проведения управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ингаляционного наркоза у взрослых и детей старше 6 лет в процессе проведения реанимационных мероприятий в условиях клинических больниц и научно-исследовательских институтов медицинского назначения Общий диапазон регулирования минутной вентиляции л/мин – от 3 до 25 Общий диапазон регулирования частоты вентиляции, 1/мин – от 10 до 50 Продолжительность вдоха в дыхательном контуре, % от 25 до 75 Питание – электросеть ~220 В, 50 Гц Потребляемый ток, А: - при работе с увлажнителем 4 - при работе без увлажнителя 0,5 Масса (неосредственно аппарата), кг 40 Масса комплекта поставки, кг 100 Габариты, мм 550 x 600 x 1200	375 000
22.	Аппарат ИВЛ	«Фаза-11» комплект №1		то же	Комплект на базе «Фаза-11» предназначен для проведения кратковременной управляемой вентиляции легких у взрослых и детей старше 6 лет в условиях клинических больниц **В комплект входят:** аппарат ИВЛ «Фаза-11», кислородный смеситель, блок питания, передвижная подставка. Масса полного комплекта, кг 35 Габариты полного комплекта, мм 470 x 470 x 1000 Потребляемая мощность, ВА 40	77 00
23.	Аппарат ИВЛ	«Фаза-11» комплект №2		«	Комплект на базе «Фаза-11» и автономного увлажнителя «ТЕРМОФАЗА-12» предназначен для проведения длительной управляемой вентиляции легких у взрослых и детей старше 6 лет в условиях клинических больниц **В комплект входят:** аппарат ИВЛ «Фаза-11», увлажнитель «ТЕРМОФАЗА-12», кислородный смеситель, блок питания, передвижная подставка Масса полного комплекта, кг 40 Габариты полного комплекта, мм 470 x 470 x 1200	102 300

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
24.	Аппарат ИВЛ	«Фаза-11» комплект №3		ОАО «Уральский приборостроительный завод», г.Екатеринбург	Комплект на базе «Фаза-11» и приставки наркозной «ФАЗА-5ПН» предназначен для проведения ингаляционного наркоза или для проведения кратковременной управляемой вентиляции легких у взрослых и детей старше 6 лет в условиях клинических больниц **В комплект входят:** аппарат ИВЛ «Фаза-11», наркозная приставка «ФАЗА-5ПН», блок питания, передвижная подставка Масса полного комплекта, кг 40 Габариты полного комплекта, мм 700 x 470 x 1050 Потребляемая мощность полного комплекта, ВА 140	117 700
25.	Аппарат ИВЛ	«Фаза-11» комплект №4		то же	Комплект на базе «Фаза-11» автономного увлажнителя «ТЕРМОФАЗА-12» и приставки наркозной «ФАЗА-5ПН» предназначен для проведения ингаляций кислородно-воздушной смесью, ингаляционного наркоза или для проведения длительной управляемой вентиляции легких с увлажнением и подогревом смеси у взрослых и детей старше 6 лет в условиях клинических больниц **В комплект входят:** аппарат ИВЛ «Фаза-11», наркозная приставка «ФАЗА-5ПН», увлажнитель «ТЕРМАФАЗА-12», блок питания, передвижная подставка Масса комплекта поставки, кг 45 Габариты комплекта в рабочем положении, мм 700 x 470 x 1200	141 900
26.	Монитор измерения содержания кислорода	МИК-01-«ВИТА»		ЗАО «ВНИИМП-ВИТА», Г.Москва	Предназначен для длительного непрерывного измерения процентного содержания кислорода во вдыхаемом воздухе или другой газовой смеси Использование этого показателя в сопоставлении с проявлениями гипо- или гипероксии и результатами оценки оксигенации другими инструментальными методами позволяет установить оптимальную для данного пациента вдыхаемую концентрацию кислорода Диапазон измерения, % 0 – 99,9 Предел допускаемой погрешности в диапазоне 0-24 %об - ±0,7% об (абс), 24-99,9 %об - ±2,5% об (относ), Габариты, мм 100 x 200 xз 55 Масса, кг 1,5 Электропитание ~ 220 В 50 Гц Встроенный аккумулятор = 12 – 14 В Мощность потребляемая от сети, ВА 15	14 000

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Модель	Технические характеристики	Цена, руб.
27.	Аппарат ИВЛ	РО-6-04		ОАО «Красногвардеец», г.Санкт-Петербург	212575	Аппарат искусственной вентиляции легких с блоком подачи кислорода, увлажнителем УДС-2 и встроенной системой сигнализации	205 500
					22575	Аппарат ИВЛ с блоком подачи кислорода, увлажнителем УДС-2 газоанализатором ГКМ и встроенной системой сигнализации	233 300
					23575	Аппарат ИВЛ с блоком подачи кислорода, увлажнителем УДС-2 отсасывателем экссудата ЭОХМ-1 и встроенной системой сигнализации	221 250
					24575	Аппарат ИВЛ с блоком подачи кислорода, увлажнителем УДС-2, газоанализатором ГКМ, отсасывателем экссудата и встроенной системой сигнализации	249 100
					32575	Аппарат ИВЛ с наркозным блоком, увлажнителем УДС-2 и встроенной системой сигнализации	247 950
					34575	Аппарат ИВЛ с наркозным блоком увлажнителем УДС-2, газоанализатором ГКМ и встроенной системой сигнализации	275 750
					35575	Аппарат ИВЛ с наркозным блоком увлажнителем УДС-2, газоанализатором ГКМ, отсасывателем экссудата и встроенной системой сигнализации	291 600
28.	то же	РО-6-06			21574	Аппарат ИВЛ с блоком подачи кислорода, увлажнителем УДС-2 и встроенной системой сигнализации	212 500
					22574	Аппарат ИВЛ с блоком подачи кислорода, увлажнителем УДС-2, газоанализатором ГКМ и встроенной системой сигнализации	240 800
					23574	Аппарат ИВЛ с блоком подачи кислорода, увлажнителем УДС-2, отсасывателем экссудата и встроенной системой сигнализации	228 450
					24574	Аппарат ИВЛ с блоком подачи кислорода, увлажнителем УДС-2 газоанализатором ГКМ, отсасывателем экссудата и встроенной системой сигнализации	256 650
					31574	Аппарат ИВЛ с наркозным блоком и встроенной системой сигнализации	204 150
					32574	Аппарат ИВЛ с наркозным блоком увлажнителем УДС-2 и встроенной системой сигнализации	254 950
					33574	Аппарат ИВЛ с наркозным блоком, газоанализатором ГКМ и встроенной системой сигнализации	232 450
					34574 (35574)	Аппарат ИВЛ с наркозным блоком увлажнителем УДС-2, газоанализатором ГКМ (отсасывателем экссудата) и встроенной системой сигнализации	283 250 (299 200)

3. ПРИБОРЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Эхоэнцефалоскоп	ЭЭС-I2		Завод "ЭМА", г.Москва	Предназначен для ультразвуковой диагностики заболеваний головного мозга объемного характера. Предусмотрено питание прибора как от сети переменного тока, так и от аккумулятора автомобиля, что делает его незаменимым в машинах скорой помощи. Рабочие частоты, МГц — 0,88 ; I,76 Разрешающая способность, мм : на частоте 0,88 МГц — 5 на частоте I,76 МГц — 3 Глубина зондирования,мм: на частоте 0,88 — 500 на частоте I,76 — 300 Напряжение сети переменного тока, В — 220 Мощность, потребляемая от сети, В·А — 75 Напряжение аккумуляторной батареи, В — I2 Мощность, потребляемая от батареи, Вт — 30 Диапазон измерений, мм — 20–200 Цена деления шкалы, мм — I Габаритные размеры, мм — 455x260x235	I0	Цена – 66 500 руб.
2.	Коагулограф самопишущий	Н334 9443I30026	ТУ25-04. 3I59-77	ОАО "Краснодарский ЗИП", г.Краснодар	Предназначен для исследования системы свертывания крови в клинико-диагностических лабораториях больниц, поликлиник и в других медицинских учреждениях. Точность измерения по амплитуде, % — 2,5 Рабочий объем ячейки, мл — 0,28 Температура в зоне расположения рабочей ячейки, °С — 37 Скорость движения диаграммной ленты, мм/мин — I0 Напряжение питания, В — 220 Частота, Гц — 50 Потребляемая мощность, В·А — 30 Температура окружающего воздуха, °С — от +I0 до +35 Относительная влажность при 25 °С, % — 80 Габаритные размеры, мм — I75xI25x270	5,5	Цена – – 9 705 руб

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена ($ США).
	Универсальный комплекс для исследования биоэлектрической активности головного мозга с функциями полиграфа.				
3.	Электроэнцефалографы	Нейрон-Спектр-4	ООО «НейроСофт», г.Иваново	21-канальный электроэнцефалограф европейского класса ***с двойным комплектом ЭЭГ-электродов***	5600/6780*
		Нейрон-Спектр-3		«классический» 19-канальный электроэнцефалограф	4400/5580*
		Нейрон-Спектр-2		16-канальный электроэнцефалограф	4000/5180*
		Особенности электроэнцефалографов. ♦ 21/ 19 / 16 каналов ЭЭГ /длиннолатентных ВП (до 32 цифровых отведений) ***Диапазон частот входных сигналов ЭЭГ расширен до 200 Гц, частота квантования 1000 Гц, 16-разрядный АЦП, уровень шума во всех диапазонах частот менее 0,8 мкВ.*** ♦ полиграфический канал ЭКГ / ЭМГ /ЭОГ /КГР, канал дыхания ♦ раздельно управляемые слева и справа фото- и фоностимуляторы ♦ индикация на передней панели качества установки электродов ♦ полноценное (на канале с частотой квантования 2000 Гц) исследование состояния вегетативной нервной системы с помощью спектрального анализа вариабельности ритма сердца при наличии программы «Поли-Спектр-Ритм» ***Базовый комплект поставки:*** ♦ блок электроэнцефалографа на стойке фотостимулятор на стойке, фоностимулятор ♦ комплект мостиковых или чашечковых ЭЭГ-электродов (25 электродов с кабелями, 3 ушных электрода, 3 шлема разных размеров) ***для «Нейрон-Спектр-4» - двойной комплект.*** ♦ набор электродов (3 прижимных) и кабель отведений для регистрации 1 канала ЭКГ ♦ программное обеспечение для регистрации и хранения ЭЭГ, а также амплитудного спектрального, корреляционного и когенрентного анализа ЭЭГ с топографическим картированием	**** цена без компьютера / с «элегантным» компьютером и лазерным принтером***
4.	Электроэнцефалограф	Нейро-Спектр-2/Р	то же	16-канальный электроэнцефалограф с блоком 4-канальной реоэнцефалографии и функцией оценки мозговой фракции сердечного выброса **** цена без компьютера / с «элегантным» компьютером и лазерным принтером***	6400/7580*
5.	То же (переносной)	Нейро-Спектр-3/П	«	19-канальный электроэнцефалограф с фото- и фоностимуляторами и портативный компьютер Notbook в одной сумке	6200
6.	Электроэнцефалограф	Нейро-Спектр-1	«	8-канальный электроэнцефалограф ***Особенности*** 8 каналов ЭЭГ / длиннолатентных ВП 1 канал ЭКГ	2900/3930*
		Базовый комплект поставки: ♦ блок электроэнцефалографа на штативе фотостимулятор на штативе фоностимулятор ♦ набор из 15-ти мостиковых/чашечковых и 3-х ушных электродов ЭЭГ, отводящих кабелей 3-х шлемов разного размера ♦ наобр электродов (3 прижимных) и кабель отведений для регистрации 1 канала ЭКГ ♦ программное обеспечение для регистрации и хранения ЭЭГ а также амплитудного, спектрального, корреляционного и когенрентного анализа ЭЭГ с топографическим картированием **** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером***		

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена ($ США).
7.	**Многофункциональный комплекс**	**Нейрон-Спектр-4/ВП**	**ООО «НейроСофт», г.Иваново**	26-канальный многофункциональный комплекс европейского класса для исследования ЭЭГ, КОРОТКО- и длиннолатентных вызванных потенциалов мозга зрительных, слуховых, соматосенсорных и когнитивных ***Особенности «Нейрон-Спектр-4/ВП»:*** ♦ 21 канал ЭЭГ /длиннолатентных ВП (до 32 цифровых отведений) ***Диапазон частот входных сигналов ЭЭГ расширен до 200 Гц, частота квантования 1000 Гц, 16-разрядный АЦП, уровень шума во всех диапазонах частот менее 0,8 мкВ.*** ♦ 4 канала КОРОТКОЛАТЕНТНЫХ ВП /ЭМГ / ЭКГ / ЭОГ / КГР ***Полоса пропускания 0,05 – 10000 Гц, частота квантования 40 – 160 кГц на канал.*** ♦ канал дыхания ♦ раздельно управляемые слева и справа фото- и фоностимуляторы ♦ индикация на передней панели качества установки электродов ***Базовый комплект поставки:*** ♦ блок электроэнцефалографа на стойке, фотостимулятор на стойке, фоностимулятор ♦ ***двойной комплект*** мостиковых или чашечковых ЭЭГ-электродов 2х(25 электродов **с кабелями**, 3 ушных электрода, 3 шлема разных размеров) ♦ набор электродов (3 прижимных) и кабель отведений для регистрации 1 канала ЭКГ ♦ набор чашечковых электродов (8 шт) для регистрации ВП, 2 шлема для крепления электродов ♦ набор стимуляторов для регистрации ВП токовый, слуховой, зрительный ♦ адаптер для управления монитором паттерн-стимулятора (монитор в комплект не входит) ♦ программное обеспечение	7300/8480* ** цена без компьютера / с «элегантным» компьютером и лазерным принтером*
8.	**Прибор для исследования вызванных потенциалов мозга**	**«Нейро-ВП-4»**	**то же**	4-канальный прибор для исследования КОРОТКО-, средне- и длиннолатентных слуховых, , зрительных, соматосенсорных и когнитивных вызванных потенциалов мозга ***Диапазон частот 0,05 – 20000 Гц, частота квантования 40 – 160 кГц на канал, 16-ти разрядный АЦП, уровень шума в полосе 2 Гц – 20 кГц не более 3 мкВ (от пика до пика)..*** ***Комплект поставки:*** ♦ блоки усилителя, аудивидеостимулятора, , управления токовым стимулятором, регистрации реакции пациента, ♦ зрительные (очки, паттерн), слуховой, токовые стимуляторы ♦ набор чашковых электродов для регистрации ВП (8 шт), 2 шлема для крепления электродов ♦ паста электродная клеящая, паста абразивная для подготовки кожи ♦ программное обеспечение **** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером***	7200/8230*
9.	**Многооконный компьютерный эхоэнцефалограф**	**Сономед-315/М**	«	Ультразвуковой прибор для эхоэнцефалографических обследований -цена с одним комплектом датчиков без компьютера/ с компьютером и принтером – 2150/3000 -цена с двумя комплектами датчиков без компьютера/ с компьютером и принтером – 2500/3350	

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена ($ США).
10.	Портативный эхоэнцефалограф	Сономед-315/П	ООО «НейроСофт», г.Иваново	Предназначен для диагностики и определения размеров структур головного мозга Цена с одним комплектом датчиков / с двумя комплектами датчиков - 1500/1850	
11.	Эхоэнцефалограф переносной	ЭЭС-12	то же	Предназначен для визуального исследования внутренних структур головного мозга, обнаружения опухолей и других образований объемного характера, а также для определения некоторых патологических состояний мозга	2100
12.	Вегетотестер	ВНС-Ритм	«	Прибор предназначен для исследования вариабельности ритма сердца ***Особенности «ВНС-Ритм»:*** ♦ 2 канала ЭКГ ♦ *программа анализа вариабельности ритма сердца «Поли-Спектр-Ритм»* ♦ оборудование для выполнения кардиоваскулярных тестов тонометр, манометр с приставкой и комплектом манштуков для проведения пробы Вальмальвы, кистевой динамометр **** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером***	1000/2030*
13.	Вегетотестер	ВНС-Микро	«	Прибор предназначен для исследования вариабельности ритма сердца ***Особенности «ВНС-микро»:*** ♦ 1 канала ЭКГ и 1 канал дыхания ♦ программа анализа вариабельности ритма сердца «Поли-Спектр-Ритм» ♦ программа и оборудование для кросс-анализа вариабельности длительности дыхательного цикла и вариабельности ритма сердца (с 2-мя датчиками дыхания) ♦ оборудование для выполнения кардиоваскулярных тестов тонометр, манометр с приставкой и комплектом манштуков для проведения пробы Вальмальвы, кистевой динамометр **** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером***	1200/2230*
14.	Вегетотестер	ВНС-Спектр	«	Прибор предназначен комплексного для исследования вегетативной нервной системы ***Особенности «ВНС-Спектр»:*** ♦ 8 каналов вызванных кожных симпатических потенциалов (ВКСП) ♦ каналы ЭКГ, дыхания, температуры ♦ токовый, зрительный и слуховой стимуляторы ♦ программа анализа вызванных кожных симпатических потенциалов ♦ программа анализа вариабельности ритма сердца «Поли-Спектр-Ритм»	2750/3780*

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена ($ США).
				♦ программа и оборудование для кросс-анализа вариабельности длительности дыхательного цикла и вариабельности ритма сердца (с 2-мя датчиками дыхания) ♦ оборудование для выполнения кардиоваскулярных тестов тонометр, манометр с приставкой и комплектом манштуков для проведения пробы Вальмальвы кистевой динамометр ** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером*	
15.	**Электронейромиограф**	**Нейро-МВП-4**	**ООО «НейроСофт», г.Иваново**	4-канальный электронейромиограф с функциями исследования слуховых, зрительных соматосенсорных и когнитиевых (P300, MNN, CNV) вызванных потенциалов мозга ***Диапазон частот 0,05-20000 Гц, частота квантования 40-160 кГц на канал, 16-разрядный АЦП, уровень шумов в полосе 2 Гц – 20 кГц не более 3 мкВ (от пика до пика).*** ***Комплект поставки:*** ♦ блок усилителя, управления токовым стимулятором, аудивидеостимулятора, регистрации реакции пациента ♦ комплект электродов для электронейромиографических исследований ♦ набор чашковых электродов для регистрации ВП (8 шт), 2 шлема для крепления электродов ♦ набор стимуляторов зрительные, слуховой, токовый ♦ паста электродная клеящая, паста абразивная для подготовки кожи, гель электродный ♦ программное обеспечение	8000/9180* ** цена без компьютера / с «элегантным» компьютером и лазерным принтером*
16.	**Магнитный стимулятор**	**Нейро-МС**	**то же**	Предназначен для воздействия на моторные зоны коры головного мозга и периферической нервной системы Применяется в неврологии, эпилептологии, пульмонологии педиатрии, офтальмологии, травматологии и ортопедии. ***Комплект поставки:*** ♦ блок магнитного стимулятора ♦ индуктор кольцевой МИ-150 и индуктор «бабочка» МИ-Б-150 ♦ индуктор кольцевой малый МИ-100 ♦ кабель связи с внешним устройством	5500
17.	**Электронейромиограф**	**Нейро-ЭМГ-4**	«	4-канальный компьютерный электронейромиограф ***Комплект поставки:*** ♦ блок усилителя, управления токовым стимулятором ♦ комплект электродов для электронейромиографических исследований ♦ токовый стимулятор, гель электродный ♦ программное обеспечение ** цена без компьютера / с «элегантным» компьютером и лазерным принтером*	7000/8180*

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена ($ США).
18.	**Электронейромиограф портативный**	**Нейро-ЭМГ-Микро**	**ООО «НейроСофт», г.Иваново**	4-канальный портативный компьютерный электронейромиограф ***Комплект поставки:*** ♦ блок электронейромиограф на штативе ♦ комплект электродов для электронейромиографических исследований ♦ токовый стимулятор, гель электродный, паста клеящая, паста абразивная ♦ программное обеспечение **** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером***	4000/5030*
19.	**Электрокардиограф**	**Поли-Спектр-12**	**то же**	Миниатюрный 12-канальныйэлектрокардиограф с программой контурного анализа ЭКГ «Поли-Спектр-Анализ» ***Особенности:*** ♦ АЦП – 24 бит, частота квантования 1000 Гц ♦ Возможность регистрации ЭКГ высокого разрешения (для анализа поздних потенциалов желудочков) ♦ Возможность записи ЭКГ в условиях нагрузочных проб ♦ Возможность подключения двух датчиков артериального пульса, микрофона сердечных звуков, а также программы ввода и анализа ФКГ и СФГ «Поли-Спектр-ФС» ♦ Габаритные размеры электронного блока – 150x200x60 мм ♦ Масса (с кабелем отведений и электродами) – 1,2 кг **** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером***	1300/2330*
20.	**Электрокардиограф**	**Поли-Спектр-8/Е**	«	Суперминиатюрный 12-канальныйэлектрокардиограф с программой контурного анализа ЭКГ «Поли-Спектр-Анализ» ***Особенности:*** ♦ АЦП – 12 бит, частота квантования 2000 Гц ♦ Возможность регистрации ЭКГ высокого разрешения (для анализа поздних потенциалов желудочков) ♦ Возможность записи ЭКГ в условиях нагрузочных проб ♦ Габаритные размеры электронного блока – 150x70x25 мм ♦ Масса (с кабелем отведений и электродами) – 0,6 кг **** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером***	1000/2030*
21.	**Электрокардиограф**	**Поли-Спектр-8**	«	Суперминиатюрный 12-канальныйэлектрокардиограф предназначен для использования при массовых ЭКГ-обследованиях ***Особенности:*** ♦ АЦП – 12 бит частота квантования 2000 Гц ♦ Габаритные размеры электронного блока – 150x70x25 мм ♦ Масса (с кабелем отведений и электродами) – 0,6 кг **** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером***	850/1880*

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена ($ США).
22.	Реографы	Рео-Спектр-3	ООО «НейроСофт», г.Иваново	Многофункциональный 6-канальный компьютерный реограф (с наборами электродов для РЭГ РВГ, РКГ по Кубечеку и Тищенко, РЭКГ по Палееву и одного отведения ЭКГ)	3300/4330*
		Рео-Спектр-2		Многофункциональный 4-канальный компьютерный реограф (с наборами электродов для РЭГ, РВГ, РКГ по Кубечеку и Тищенко, РЭКГ по Палееву и одного отведения ЭКГ)	2650/3680*
		Рео-Спектр-2/В		4-канальный реовазограф с набором электродов для РВГ (плечо, предплечье, кисть, палец, бедро, голень, стопа) и одного отведения ЭКГ	2350/3380*
				Особенности «Рео-Спектр-3, 2, 2/В»: ♦ 6 / 4 реографических канала с временным разделением ♦ задаваемая отдельно для каждого канала частота измерительного тока ♦ каждый канал может работать как в биополярном, так и в тетраполярном режиме ** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером*	
23.	Компьютерный спирометр пневмотахометрического типа	Спиро-Спект-2	то же	Спирометр с повышенной точностью измерений (с калибровочным шприцем) предназначен для диагностики нарушений вентиляционной способности легких ***Комплект поставки:*** ♦ электронный блок (габариты – 40х40х170 мм; масса – 350г) ♦ комплект импульсных трубок ♦ комплект пневмопреобразователей ♦ комплект мунштуков, носовой зажим (2 шт) ♦ калибровочный шприц ♦ программное обеспечение, сумка для переноски ** цена без компьютера / с «функциональным» компьютером и лазерным принтером*	1300/2330*
24.	Многооконный ультразвуковой прибор	Сономед-325/М	«	Многооконный ультразвуковой прибор для доплеровских и эхоэнцефаалографических исследований (с доплеровскими датчиками непрерывного излучения 4 и 8 МГц, импульсного излучения 2 МГц и комплектом датчиков 1 МГц для эхоэнцефаалографии)	6450 (с компьютером и принтером)
25.	Эхокардиограф	Сономед-400/К	«	Эхокардиограф на основе многофункционального ультразвукового сканера электронного сканирования с доплеровским блоком (с микроконвексным датчиком 3,5 МГц (С13))	11900
26.	Сканер	Сономед-400/А	«	Многофункциональный 16-канальный ультразвуковой сканер электронного сканирования (с линейным / конвексным датчиком) ** цена с двумя адаптерами для подключения датчиков и компьютером.*	4900*
27.	Сканер	Сономед-400/В	«	Многофункциональный 32-канальный ультразвуковой сканер электронного сканирования (с линейным / конвексным датчиком) ** цена с двумя адаптерами для подключения датчиков и компьютером.*	5500*

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена ($ США).
28.	**Сканер**	**Сономед-400/С**	**ООО «НейроСофт», г.Иваново**	Многофункциональный 32-канальный ультразвуковой сканер электронного сканирования в оригинальном корпусе с функциональной клавиатурой (с линейным / конвексным датчиком) **** цена с двумя адаптерами для подключения датчиков и компьютером.***	6000*
29.	**Сканер**	**Сономед-400Д/А**	**то же**	Многофункциональный 16-канальный ультразвуковой сканер с доплеровским блоком (с линейным / конвексным датчиком) **** цена с компьютером.***	9000*
30.	**Сканер**	**Сономед-400Д/В**	**«**	Многофункциональный 32-канальный ультразвуковой сканер с доплеровским блоком (с линейным / конвексным датчиком) **** цена с компьютером.***	10 300*
31.	**Сканер**	**Сономед-400Д/С**	**«**	Многофункциональный 32-канальный ультразвуковой сканер с доплеровским блоком в оригинальном корпусе с функциональной клавиатурой (с линейным / конвексным датчиком) **** цена с компьютером.***	11 300*
32.	**Портативный ультразвуковой доплерограф**	**«Минимакс-допплер-фоно»** 94 4280	**ООО «СП Минимакс», г.Санкт-Петербург**	**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 9441-001-20819831-98.** ***Сертификат соответствия № 4418766 от 09.04.01г.*** Имеет три исполнения ММ-Д-Ф-2-01 ММ-Д-Ф-5-02 ММ-Д-Ф-10-03 Прибор применяется в кардиологии, сосудистой хирургии, неврологии, акушерстве и гинекологии, педиатрии, скорой помощи Размер – 196 х 112 х 34 мм Масса – 280 г	2 300
33.	**Прибор**	**«Минимакс-допплер-К»** 94 4280	**то же**	**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТУ 9441-002-20819831-98.** ***Сертификат соответствия № 4418765 от 09.04.01г.*** Имеет три исполнения ММ-Д-К-5-01, ММ-Д-К-10-02 ММ-Д-К-20-03 Прибор применяется в кардиологии, травматологии сосудистой хирургии челюстно-лицевой хирургии , офтальмологии, стоматологии, микрохирургии физиотерапии, косметологии, неврологии, эндокринологии	11 000 (в полной комплектации)

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование оборудования изделия</th><th>Тип, марка. Код ОКП</th><th>ГОСТ или ТУ</th><th>Завод-изготовитель</th><th>Технические характеристики</th><th>Цена, руб.</th></tr>
<tr><td>34.</td><td>Лазерные аппараты Внутривенного облучения крови</td><td>АЛОК-1;
94 4432
АЛОК-2;
94 4419</td><td>ЩФ 3.950.007ТУ
ЩФ 3.950.010ТУ</td><td>ОАО «Плазма», г.Рязань</td><td>Внутривенное лазерное облучение крови активизирует энергетические ферменты эритроцитов, что ускоряет обмен веществ в ишимизированных органах и тканях, оказывает гипотензивное действие, обладает анальгезирующим и противовоспалительным эффектом
Метод результативен при лечении:
◆ хронической ишемической болезни сердца,
◆ острого инфаркта миокарда,
◆ облитерирующих заболеваний сосудов,
◆ воспалительных заболеваний внутренних органов.
Аппарат АЛОК –1, -2 разрешены к применению Минздравом РФ.
<table><tr><th>Параметр</th><th>АЛОК-1</th><th>АЛОК-2</th></tr><tr><td>Количество каналов</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>Длина волны излучения, мкм</td><td>0,63</td><td>0,63</td></tr><tr><td>Мощность излучения мВт</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>Время экспозиции, мин</td><td>30, 60</td><td>30, 40, 60</td></tr><tr><td>Диаметр световода, мм</td><td>1,0</td><td>0,8</td></tr><tr><td>Питание</td><td colspan="2">220В, 50 Гц</td></tr><tr><td>Потребляемая мощность ВА</td><td>45</td><td>150</td></tr><tr><td>Габаритные размеры, мм</td><td>410x265x115</td><td>320x300x845</td></tr><tr><td>Масса, кг</td><td>6,5</td><td>15</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>35.</td><td>Одноканальный лазерный аппарат чрескожного облучения</td><td>АЛОК-2М</td><td></td><td>то же</td><td>Чрескожное облучение может применяться для:
◆ надвенного лазерного облучения крови неинвазивным способом,
◆ лечение верхних дыхательных путей,
◆ снятие приступов астмы,
◆ снижение уровня сахара в крови
◆ лечение ангиопатии нижних конечностей,
◆ лечение ишемической болезни сердца путем облучения зон Захарьина-Геда
<table><tr><td>Длина волны излучения, мкм</td><td>0,63</td></tr><tr><td>Мощность излучения, мВт</td><td>25</td></tr><tr><td>Диапазон выдержки, сек</td><td>1 – 9,999</td></tr><tr><td>Питание</td><td>220 В, 50 Гц</td></tr><tr><td>Потребляемая мощность, ВА</td><td>100</td></tr><tr><td>Габаритные размеры, мм</td><td>410 x 320 x 1050</td></tr><tr><td>Масса, кг</td><td>20</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Аппарат для СМВ терапии	СМВ-150-1 "Луч-II"		Завод "ЭМА", г.Москва	Аппарат представляет собой магнетронный генератор электромагнитного излучения сверхвысокой частоты - 2450 МГц. Предназначен для воздействия с лечебными целями на пациентов энергией сверхвысоких частот. Напряжение питания, В 220; Частота, Гц 50; Рабочая частота, МГц 2450; Выходная мощность, Вт: максимальная от 127 до 173, минимальная от 8 до 16; Регулировка мощности ступенчатая; Число ступеней 7; Мощность, потребляемая от сети, ВхА, не более 800; Габаритные размеры, мм 530х520х2050	25 (без комплекта)	Цена - 36 700 руб
37.	Аппарат для лечения токами надтональной частоты	Ультратон ТНЧ-10-01		то же	Аппарат представляет собой генератор синусоидальных колебаний надтональной частоты с высоковольтным выходом. Применяется в гинекологии, косметологии, педиатрии, хирургии. Частота высокочастотных колебаний, кГц 22; Наибольшая выходная мощность, Вт 10; Потребляемая мощность, Вт, не более 80; Питание от сети переменного тока; напряжение, В 220; частота, Гц 50, 60; Габаритные размеры, мм 345х255х160	7,5 (с комплектом)	Цена - 11 400
38.	Аппарат для ультразвуковой терапии	УЗТ-1.01 Ф		"	Предназначен для лечения ультразвуком различных заболеваний периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Работает как в непрерывном, так и в импульсном режимах. По защите от поражения электрическим током выполнен по классу I, тип В. Питание от сети переменного тока, напряжением, В 220; Потребляемая мощность, ВхА, не более 50; Частота ультразвуковых колебаний, МГц 0,88; Эффективная площадь излучателей, см.кв.: ИУТ 0,88-1.03 Ф 1; ИУТ 0,88-4.04 Ф 4; Регулировка отдаваемой мощности ступенчатая	7	Цена - 13500

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Аппарат для индуктотерапии коротковолновый	ИКВ-4		Завод "ЭМА", г.Москва	Предназначен для прогревания с помощью воздействия электромагнитного поля тканей человеческого тела, обладающих большой удельной электрической проводимостью (тканевые жидкости, кровь, лимфа и наиболее богато снабжаемые ими ткани). Напряжение питания, В — 127 или 220 Частота, Гц — 50 Рабочая частота, МГц — 13,56 Номинальная выходная мощность, Вт — 200 Мощность, потребляемая из сети, ВхА — не более 1200 Габаритные размеры, мм — 900х550х520 В комплект поставки входят: электродержатель, индикатор настройки УВЧ-аппаратов; сменные части: индуктор резонансный малый, индуктор резонансный большой, согласующее устройство, два индуктора кабельных, запасные части паспорт.	110	Цена - 56 500
40.	Аппарат для дециметровой терапии	Волна-2М		то же	Аппарат представляет собой генератор электромагнитного излучения, позволяющий в терапевтических целях осуществлять дозированное воздействие на пациента электромагнитным полем частотой 460 МГц. Рекомендуется для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и мышц. Напряжение питания, В — 127 или 220 Частота, Гц — 50 Рабочая частота, МГц — 460 Выходная мощность, Вт: минимальная — 15 максимальная — 100 Интервалы изменения выходной мощности от 15 до 100 по ступеням: на первых четырех ступенях, Вт — 15 на последних пяти ступенях, Вт — 20 Мощность, потребляемая из сети, ВхА — 550 Габаритные размеры, мм — 615х515х900 В комплект поставки входят: излучатели диаметром 90 мм, 110 мм, 140 мм, излучатель облегающий, излучатель 205х95 мм, держатели, защитные очки.	80	Цена - 36 600

4. ОБОРУДОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
1.	Стоматологическая установка 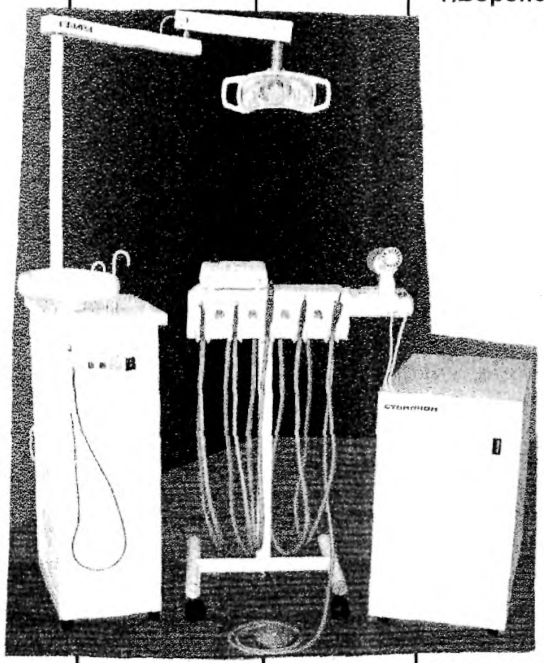	«КОМСТА-1»; «КОМСТА-1Э»		ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж	Отличие «КОМСТА-1Э» от «КОМСТА-1» состоит в том, что вместо пневматического микромотора используется электрическая бормашина «ЭЛБОР 3/40». **В комплект «КОМСТА-1» входят:** - ***Бормашина БПС 300/40М,*** укомплектованная: ❖ двумя турбинными наконечниками; ❖ микромотором с прямым и угловым наконечниками; ❖ инструментом для снятия зубного камня; ❖ пистолетом вода-воздух-спрей; ❖ в бормашине используется дистиллированная вода из встроенного резервуара. - ***аппарат светоотверждения «ОПТРАДЕНТ-МЦ-04»*** - ***компрессор воздушный безмасляный «СТОМАКОМ КС-60-03»*** - ***гидроблок ГС-03,*** содержащий светильник «УНИЛЮКС-ССМ-28», слюноотсос, емкость для воды и жидких отходов по 5 л.	62 000 74 000
2.	То же	«КОМСТА-4»		То же	**В комплект «КОМСТА-4» входят:** - ***Бормашина БПС 300/40М,*** укомплектованная: турбинным наконечником; микромотором с прямым и угловым наконечниками; пистолетом вода-воздух-спрей; в бормашине используется дистиллированная вода из встроенного резервуара. - ***компрессор воздушный безмасляный «СТОМАКОМ КС-60-03».***	36 500
3.	«	УС-01-03 «Селена-2000»		«	**В комплект УС-01-03 «Селена-2000» входят:** - ***Бормашина БПС 300/40М,*** укомплектованная: турбинным наконечником; электрическим микромотором с прямым и угловым наконечниками; пистолетом вода-воздух-спрей. - ***компрессор воздушный безмасляный «СТОМАКОМ КС-60-03»*** - ***гидроблок ГС-03***	50 800

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
4.	**Стоматологическая установка**	**«КОМСТА-5»; УС-01-01 «Селена-2000»**		**ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж**	Отличие «УС-01-01 «Селена-2000» от «КОМСТА-5» состоит в том, что вместо пневматического микромотора используется электрический **В комплект «КОМСТА-5» входят:** - ***Бормашина БПС 300/40М,*** укомплектованная турбинным наконечником, микромотором с прямым и угловым наконечниками; пистолетом вода-воздух-спрей, в бормашине используется дистиллированная вода из встроенного резервуара - ***компрессор воздушный безмасляный «СТОМАКОМ КС-60-03»*** - ***гидроблок ГС-03,*** содержащий светильник «УНИЛЮКС-ССМ-28», слюноотсос, емкость для воды и жидких отходов по 5 л	51 000 11 000
5.	«	**УС-01-05 «Селена-2000»**		**то же**	Оказание стоматологической помощи в медицинских учреждения и в частной практике Все блоки установки закреплены на кресле **В комплект входят:** - ***Бормашина*** с турбинными наконечниками, электрическим микромотором мощность 60 Вт с прямым и угловым наконечниками, пистолетом вода-воздух-спрей, инструментом для снятия зубного камня, - ***негатоскоп А4;*** - ***компрессор воздушный безмасляный «СТОМАКОМ КС-60-03»*** - ***кресло стоматологическое*** электромеханическое «КСЭМ-200-СТОМЭЛ», оснащенное гидроблоком ГС-05, - ***стул для ассистента.***	106 400
6.	**Бормашина электрическая портативная**	**«ЭЛБОР-3/40И»**		«	- Диапазон регулирования скорости вращения – от 3 000 до 40 000 об/мин, - Обеспечение изменения направления, - Мощность на валу электродвижителя – до 60 Вт, - Используемые наконечники – НП-40М, НУ-40М НСТ-20М, - Питание - ~ 220В, 50Гц, - Диаметр электродвижителя – 20 мм, - Режим работы – ПВ-40%	
7.	**Слюноотсос (ГС без тумбы)**			«	Слюноотсос электрический предназначен для удаления жидких отходов из полости рта пациента при оказании стоматологический помощи В комплект поставки входит 10 одноразовых наконечников Питание ~ 220В 50Гц Потребляемая мощность, ВА 10 Минимальное разрежение при нулевом расходе, Па -4,5х10000 Производительность по воде, не менее, л 7 Масса, кг 0,8	3 100

№ п/п	Наименование Оборудования Изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
8.	**Аппарат светоотверждения композитных пломбировочных материалов автоматизированный**	**АСКМ 10/60 «Оптрадент-2» МЦ-04**		**ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж**	Корпус их ударопрочного полистирола с современным дизайном, аппарат имеет встроенный индикатор мощности излучения, кнопку и индикатор режима работы лампы (через 10 секунд до 60 секунд) Малошумящий вентилятор обеспечивает эффективный отвод тепла, это значительно увеличивает ресурс галогенной лампы и оптических элементов Эффективно работает со всеми видами фотополимеризующихся пломбировочных материалов В аппарате использована галогенная лампа фирмы OSRAM 64613 (75W 12V) Программное управление таймером и звуковой сигнализацией ***Применен импортный светодиод.*** Питание ~ 220В, 50Гц Плотность мощности излучения, мВт/см^2 300 Диаметр световода, мм 8 Масса облучателя, кг 0,3 Длина волны, мм 400 - 500	6 000
9.	То же	**АСКМ 10/60 «Оптрадент-2» МЦ-06**		**то же**	Аналогичен модели АСКМ 10/60 «Оптрадент-2» МЦ-04 ***Оснащен двумя световодами: для диагностики и для полимеризации.***	8 000
10.	**Тест**			«	Предназначен для контроля интенсивности излучения аппарата светоотверждения стоматологических композитных материалов Контроль синего и инфракрасного излучения осуществляется отдельно Пределы измерения мВт/см^2 - синего излучения 0 – 1500 - инфракрасного излучения 0 – 500 Диаметр светодиода, мм 7 – 10	3 600
	Гидроблоки стоматологические для сбора жидких отходов Предназначены для сбора жидких отходов и ополаскивания рта пациента Работают автономно от водопроводной и канализационной сети Питание - ~ 220В, 50Гц Потребляемая мощность – не более 120 ВА Габаритные размеры (без светильника) – 800х270х430 мм Масса нетто – не более 20 кг					
11.	**Гидроблок стоматологический**	**«ГС-01»**		«	Комплектуется слюноотсосом Канистры для питьевой воды и сбора жидких отходов емкостью до 5 литров	8 400
12.	**То же**	**«ГС-02»**		«	Комплектуется светильником типа ССМ-28 «Унилюкс» Канистры для питьевой воды и сбора жидких отходов емкостью до 5 литров Освещенность в центре рабочего поля светильника – -от 0 до 28 000 люкс	11 400

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
13.	**Гидроблок стоматологический**	**«ГС-03»**		**ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж**	Комплектуется слюноотсосом и светильником типа ССМ-28 «Унилюкс». Канистры для питьевой воды и сбора жидких отходов емкостью до 5 литров. Освещенность в центре рабочего поля светильника – -от 0 до 28 000 люкс.	14 500
14.	**То же**	**«ГС-04»**		**то же**	*Имеет канистры для питьевой воды и сбора жидких отходов емкостью* до 5 литров.	7 000
15.	**«**	**«ГС-05»**		**«**	Комплектуется слюноотсосом и светильником типа ССМ-28 «Унилюкс» и «сухой» полимерной чашей. Освещенность в центре рабочего поля светильника – -от 0 до 28 000 люкс.	10 000
16.	**Плевательница на стойке**			**«**	Предназначена для сбора жидких и твердых отходов.	1 600
17.	**Светильники медицинские**	**ССМ-28 «Унилюкс»**		**«**	Светильник имеет следующие модификации: - **«Унилюкс-ССМ-28-01»** – *переносной напольный ;* - **«Унилюкс-ССМ-28-02» -** *переносной настенный (настольный).* Светильники с мощным световым «холодным» потоком и возможностью регулировки от 0 до максимума. Используется галогенная лампа OSRAM 64440 (12V, 50W). Питание 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, ВА 200 Освещенность в центре рабочего поля на расстоянии 0,8 м от излучателя – не менее 28 000 люкс; Диапазон регулировки освещенности, люкс от 0 до 28 000 Размер рабочего поля на расстоянии 0,8 м – эллипс с осями – не более 60х140 мм Освещенность на уровне глаз пациента, люкс не более 1 000 Масса, кг: «Унилюкс-ССМ-28-01» 15 «Унилюкс-ССМ-28-02» 4 Высота «Унилюкс-ССМ-28-01», мм 642±200 Габаритные размеры «Унилюкс-ССМ-28-02», мм 410 х 356	6 600 4 200

«УНИЛЮКС-СС-28-02»
настенный (настольный) медицинский светильник



№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики		Цена, руб.
18.	**Светильник медицинский стоматологический**	**П-6**		**ЗАО «Завод ЭМА», г. Екатеринбург**	Максимальная освещенность рабочего поля, люкс Размер рабочего поля, см Источник света Тип лампы Количество ламп Питание Потребляемая мощность, ВА Перемещение осветителя по вертикали, мм Масса, кг	15 000 13 АКГ-12-55-1 (Н3) 1 220 В, 50 Гц 100 380 30	9 000 (с НДС)
19.	**Кресло стоматологическое электромеханическое** *(Продукция на заказ)*	**«КСЭМ-200-СТОМЭЛ»**		**ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж**	Предназначено для размещения пациента при оказании стоматологической помощи в стационарных условиях поликлиник, больниц и др лечебных учреждений Кресло имеет электромеханический привод Питание Потребляемая мощность, ВА Расстояние от поверхности пола до верхней поверхности сидения, мм - в крайне верхнем положении - в крайне нижнем положении Диапазон углов поворота спинки от вертикали Угол между сидением и опорой для ног Габаритные размеры, мм Масса, кг	220 В, 50 Гц 750 800 450 от 5° до **90°** 20° 1200 x 600 x 1200 145	45 000
20.	**Тумбочка стоматологическая с двойной мойкой** *(Продукция на заказ)*			**то же**	Предназначена предстерилизационной обработки медицинских инструментов Габаритные размеры, мм	790 x 525 x 860	9 300
21.	**Тумбочка стоматологическая с пятью ящиками** *(Продукция на заказ)*			«	Предназначена для хранения медицинского инструмента и материалов Габаритные размеры, мм	460 x 525 x 860	5 900
22.	**Тумбочка стоматологическая с четырьмя ящиками** *(Продукция на заказ)*			«	Предназначена для временного хранения использованного инструмента (3 выдвижных ящика) и отходов, запечатанный в желтый полиэтиленовый пакет (выдвижной ящик с пластмассовой кюветой) Габаритные размеры, мм	460 x 525 x 860	5 500

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
2 3.	**Тумбочка стоматологическая со стеклянными полками** *(Продукция на заказ)*			**ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж**	Тумбочка предназначена для хранения медицинского инструмента и материалов Габаритные размеры, мм 504 x 525 x 860	4 500
2 4.	**Стул для ассистента** * *Стоимость стула с* ***подставкой-кольцом для*** *ног*			**то же**	Стул ассистента врача-стоматолога без подлокотников с регулируемыми спинкой и сиденьем Обеспечивает посадку в анатомически правильной позиции Расстояние от поверхности пола до верхней поверхности сидения, мм - в крайне верхнем положении 600 - в крайне нижнем положении 500 Масса, кг 8	3 300 4 000*
2 5.	**Набор мебели с общей столешницей**			«	В комплект входят тумбочка стоматологическая с двойной мойкой, тумбочка стоматологическая со стеклянными полками выкатная тумбочка стоматологическая со столешницей с тремя ящиками Габаритные размеры, мм 1870 x 525 x 860	19 000
2 6.	**Тумбочка стоматологическая с одинарной мойкой** ***Изготавливается только под заказ.***			«	Габаритные размеры, мм 504 x 525 x 860	6 800
2 7.	**Тумбочка стоматологическая с угловой мойкой** ***Изготавливается только под заказ.***			«	Габаритные размеры мм 1142 x 808x 525 x 860	12 500
2 8.	**Аспиратор вакуумный**	**«СТОМЭЛ-К»**		«	Предназначен для очистки полости рта пациента от пылеводовзвеси и ее сбора Аспиратор оснащен вакуумным насосом, жидкостным бактерицидным фильтром, системой защиты сборной емкости о переполнении, влагоотстойником, звуковым сигналом переполнения пылесборника Питание 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, Вт 170 Производительность, $м^3$/мин 0 6 Разрежение, не менее, мм рт ст 800 Мощность пылевсасывающего агрегата, Вт 140 Емкость пылесборника л 0 5 Габаритные размеры, мм 960 x 390 x 490 Масса, кг 25	12 500

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
29.	Ортобокс стоматологический	«СТОМЭЛ-К»		ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж	Предназначен для механической обработки зубных протезов врачом-ортопедом или зубным техником в условиях стоматологических кабинетов и зуботехнических лабораторий Ортобокс выполнен в виде передвижного модуля, состоящего из микромотора зуботехнического, встроенного пылевсасывающего агрегата с двухконтурной системой очистки воздуха Для равномерного освещения рабочей зоны имеется внутреннее освещение Для защиты лица от твердых частиц при механической обработке ортбокс оснащен защитным стеклом Питание – 220 В, 50 Гц Максимальная потребляемая мощность, ВА – 200 Скорость вращения микромотора, об/мин – до 20 000 Производительность пылевсасывающего агрегата, $м^3$/мин – 0,6 Габаритные размеры, мм – 700 x 950 x 1100 Масса, кг – 50	29 000
30.	Столы стоматологические бактерицидные	ССБ-1; ССБ-2; ССБ-3 ССБ-4		то же	Предназначены для размещения медицинских инструментов, материалов и медикаментов в стоматологических кабинетах, а также для хранения простерилизованных медицинских инструментов В ящике-боксе установлена бактерицидная кварцевая лампа (две лампы в ящике-боксе стола ССБ-3), что обеспечивает постоянную готовность инструментов к безопасному применению Питание – 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность, ВА – 40 Бактерицидная мощность Вт – 3,5 (4) Время хранения стерильных инструментов, ч – 6 (12) Габаритные размеры, мм – 400x600x815 (900x525x500) Масса, кг – 15 (30)	
	ССБ-1 – *на 8 стандартных наборов,* **ССБ-2** – *на 16 стандартных наборов,* **ССБ-3** – *на 42 стандартных набора* ***Примечание:*** *В скобках приведены характеристики для стола ССБ-3*					
31.	Рабочее место врача-стоматолога	«РМС-1»		«	***В комплект входят:*** - комплект «КОМСТА-1» - кресло «КСЭМ-200-СТОМЭЛ» - столик ССБ-1 - стул для ассистента	11 700
32.	Рабочее место врача-стоматолога	«РМС-2»		«	***В комплект входят:*** - комплект «КОМСТА-1Э» - кресло «КСЭМ-200-СТОМЭЛ» - столик ССБ-1 - стул для ассистента	12 900

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
32	Рабочее место врача-стоматолога	«РМС-3»		ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж	***В комплект входят:*** - комплект «КОМСТА-5» - кресло «КСЭМ-200-СТОМЭЛ» столик ССБ-1 стул для ассистента	106 000
33	Кабинет стоматологический	«СТОМЭЛ»		то же	***В состав кабинета входят*** бормашина компрессор воздушный поршневой «Стомаком КС-60 03» кресло электромеханическое «КСЭМ-200-СТОМЭЛ» оснащенное гидроблоком ГС-05 аппарат светоотверждения композитных пломбировочных материалов «Оптрадент-2», стул врача и ассистента рабочий стол «ССП-1», рабочий стол с УФ-бактерицидным облучением хранящегося в нем стерильного инструмента «ССБ-1» (или «ССБ-2» «ССБ-4»), облучатель бактерицидный настенный ОБНП 2х30-1 контейнер для стерилизации и дезинфекции воздушный стерилизатор ГП-20-1 тумбочка стоматологическая с двойной металлической мойкой тумбочка стоматологическая с 4-мя ящиками, тумбочка стоматологическая с 5-ю ящиками тумбочка стоматологическая со стеклянными полками Потребляемая мощность 3 кВт	172 990
34	Негатоскоп стоматолгический	А5; А4; А3; А2		«	Аппарат предназначен для просмотра рентгеновских снимков Лампа люминесцентная ртутная с типом цоколя G23 **А5 / А4 / А3 / А2** Размер экрана мм: 148х210 / 210х297 / 297х420 / 597х420 Масса кг: 2 0 / 2 5 / 5 0 / 6 5	2 800 3 000 3 400 4 300
35	Лазерный стоматологический хирургический аппарат	АЛСХ-5-«Плазма-Р» («Стокос»)	ЩФ 3.950.012ТУ	ОАО «Плазма», г.Рязань	Основное достоинство аппарата **«Стокос»** - возможность широкого применения лазерных методов лечения в условиях поликлиник на массовом амбулаторном приеме Он пригоден для всех видов амбулаторных хирургических операций на мягких тканях полости рта лица и шеи **«Стокос»** - портативный прибор с излучателем на CO_2 Включение и выключение лазерного луча осуществляется ножной педалью Длина волны лазерного излучения 10 мкм мощность в диапазоне 0 5 – 5 Вт, режим регенерации – непрерывный и импульсный Диаметр луча 0,2 мкм Время непрерывное работы 8ч Охлаждение автономное не требующее подключение к водопроводу Питание: 220 В 50 Гц Потребляемая мощность, ВА: 350 Габариты аппарата мм: 200 х 300 х 450 Масса кг: 16 8	

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
36	Аппарат для снятия зубного камня	Ультрадент		Завод «ЭМА», г.Москва	Предназначен для снятия зубного камня и налета с помощью ультразвука Аппарат состоит из трех основных функциональных узлов ультразвукового инструмента, электронного блока гидроканала Ном частота колебаний инструмента, кГц 44 Макс колебательная скорость инструмента м/с 11 Диапазон регулирования амплитуды, раз, не менее 2 Питание 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность Вт 50 Габаритные размеры, мм 270 x 220 x 92	9 000
37.	Аппарат для ультразвуковой терапии	УЗТ-1.02С		то же	Предназначен для лечения ультразвуком пародонтоза, глоссальгии, артрозоартритов келоидных и послеоперационных рубцов лица и шеи По защите поражения электрическим током выполнен по классу 1 тип В Питание ~220 В 50 Гц Потребляемая мощность, ВА 50 Частота ультразвуковых колебаний МГц 0 88 Эффективная площадь излучателей, см кв. - ИУТ 0 88-1 03Ф, 1 - ИУТ 0 88-1 05Ф, 1 - ИУТ 0,88-1 06Ф, 1 - ИУТ 0,88-2 07О 2 Режим работы – непрерывный и импульсный Регулировка отдаваемой мощности ступенчатая Интенсивность ультразвуковых колебаний по ступеням, Вт/см^3 – 1 0 0,7 0 4 0 2, 0 05 Длительность импульсов мс 2 4 и 10 Частота повторения импульсов Гц 50 Габаритные размеры мм 341 x 290 x 142 Масса кг не более 7	10 300
38	Кресло стоматологическое	КС-01		АО «Утес», Г Ульяновск	Современная анатомическая форма кресла создана на основе формованного пенополиуретана с бесшовным покрытием из винилискожи	45 000

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
					Клинические испытания и медицинская практика показали высокую эффективность аппарата при лечении миопии, ран ожогов, эрозий и язв роговицы, амблиопий, ячменя, заболеваний сетчатки, связанных с нарушением кровоснабжения, а также для ускорения приживления транплатанта при пересадке роговицы *Длина волны излучения*, мкм — 0,63 Мощность излучения, мВт — $10x10^{-3}$, $360x10^{-3}$ Частота модуляции, Гц — 0,5, 1 0, 2 5* Диаметр пятна излучения, мм — 5, 10, 15* Время экспозиции, мин — 1, 2, 3 5 Питание — 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, ВА, не более — 50 Габаритные размеры, мм — 480x292x460 Масса, кг, не более — 14	
					* - *в зависимости от метода лечения*	
3.	Индикатор внутриглазного давления	ИГД-02 «ПРА» 94 4130	БИРМ.9413 29.005ТУ	Государственный Рязанский приборный завод	*Сертификат соответствия РОСС.RU.ИМ02.В09136.*	
4.	Тонометр внутриглазного давления	ТГД-01 «ПРА» 94 4130	ТУ 9441-011-12191956-98	то же	*Сертификат соответствия РОСС.RU.ИМ02.В09136.*	

6. АППАРАТЫ И ПРИБОРЫ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
1	**Аппарат рентгеновский снимочный цифровой**	**АРС-Ц1**		**ОАО «Мосрентген», п.Мосрентген**	Аппарат позволяет получить прямые и косые (±45°) снимки любой части тела, обеспечивая диагностические исследования на основе современных цифровых информационных технологий Многообразные (по четырем координатам) изменения положения системы «излучатель-приемник» позволяют обследовать пациентов любого возраста и комплекции в положении лежа, включая латеропозицию, стоя, сидя Программное обеспечение «АРС-Ц1» отвечает современным стандартам, имеет архив снимков большой емкостью (до 64000 штук стандартного разрешения и до 16000 максимального), получение твердых копий снимков, медицинских отчетов	
2.	**Рентгенодиагностические комплексы**	**РДК 50/6**		**то же**	Предназначен для проведения стандартных рентгеновских обследований – рентгеноскопии, рентгенографии и линейной томографии в прямых и косых проекциях в положении стоя и лежа Обеспечивает высокое качество снимков при минимальной лучевой нагрузке на пациента Предлагает многовариантную комплектацию для обеспечения широкого спектра функциональных и стоимостных возможностей	
	РДК 50/6 на 3 рабочих места. *Базовый комплект* ➢ Поворотный Стол-Штатив **ДИАСКОП** ➢ УРИ с РЭОП **Bera ZOX-274** (2 поля) ➢ Система снимков и томографии **Диаграф** ➢ Стойка снимков **Сторс-М** ➢ Питающее устройство **Ренекс** ➢ Излучатели **РИД.**				***РДК 50/6 на 1 рабочее место.*** *Базовый комплект* ➢ Поворотный Стол-Штатив **ДИАСКОП** ➢ УРИ с РЭОП **Bera ZOX-274** (2 поля) ➢ Питающее устройство **Ренекс** ➢ Излучатели **РИД.**	***РДК 50/6 на 2 рабочих места.*** *Базовый комплект* ➢ Система снимков и томографии **Диаграф** ➢ Стойка снимков **Сторс-М** ➢ Питающее устройство **Ренекс** ➢ Излучатели **РИД.**	
3.	**Стол-штатив универсальный поворотный**	**Диаскоп**	**ТУ 9442-012-11701705-2000**	«	Предназначен для проведения рентгенографии с делением рентгеновской пленки и рентгеноскопии с применением всех видов усилителей яркости рентгеновского изображения в вертикальном горизонтальном положениях и в положении по Трандельбургу (-15°) Поворот в диапазоне 90° /-15° с автоматической остановкой в горизонтальном положении Размер деки стола, см 198x80x0 5 Покрытие стола с низким коэффициентом поглощения рентгеновского излучения Продольное перемещение деки элек5троприводом – 100 см Поперечное перемещение деки электроприводом – 18 см Стол можетбыть оснащен дополнительной рентгеновской решеткой с моторным приводом растра	
	Перемещение ЭСУ ➢ В продольном направлении электроприводом – 52 см ➢ В компрессионном направлении электроприводом – 27, см (18 5-45 см) ➢ В поперечном направлении вручную – 23 см ➢ Вес штатива 1200 кг					

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
4.	Рентгеновская система снимков и томографии	Диаграф	ТУ 9442-013-11701705-2002	ОАО «Мосрентген», п.Мосрентген	Система позволяет выполнять крупноформатную рентгенографию в положении лежа, латеральные снимки и линейную томографию на кассеты всех стандартных размеров пленки *Оснащается рентгеновской решеткой с моторным приводом растра* Плавающая дека стола размером 230х79 см с механическими тормозами Продольное перемещение деки электроприводом – 90 см Поперечное перемещение деки электроприводом 23 см Высота деки в верхнем положении – 80 см Коэффициент поглощения рентгеновского излучения не более 0,7 мм AL Расстояние «дека-пленка» – не более 60 мм Углы экспозиции – 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45° Число скоростей томографии – 3 для каждого угла с возможностью оперативного регулирования с помощью частотного преобразователя Диапазон времени экспозиции при уровне среза 125 мм от 0,2 до 4,6 сек Диапазон уровня среза от 10 до 250 мм с цифровой индикацией Перемещение рентгеновского излучателя - в горизонтальной плоскости электроприводом – 250 см, - в вертикальной плоскости электроприводом – 150 см Поворот рентгеновского излучателя - вокруг вертикальной оси штатива – 180° /360°/, - вокруг горизонтальной оси – 240° Габаритные размеры изделия в сборе – 350х245х160 см Масса изделия в сборе – 450 кг	
5.	Диагностическая вертикальная стойка	Диавест; Диавест-01	ТУ 9442-020-11701705-2002	то же	Обеспечивает возможность проведения крупноформатной рентгенографии в вертикальном (Диавест) и наклонном (Диавест-01) положениях на кассеты всех стандартных размеров пленки Оснащается рентгеновской решеткой с моторным приводом растра с разрешением 40 п л /см Перемещения центра кассеты в вертикальной плоскости – 150 см Минимальное расстояние центра кассеты от пола – 35 см Поворот опорной стенки вокруг горизонтальной оси (для Диавест-01) – +90°, -20° Расстояние «дека-пленка» – не более 65 см	

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
5.	**Рентгеновское питающее устройство**	**РЕНЕКС**	**ТУ 9442-011-01416381-96**	**ОАО «Мосрентген», п.Мосрентген**	Работает на промышленной частоте преобразования оснащено микропроцессорной системой управления Количество анатомических программ для взрослых и детей свыше 80 Максимальная мощность 50 кВт Автоматический контроль экспозиции при рентгенографии и яркости изображения при рентгеноскопии Питающая сеть 3х380 В ±10% 50/60 Гц с нулевым проводом Возможность подключения одного или двух излучателей 125 кВ / 50 кВт, диапазон изменения анодного напряжения при рентгенографии 40 – 125 кВ с шагом 1 кВ, диапазон изменения анодного тока при рентгенографии 25-800 мА, уставки от 1,0 до 999 мАс, импульсная рентгеноскопия	
6.	**Рентгеновское питающее устройство**	**IDEAL R&F**		**то же**	Работает на повышенной частоте преобразования, оснащено микропроцессорной системой управления Количество анатомических программ для взрослых и детей свыше 600 Максимальная мощность 50 кВт или 64 кВт Автоматический контроль экспозиции при рентгенографии и яркости изображения при рентгеноскопии Режим импульсной рентгеноскопии Питающая сеть 3х380 В ±10% 50/60 Гц с нулевым проводом Возможность подключения одного или двух излучателей 125 кВ / 50 кВт, диапазон изменения анодного напряжения при рентгенографии 40 – 125 кВ с шагом 1 кВ, диапазон изменения анодного тока при рентгенографии 25-500 мА, уставки от 0,1 до 550 мАс	
7.	**Флюорограф цифровой малодозовый**	**ДИАРС-МР**		**«**	Предназначен для замены и модернизации традиционных пленочных аппаратов, по сравнению с которыми снижает лучевую нагрузку в 20 раз, обеспечивая при этом разрешающую способность изображения близкую к рентгенографическому снимку, что позволяет применять флюорограф не только для скрининга, но и для диагностики	

Параметры	I поколение	II поколение
Размер изображения, мм	380х380	390х390
Время экспозиции, мс	20 80	20 100
Геометрические искажения, %	= 0 2	= 0,15
Разрядность АЦП	10	14
Пороговый контраст %	1,5 при Д=0 8мР	1 0 при Д=1,0мР
Пространственное разрешение при 5% по ЧКХ, п л /мм	2,2	4 2

Время выполнения снимка сократилось до 0,05 0,1 с благодаря несканирующей технологии получения изображения
Аппарат оснащен автоматизированными рабочими местами (АРМ) рентгенлаборанта и врача-рентгенолога, связанными в локальную сеть, встроенным архивом не менее чем на 3000 пациентов

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
8.	Рентгенодиагностический аппарат	МЕДИКС-Р		ЗАО АМИКО, г.Москва	Рентгенодиагностический аппарат МЕДИКС-Р отличает высокое качество компонентов и сборки **Компоненты аппарата М Е Д И К С - Р :** ***Поворотный стол-штатив ВИРОМАТИК.*** Стол легкий в управлении и надежный в работе *Механическое* экраноснимочное устройство САГ 4 работает безотказно, позволяя выполнить все необходимые виды исследований Выбор программ деления кассет при снимке содержит только используемые в практике варианты Потолочный уравновешиватель – не требуется ***Усилитель рентгеновского изображения АМЕТИСТ:*** ❖ Три рабочих поля 23/15/12 см, ❖ Телекамера на ПЗС – матрице, ❖ Система цифровой обработки телесигнала с шумоподавлением, ❖ Система запоминания последнего кадра ***Система цифровой обработки и архивирования рентгеновских изображений АККОРД.*** Позволяет хранить рентгеновские изображения в цифровом виде и не использовать пленку Легко встраивается в любую рентгеновскую информационную систему ЛПУ ***Излучатель с рентгеновской трубкой.*** Предлагаются отечественные трубки с большим ресурсом службы и оптимальными рабочими фокусами –0,6/1 2 мм (20-40 БД 46-150 СВЕТЛАНА-РЕНТГЕН) ***Томографический стол снимков МОВИПЛАН.*** Стол выпускается в двух модификациях – с лифтом для работы с малоподвижными пациентами (45 – 80 см от пола) и без лифта *Прецизионная* система линейной томографии позволяет исследование при четырех углах 5-20-30-45, для каждого угла можно выбрать три различные скорости ***Вертикальная стойка снимков ТЕЛЕРАДИОГРАФИ.*** С МОВИПЛАНОМ поставляется простая и удобная стойка снимков Кассетодержатель стойки приспособлен для работы с кассетами от 13х18 до 35х43 см ***Среднечастотное рентгеновское питающее устройство ТОПИКС.*** Мощность питающего устройства составляет 50 кВт Частота высоковольтного преобразования – 20 Кгц Диапазон значений высокого напряжения подаваемого на рентгеновскую трубку составляет - в режиме рентгенографии – 40-150 кВ, - в режиме просвечивания – 40-125 кВ Шаг изменения напряжения – 1 кВ Время экспозиции - при рентгенографии от 3 до 6 с, - при просвечивании 0-30 минут	

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
9.	**Универсальный рентгенодиагностический аппарат**	**ТЕЛЕМЕДИКС-Р**		**ЗАО АМИКО, г.Москва**	На одном телеуправляемом столе-штативе собраны возможности обычных трех рабочих мест Врач может выполнить любое рентгенодиагностическое обследование, не выходя из пультовой комнаты ***Достоинства:*** - удобное позиционирование пациента как дистанционное, так и с консоли на столе - удобный подход к пациенту с любой стороны (при исследованиях с контрастными веществами) - возможность работать с УРИ на самом краю стола (гинекологические и урологические исследования)	
10.	**Малодозовый цифровой сканирующий флюорограф**	**ПРОСКАН-2000 (АПЦФ-01)**		**то же**	Флюорограф имеет следующие модели - сканирующие - с цифровой камерой ***Преимущества ПРОСКАН-2000:*** - минимально возможная доза, получаемая пациентом при обследовании (менее 10 мкЗв), - полупроводниковый линейный детектор надежен в эксплуатации, не требует специального обслуживания - среднечастотное рентгеновское питающее устройство УРП-30-СЧ-АМИКО обеспечивает уровень пульсаций высокого напряжения на рентгеновской трубке менее 2% что увеличивает срок службы трубки и снижает дозу получаемую пациентом при обследовании, - рентгенозащитная кабина с подъемником позволяет вписать новый аппарат в существующий план флюорографического кабинета Пропускная способность сканирующего флюорографа – 60 пациентов в час	
11.	**Переносной рентгеновский аппарат**	**10Л6-01Р**		**«**	Легкий разборный аппарат применяют не только в ЛПУ, но и военные при развертывании полевых госпиталей, а также специалисты МЧС Моноблок легко позиционируется, что позволяет делать рентгеновские снимки при любом положении пациента	
12	**Аппарат панорамный рентгенодиагностический стоматологический острофокусный**	**ПАРДУС-1**		**НПП «Буревестник», ОАО, г.Санкт-Петербург**	Аппарат создан на основе оригинальной острофокусной рентгеновской трубки и предназначен для получения панорамных снимков верхней и нижней челюстей одновременно Применяется при диагностике кариеса, пародонтита и др заболеваний в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Размер фокусного пятна мм – 0 2 Расстояние фокус-кассета мм – 50 60 Время экспозиции с – 0 5 9,9 Установочная площадь, м^2 – 1,5 / Масса, кг – 43	
	Аппарат внесен в Госреестр медицинских изделий					

13. Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-«Электрон»

Лист 1
Листов 1

48

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 9442-010- 11150760-01

Сертификат соответствия Госстандарта России РОСС RU. ИМ02.В09954

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е

Характеристики	Значения
1. Полипозиционный стол/штатив	
Диапазон наклона стола	+90°/-20°
Тип привода наклона стола – моторный с дистанционным управлением	
Размеры деки стола	240x72 см
Размеры рентгенопрозрачной области	228x51 см
Диапазон плавной регулировки расстояния от трубки *до пленки (ФРС)*	105 150 см
Дистанционное управление всем аппаратом из пультовой	
2. Томография	
Возможно проведение томографии при наклонном положении деки стола	
Углы обзора томографии	8° – 20° – 30° – 40°
Диапазон плавной регулировки глубины слоя среза томографии	5 – 100 мм
3. Телевизионная система	
Номинальный диаметр РЭОПа	12'
Размеры используемых полей	290 / 215 / 150 мм
Разрешающая способность РЭОПа не менее	1 8 2 2 2 8 мм [1]
Количество активных элементов ПЗС матрицы	1024x1024 пикселей
Разрешающая способность видеомонитора	1000 ТВ линий
Размер видеомонитора	20 (54 см)
4. Программно-аппаратный комплекс АРМ	
Имеется функция создания и поддержания базы данных пациентов и диагностической информации	
Захват рентгеновских цифровых снимков и видеосигнала с частотой не менее	от 1 до 30 кадров/сек

Характеристики	Значения
Наличие записи рентгеноскопии в реальном времени без ограничения длительности	
Наличие функции обработки изображений (как цифровых снимков так и рентгеноскопии)	
Объем памяти базы данных	30 000 снимков
Размер монитора рабочей станции АРМ	21' (56см)
5. Питающее устройство	
Мощность генератора	60 кВт
Диапазон изменения анодного напряжения	40 150 кВ
Диапазон тока рентгеновской трубки	0 5 800 мА
Диапазон параметра мАс (ток*время)	0 2 640 мАс
Наличие поддержки режимов непрерывной и импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро) серийных (ангио) и одиночных цифровых снимков пленочной рентгенографии	
Скорость съемки в режиме импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро)	1 3- кадров/сек
6. Коллиматор	
Количество диафрагм в коллиматоре	3
Тип привода диафрагм коллиматора – моторный с дистанционным управлением	
Количество лепестков ирисовой диафрагмы	12
7. Универсальный пульт управления	
Язык индикации параметров и маркировки органов управления – русский	
Код ОКП	94 4220

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – НИПК «Электрон» г Санкт-Петербург

14. Установка рентгенодиагностическая хирургическая передвижная РТС-612

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 9442-003- 11150760-95

Сертификат соответствия Госстандарта России РОСС RU. ИМ02.В09657.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е

Характеристики	Значения
1. Полипозиционный штатив с С-образной дугой	
Фокусное расстояние	90 см
Вертикальное перемещение С-дуги	45 см
Поворот С-дуги относительно вертикальной оси	+/-15°
Горизонтальное перемещение	20 см
Поворот в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси	+/-180°
Орбитальный поворот	-90°/+25°
Радиус С-образной дуги	48 см
Вес штатива, не более	243 кг
2. Коллиматор	
Угол поворота щелевой диафрагмы	±180°
Тип привода диафрагм коллиматора	моторный
Количество диафрагм в коллиматоре	3
Автоматическая коллимация по выбранному рабочему полю РЭОПа	наличие
3. Телевизионная система	
Номинальный диаметр УРИ	9"
Размеры рабочих полей	215 / 160 / 120 мм
Разрешающая способность системы, не менее	1 3, 1 6, 2 0 мм [1]
Количество активных элементов ПЗС матрицы	786x576 пикселей
Разрешающая способность видеомонитора	600 ТВ линий
Размер экрана видеомонитора	17"
Объем оперативной памяти видеосистемы	4 кадра
Динамический диапазон	4 кадра

Характеристики	Значения
4. Питающее устройство	
Мощность генератора	3,0 кВт
Диапазон изменения анодного напряжения	40 105 кВ
Диапазон тока рентгеновской трубки	0,1 30 мА
Количество программ органавтоматики	25
Скорости съемки в режиме импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро)	1, 2, 4, 25 кадров/сек
Питание от сети переменного тока – напряжение	220 В
5. Рентгеновсий излучатель	
Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке	2
Диаметры фокусных пятен	0,6 мм 1,6 мм
6. Система цифровой обработки и архивации изображений	
Захват рентгеновских цифровых снимков и серий с частотой захвата	1, 2, 4, 25 кадров/сек
Объем оперативной базы данных, не менее	30 000 снимков
Наличие функции обработки изображений (как цифровых снимков, так и серий)	
Наличие функции создания и поддержания базы данных пациентов и диагностической информации	
Количество одновременно отображаемых / обрабатываемых изображений	1, 2 или 4
Размер монитора рабочей станции АРМ (при рабочем разрешении 800x600)	17"
Наличие возможности подключения к АРМ врача-рентгенолога	
Код ОКП	94 4221

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – НИПК «Электрон» г.Санкт-Петербург

15. Флюорографы малодозовые цифровые ФЦ-01 «Электрон».

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 9442-008- 11150760-2001

Сертификат соответствия Госстандарта России РОСС RU. ИМ02.В09359.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е

Характеристики	Значения
1. Камера флюорографическая цифровая	
Размер рабочего поля	390 x 390 мм
Разрешающая способность	2 5 2,8 пар линий/мм
Производительность не менее	60 снимков/час
Экспозиционная доза на одну флюорограмму	менее 1 мР
Число элементов изображений	2048 x 2048 пикселей
Динамический диапазон	более 150
2. Штативная часть	
Диапазон перемещения камеры в вертикальном направлении	190 см
Тип привода штатива	эл двигатель
Фокусное расстояние	100 см
3. Рентгеновский излучатель	
Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке	2
Максимальное напряжение на трубке	150 кВ
4. Рентгеновское питающее устройство	
Тип устройства	среднечастотное
Мощность генератора	50 кВт
Диапазон изменения анодного напряжения	40 150 кВ
Шаг изменения анодного напряжения	1 кВт
Диапазон тока рентгеновской трубки	50 640 мА
Диапазон параметра мАс (ток*время)	1 500 мАс
Минимальное время экспозиции	2 мс
Наличие микропроцессорного устройства автоматического управления экспозицией	

Характеристики	Значения
5. Аппаратно-программный комплекс АРМ	
Количество АРМ	2
Объем памяти базы данных	30 000 снимков
Размет монитора лаборанта /врача	19" / 22"

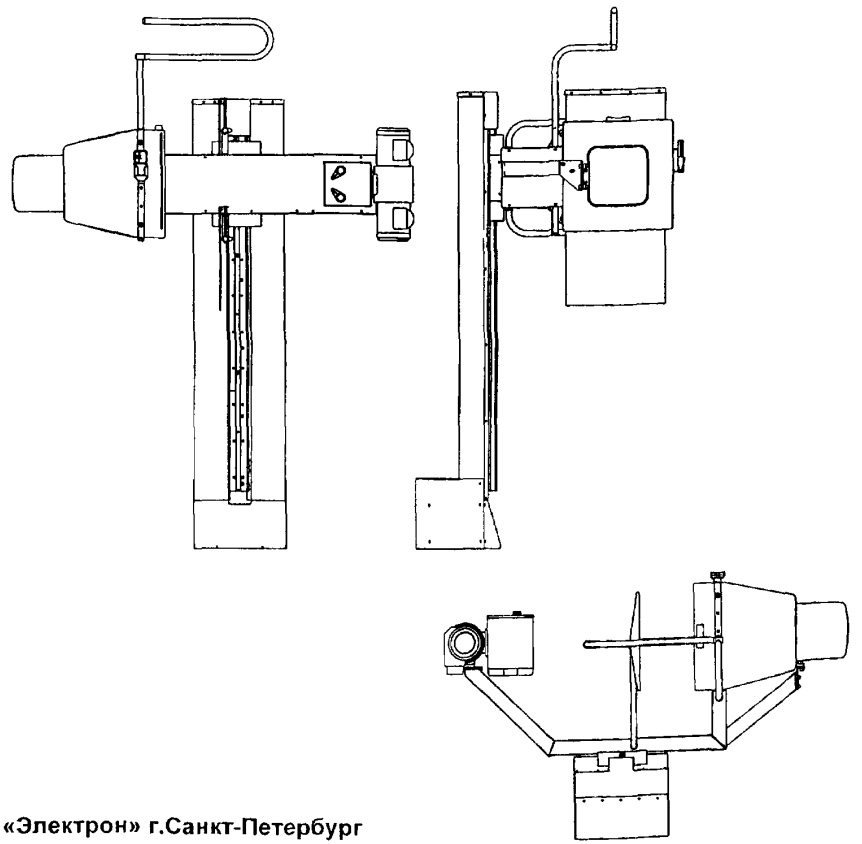

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – НИПК «Электрон» г.Санкт-Петербург

16. Комплексы рентгеновские диагностические КРД-«ОКО» *на 1, 2, 3 места.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ : ТУ 9442-007- 11150760-2002.

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Д А Н Н Ы Е

Характеристики	Значения
1. Стол-штатив поворотный	
Диапазон наклона стола	+90° / -15°
Наличие автоматической остановки стола в горизонтальном положении	
Размеры деки стола	200 x 73 см
Возможная нагрузка на стол (вес пациента)	130 кг
Диапазон перемещения ЭСУ в продольном направлении	54 см
Диапазон перемещения ЭСУ в поперечном направлении	25 см
Диапазон перемещения ЭСУ вдоль оси рентгеновского пучка	25 см
2. Стол снимков	
Пределы изменения высоты деки стола	50 79 см
Размеры деки стола	85 x 205 см
Имеется гидравлический лифт	
Перемещение деки в продольном направлении	± 40 см
Перемещение деки в поперечном направлении	± 13 см
Максимальный размер кассеты	35 x 43 см
3. Колонная с томографическим устройством для рентгеновского излучателя	
Угол поворота рентгеновской трубки	± 180°
Диапазон перемещения в продольном направлении	330 см
Диапазон изменения высоты излучателя	150 см
Диапазон перемещения трубки в поперечном направлении – 36 см	
Количество скоростей сканирования	3
4. Вертикальная стойка снимков	
Максимальный размер кассеты	35 x 43 см

Характеристики	Значения
5. Телевизионная система	
Номинальный диаметр РЭОПа	9"
Размеры используемых полей	2,5 / 160 / 120 мм
Разрешающая способность РЭОПа	1,3, 1,6 2,0 $мм^{-1}$
Количество активных элементов ПЗС матрицы	768x576 пикселей
Размер видеомонитора	17" (41 см)
Количество уровней шумоподавления	4
Скорость считывания кадров	1 25 кадров/сек
Наличие цифровой обработки видеосигнала	
6. Питающее устройство	
Мощность генератора	60 кВт
Диапазон изменения анодного напряжения	40 150 кВ
Шаг изменения анодного напряжения	1 кВ
Диапазон тока рентгеновской трубки	0,5 800 мА
Диапазон параметра мАс (ток*время)	0 2 640 мАс
Диапазон экспозиционного времени	2 мс 6,4с
Количество программ органавтоматики	144
Наличие поддержки режимов непрерывной и импульсной рентгеноскопии (пульс-флюоро) и одиночных снимков	
Наличие микропроцессорного устройства автоматического управления экспозиции	
7. Рентгеновские излучатели	
Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке	2
Максимальное напряжение на аноде рентгеновской трубки	150 кВ

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – НИПК «Электрон» г.Санкт-Петербург

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование оборудования изделия</th><th>Тип, марка. Код ОКП</th><th>ГОСТ или ТУ</th><th>Завод-изготовитель</th><th>Технические характеристики</th><th>Цена, руб.</th></tr>
<tr><td>17.</td><td>Усилители рентгеновского изображения</td><td>УРИ-612
94 5230</td><td>ТУ 9452-004-11150760-95</td><td>НИПК «Электрон», г.Санкт-Петербург</td><td>Сертификат соответствия Госстандарта России РОСС RU. ИМ02.В09656.
<table><tr><th>Характеристики</th><th>Значения</th></tr><tr><td>Номинальный диаметр РЭОПа</td><td>9"</td></tr><tr><td>Размеры используемых полей</td><td>2,5 / 160 / 120 мм</td></tr><tr><td>Разрешающая способность РЭОПа</td><td>1,3, 1,6, 2,0 мм$^{-1}$</td></tr><tr><td>Количество активных элементов ПЗС матрицы</td><td>768x576 пикселей</td></tr><tr><td>Размер видеомонитора</td><td>17" (41 см)</td></tr><tr><td>Количество уровней шумоподавления</td><td>4</td></tr><tr><td>Скорость считывания кадров</td><td>1 25 кадров/сек</td></tr><tr><td colspan="2">Наличие цифровой обработки видеосигнала</td></tr><tr><td colspan="2">Наличие возможности сохранения последнего кадра в памяти видеосистемы</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>18.</td><td>Камеры флюорографические цифровые</td><td>КФЦ-«Электрон» 94 4220</td><td>ТУ 9442-006-11150760-00</td><td>то же</td><td>Сертификат соответствия Госстандарта России РОСС RU. ИМ02.В08458.
<table><tr><th>Характеристики</th><th>Значения</th></tr><tr><td colspan="2">1. Камера флюорографическая цифровая</td></tr><tr><td>Размер рабочего поля</td><td>390 x 390 мм</td></tr><tr><td>Разрешающая способность</td><td>2,5 2,8 пар линий/мм</td></tr><tr><td>Производительность</td><td>60 снимков/час</td></tr><tr><td>Экспозиционная доза на одну флюорограмму</td><td>менее 2 мР</td></tr><tr><td colspan="2">2. Аппаратно-программный комплекс АРМ</td></tr><tr><td>Количество АРМ</td><td>2</td></tr><tr><td>Объем памяти базы данных</td><td>30 000 снимков</td></tr><tr><td>Размер монитора лаборанта / врача</td><td>19' / 22"</td></tr><tr><td colspan="2">Наличие автоматизированного формирования медицинских документов</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
19.	Аппарат рентгенографический цифровой	ОКО АРЦ-1		НИПК «Электрон», г.Санкт-Петербург	Предназначен для проведения полноформатной цифровой рентгенографии во всех проекциях. Впервые создан аппарат, который позволяет получать цифровой снимок с более высокой информативностью по сравнению с рентгенограммой на пленке.	

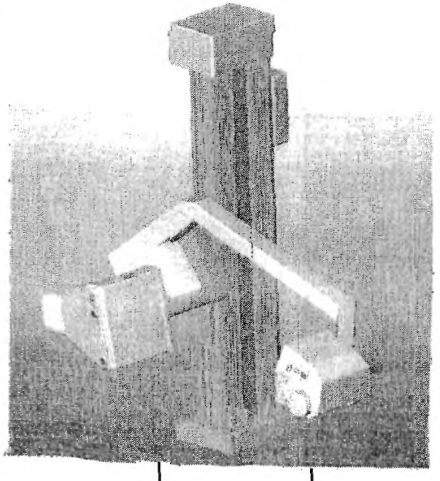

Характеристики	Значения
1. Камера рентгенографическая цифровая	
Размер рабочего поля	390 x 390 мм
Разрешающая способность	3,7 пар линий/мм
Пороговый контраст	2%
Динамический диапазон	Более 150
2. Штативная часть	
Высота над полом в крайнем верхнем / нижнем положении кронштейна с камерой и излучателем	151 / 41 см
Угол поворота кронштейна с камерой и излучателем в вертикальной плоскости	180°
Тип привода штатива	эл. двигателя
Фокусное расстояние	120 см
3. Рентгеновский излучатель	
Количество фокусных пятен в рентгеновской трубке	2
Ном. размер эффективных фокусных пятен рентгеновской трубки	0,6/1,2 мм
Максимальное напряжение на трубке	150 кВ
4. Рентгеновское питающее устройство	
Мощность генератора	80 кВт
Диапазон изменения анодного напряжения	40 ... 150 кВ
Диапазон тока рентгеновской трубки	0,5 ... 800 мА
Диапазон параметра мАс (ток*время)	0,2 ... 640 мАс
5. Программно-аппаратный комплекс АРМ-1, АРМ-2	
Количество АРМ	2
Объем памяти базы данных	30 000 снимков
Размер и тип монитора лаборанта	20" ЖКИ
Размер и тип монитора врача	21" ЖКИ

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
20.	**Ширмы рентгенозащитные**			**ЗАО АМИКО, г.Москва**	Выпускаются все виды ширм (одинарные двойные тройные) согласно Номенклатуре МЗ РФ Свинцовый эквивалент стекла – 2 мм, ширмы – 1,2 мм Размеры центральной панели, мм 2045x1000x10 Размер боковых панелей мм 2045x750x10 Размер окна мм 300 x 400	
21.	**Воротник**			**то же**	Предназначен для защиты щитовой железы при черепных и стоматологических исследованиях Свинцовый эквивалент – 0,35 мм	
22.	**Пелерина**			«	Предназначен для защиты щитовой железы при черепных и стоматологических исследованиях Свинцовый эквивалент – 0 35 мм	
23.	**Фартук рентгенозащитный стоматологический**			«	Свинцовый эквивалент – 0 35 мм	

7. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ.

№ п/ п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
1.	**Светильник стоечный гинекологический**	**«УНИЛЮКС-ССМ-28-04»**		**ООО «СТОМЭЛ-К», г.Воронеж**	Переносной напольный светильник с низкой стойкой, с мощным световым «холодным» потоком не менее 40000 люкс, с возможностью регулировки от 0 до максимума. Питание ~220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, ВА 200 Освещенность в центре рабочего поля на расстоянии 0,8 м от излучателя и при номинальном напряжении – не менее 28 000 люкс. Размер рабочего поля диаметром 600 мм. Высота, мм 932 ± 200 Масса, кг 11	6 400
2.	**Светильник медицинский гинекологический**	**П-5**		**ЗАО «Завод ЭМА», г. Екатеринбург**	Максимальная освещенность рабочего поля, люкс 35 000 *Размер рабочего поля, см* 13 Источник света. Тип лампы АКГ-12-55-1 (НЗ) Количество ламп 2 *Питание* 220 В, 50 Гц Потребляемая мощность, ВА 200 Перемещение осветителя по вертикали, мм 380 Масса, кг 45	14 760 (с НДС)
3.	**Кровать акушерская**	**КА-2** 94 5213		**ОАО «Завод медицинского оборудования» п.Досчатое**	• Каркас выполнен из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием • Неподвижная часть установлена на опоры и два ролика • Выдвижная панель установлена на два ролика и облицована нержавеющей сталью • Регулировка панелей осуществляется механически с помощью гребенок **Стандартный комплект:** - выдвижная ступень - гигиенические матрацы и подушка - чаша из нержавеющей стали - упоры для рук - столик для рук - лоток из нержав. стали - опоры для колен - упоры для стоп Габариты , мм: длина 2050 ширина 1350 высота от 1225 до 1350 Угол наклона спинной секции 60° Тренделенбург 10°	9400

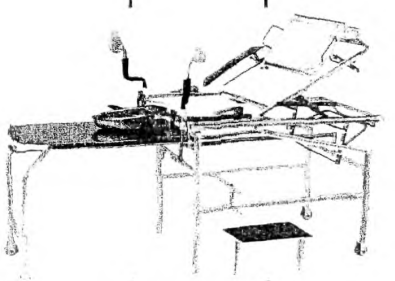

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
4.	Кресло гинекологиченское	КГ-3М 94 5214		ОАО «Завод медицинского оборудования» п.Досчатое	• Каркас выполнен из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием • Основание кресла установлено на опоры и два ролика • Регулировка спинки и сиденья осуществляется с помощью 4-х пневмопружин • Элементы крепления аксессуаров выполнены из стали с никельхромовым покрытием **Стандартный комплект:** - опоры для колен - выдвижной тазик - столик для рук - упоры для рук - откидная ступень - съемная ножная панель Габариты (длина х ширина х высота), мм 1660 x 945 x 900 Угол наклона спинки $20^{\circ} - 100^{\circ}$ Угол наклона сидения $0^{\circ} - 20^{\circ}$	9300
5.	Кресло гинекологиченское	КГ-1 94 5214		то же	• Каркас выполнен из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием • Основание кресла установлено на опоры и два ролика • Регулировка спинки и сиденья осуществляется механически • Элементы крепления аксессуаров выполнены из стали с никельхромовым покрытием **Стандартный комплект:** - опоры для колен - выдвижной тазик - упоры для рук - откидная ступень - регулируемый столик - инфузионная стойка Габариты (длина х ширина х высота), мм 1605 x 925 x 900 Угол наклона спинки $20^{\circ} - 100^{\circ}$ Угол наклона сидения $0^{\circ} - 20^{\circ}$	7500
6.	Кресло гинекологическое	КГП-01		ОАО «ПроМеТеИ-плюс», г Елец	Предназначено для гинекологических операций и урологических исследований. Регулировка спинки и сиденья осуществляется с помощью пневмопружины. Габариты (длина х ширина х высота), мм 1055 x 965 x 1650 Угол наклона спинки $0^{\circ} - 70^{\circ}$ Угол наклона сидения $0^{\circ} - 20^{\circ}$ Масса, кг, не более 80	9 030 с НДС

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
7.	**Столик инструментальный акушерский**	**СИА** 94 5216		**ОАО «Завод медицинского оборудования» п.Досчатое**	Основание выполнено из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием. 2 полки из нержавеющей стали Колеса Ø 125 мм самоориентирующиеся Габариты (длина х ширина х высота), мм 830 x 490 x 920	2100 +НДС 20 %
8.	**Стол для санитарной обработки новорожденных**	**«АИСТ»** 94 5216		**то же**	Предназначен для размещения на нем новорожденного ребенка при проведении санитарной обработки, осмотра, пеленания, измерения роста и других процедур в детских комнатах родового и послеродового отделений родильных домов, больниц и институтов. • Каркас выполнен из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием • Основание установлено на роликовые опоры • Устройство обогрева ложа • Панель управления со световой сигнализацией • Откидные полки • Шкаф для хранения белья Температура рабочей поверхности подушки, °С 30 – 37 Напряжение сети, Вт 220 Потребляемая мощность, В 1500 Класс и степень защиты от поражения эл. током II, B Макс. нагрузка на панели стола и на каждый из откидных полок, кг, не более 25 Габаритные размеры, мм: стола (длина х ширина х высота) 1860 x 830 x 1800 ложа для пациента (длина - ширина) 800 Масса стола. кг, не более 80	6800 +НДС 20 %



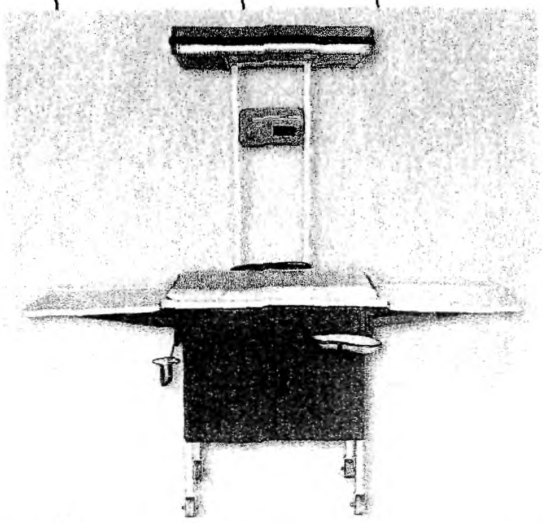

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
9.	Стол пеленальный	ММ 56.10.00		ЗАО «ПКЦ»Кетгут», г.Краснодар	Две полки, размеры, мм – 700 х 700 х (800+150)	1 345
		ММ 56.10.01			Доп. полка для растворов, размеры, мм - 700 х (700+350) х (800+150).	1 601
		ММ 56.11.00			Двухместный, размеры, мм - 700 х (700+700+350) х (800+150).	2 419
		ММ 56.11.01			Доп. полка весов, размеры, мм - 700 х (700+350+700+650) х (800+150).	3 489
10.	Кровать акушерская	КА-01-«К»-К		то же	 КРОВАТЬ акушерская КА-01-"К"-К	

8. АППАРАТУРА ФИЗИОТЕРАПИИ И СВЕТОЛЕЧЕБНАЯ.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
1.	**Аппарат магнитотерапии**	**«Полюс-101»**		**ЗАО «Завод ЭМА», г Екатеринбург**	Предназначен для лечебного воздействия в основном на конечности больного магнитным полем повышенной частоты **Форма тока, питающего индукторы:** синусоидальная **Режим магнитного поля:** прерывистый и непрерывный **Показания** заболевания периферических сосудов конечностей - хроническая венозная недостаточность - окклюзионные заболевания периферических артерий атеросклеротического генеза - повреждения конечностей и их последствий ***Лечение не сопровождается выделением тепла или разогревом тканей***	7 690
2	**Аппарат**	**«Полюс-2»**		**то же**	Предназначен для лечебного воздействия низкочастотным магнитным полем на любые участки тела пациента ***Аппарат удобен для применения в палате, у постели больного.*** **Форма тока, питающего индукторы:** синусоидальная пульсирующая **Показания:** - ишемическая болезнь сердца - гипертоническая болезнь заболевания органов дыхания и пищеварения, заболевания периферических сосудов - заболевания опорно-двигательного аппарата - заболевания периферической и центральной нервной системы, - заболевания мочевыводящей и половой системы	13 000
3	**Аппарат электротерапии**	**«Поток-1»**		**«**	Предназначен для профилактического лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизация) проведения лекарственного электрофореза **К аппарату прилагаются:** комплект принадлежностей со свинцовыми электродами провода пациента пластина свинцовая комплект принадлежностей с углетканевыми электродами набор прямоугольных электродов шести типоразмеров двухлопастной трехлопастной-полумаска Бергонье воротниковыи провода пациента комплект принадлежностей с одноразовыми электродами (го заказу) электроды ректальные вагинальные провод пациента ***Применяются для лечения различных заболеваний в стационарах и на дому***	1 620

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
4.	**Облучатель ртутно-кварцевый** (передвижной на штативе)	**ОРК-21М1**		**ЗАО «Завод ЭМА», г. Екатеринбург**	Предназначен для проведения общих и местных облучений в физиотерапевтических кабинетах лечебных заведений Ультрафиолетовое излучение создаваемое лампой, повышает общую сопротивляемость организма, улучшает обмен веществ, понижает возбудимость нервных элементов кожи Источник излучения / количество — ДРТ-400 / 1 шт Мощность ВА — 1000 Напряжение, В / частота Гц — 220 / 50 Расстояние до облучаемой поверхности, м — 1,0 Облученность, Вт/м^2 — 2,5 Габаритные размеры мм — 400х550х1600 Масса кг — 15	3 550
5.	**Облучатель ртутчо-кварцевый** (настольный)	**ОКН-11М**		**то же**	Предназначен для общих и местных облучений в физиотерапевтических кабинетах лечебных заведений Подставка, на которой укреплен корпус облучателя, дает возможность вращения его вокруг горизонтальной оси Источник излучения / количество — ДРТ-240-1 / 1 шт Мощность, ВА — 950 Напряжение, В / частота, Гц — 220 / 50 Расстояние до облучаемой поверхности, м — 0,75 Облученность, Вт/м^2 — 2 5 Габаритные размеры мм — 155х170х290 Масса кг — 3	1 275
6.	**Облучатель стационарный**	**УГН-1**		**«**	Предназначен для групповых локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости рта носоглотки миндалин) и полости уха Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора Источник излучения / количество — ДРТ-240 / 1шт Мощность ВА — 1000 Напряжение, В / частота, Гц — 220 / 50 Облученность Вт/м^2 — 40 Габаритные размеры мм — 890х890х540 Масса, кг — 11	

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
11.	**Аппарат для ультразвуковой терапии**	**УЗТ-1.03 У**		**Завод «ЭМА», г.Москва**	Предназначен для лечения ультразвуком урологических заболеваний типа хронического пиелонефрита, цистита дистаний, хронического простатита, мочекаменной болезни Режим работы – непрерывный или импульсный Напряжение питания, В / частота, Гц — 220 / 50 Потребляемая мощность, В А — 50 Частота ультразвуковых колебаний, МГц — 0 88 ± 0,1% Эффективная площадь излучателей, $см^2$: - ИУТ 0,88-1 03 Ф — 1 - ИУТ 0,88-1 05 Ф — 1 - ИУТ 0,88-4 04 Ф — 4 - ИУТ 0,88-2 08 Ф — 2 Регулировка отдаваемой мощности — ступенчатая Интенсивность ультразвуковых колеба**ний по ступеням,** Вт/$см^3$ – 1,0, 0,7, 0,4, 0,2, 0,05 Габаритные размеры, мм — 341x290x142 Масса, кг — 7	10 300
12.	**Ультразвуковой аэрозольный аппарат**	**ТУМАН-1.1**		**то же**	Предназначен для профилактики заболеваний верхних дыхательных путей и легких мелкодисперсными аэрозолями жидких лекарственных веществ Применяется в пульмонологии, оториноларингологии, педиатрии Рабочая частота, МГц — 2 64 ±1% Диаметр частиц аэрозолей на рабочей частоте мкм — до 5 (90% объема) **от** 5 до 10 (10% объема) Максимальная производительность распыления жидкости, мл/мин — не менее 0,6 Макс распыляемый объем жидкости, мл — не менее 18 Мин нераспыливаемый объем жидкости, мл — не более 4 Напряжение питания В / частота Гц — 220 / 50 Потребляемая мощность, Вт — не более 35 Габаритные размеры, мм — 300 x 115 x 225 Масса, кг — 5	5 200
	***В комплект поставки** входят электронный блок, распылительная камера КРУЗ-1 01 соединительный кабель, а также запасные части и принадлежности укладки и паспорт*					

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
13.	**Ультразвуковой ингалятор**	**МУССОН-1**		**Завод «ЭМА», г.Москва**	Предназначен для проведения ингаляций водорастворимыми лекарственными средствами при заболеваниях верхних дыхательных путей, бронхов и легких. Возможно применение аппарата как в домашних, так и в поликлиниках и больницах. Рабочая частота, МГц — 2,64 ±1% Диаметр 90% частиц аэрозолей, мкм — 5 Макс. производительность распыления, мл/мин — не менее 0,4 Объем распыляемой жидкости, мл — не менее 5 Напряжение питания, В / частота, Гц — 220 /50 Потребляемая мощность, Вт — 30 Габаритные размеры, мм — 145 x 100 x 100 Масса, кг — 1,4	980
14.	**Аппарат низкочастотной терапии**	**«Амплипульс-2»**		**ФГУП Курский завод «Маяк», г.Курск**	Предназначен для лечебного воздействия на организм человека модулированными токами звуковой частоты. Применяется физиотерапевтических кабинетах медицинских учреждений для лечения больных с заболеваниями нервной системы, сопровождающими болями, вегетативными и двигательными нарушениями; с нарушениями периферического кровообращения; при различных травматических повреждениях. Частота несущих колебаний синусоидальной формы, Гц — 5000 Дискретные значения частоты модулирующего напряжения, Гц — 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150 Соотношение длительности серий и пауз, с — 1:1,5; 2:3; 4:6 Время нарастания и спада тока в сериях, мс — 200; 400; 800 Диапазон плавной регулировки тока пациента, мА — 0÷10; 0÷20; 0÷100 Электробезопасность — II, BF Напряжение питания, В / частота, Гц — 220 /50 Потребляемая мощность, Вт — 55 Габаритные размеры, мм — 330 x 325 x 195 Масса, кг — 8	

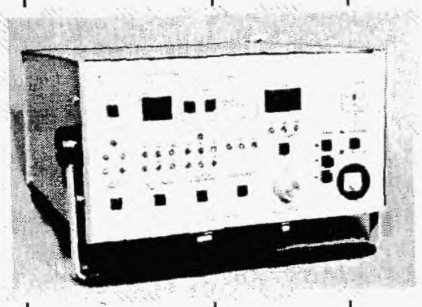

9. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ.

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Тип лампы	Кол. ламп	Производительность облучателя, $м^3$/ч	Мощность облучателя, Вт	Объем обрабатываемых помещений, $м^3$	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб.
	Облучатели бактерицидные (передвижной, настенно-потолочный, рециркулятор) предназначены для обеззараживания воздуха помещений лечебных и лечебно-профилактических учреждений, противотуберкулезных диспансеров и т д , а также для обеззараживания поверхностей помещений операционных, процедурных и стоматологических кабинетов, аптек и медицинского оборудования ***Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ45.В00195*** *действует до 10 12 2004г*											
1.	**Облучатель бактерицидный** (настенный рециркулятор)	**ОБРН-15Э** 94 4430	**ТУ 9444-001-12575616-94**	**НПМТО «Кредо», г.Златоуст**	ДБМ-15 TUV-15WL	2	43	40	50	495x115x100	2	**2100**
					Напряжение питания, В 220							
					Коэффициент использования бактерицидного потока, кФ – 0,4							
2.	**Облучатель бактерицидный** (настенно-потолочный)	**ОБРНП-30х2** 94 4430			ДБМ-30 TUV-30WL	2	224/345	70	100	920x102x10	2 5	1140 (660)*
					Напряжение питания, В 220							
					Коэффициент использования бактерицидного потока, кФ – 0,52/0,8							
					Суммарный бактерицидный поток ламп, % бк ВТ - 20							
					** Цена без ламп*							
3.	**Облучатель бактерицидный** (настенно-потолочный)	**ОБРНП-30х2 94 4430**			ДБМ-30 TUV-30WL	1	112/172	35	50	920x650x35	2,0	650 (410)*
					Напряжение питания В 220							
					Коэффициент использования бактерицидного потока, кФ – 0,26/0,4							
					Суммарный бактерицидный поток ламп, % бк ВТ - 10							
					** Цена без ламп*							
4.	**Облучатель бактерицидный** (передвижнои)	**ОБРПе-30х6** 94 4430			ДБМ-30 TUV-30WL	6	698	210	300	1200x650x650	11	4180 (2100)*
					Напряжение питания, В 220							
					Коэффициент использования бактерицидного потока кФ – 0 9							
					Суммарный бактерицидный поток ламп, % бк ВТ – 36							
					** Цена без ламп*							

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Тип лампы	Кол ламп	Производительность облучателя, м³/ч	Мощность облучателя, Вт	Объем обрабатываемых помещений, м³	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб.
5	Облучатель бактерицидный (передвижной)	**ОБРПе-30х3 94 4430**	**ТУ 9444-001-12575616-94**	**НПМТО «Кредо», г.Златоуст**	ДБМ-30 TUV-30WL	3	349	105	150	1200х650х650	9 5	3100 (1800)*
					Напряжение питания В 220 Коэффициент использования бактерицидного потока кФ – 0,45 Суммарный бактерицидный поток ламп % бк ВТ – 18 ** Цена без ламп*							
6	Облучатель бактерицидный (настенный)	**ОБН-150**		**ЗАО «Завод ЭМА», г. Екатеринбург**	ДБ-30/ TUV30	1	60/75 (при 99% обеззараживания)			50 х 80 х 940	2,5	
	Цена, руб - ***ОБН-150-03*** *(1 лампа) – 650* ***ОБН-150-03*** *(1 лампа) с экраном – 650* - ***ОБН-150*** *(2 лампы) – 1 300* ***ОБН-150-03/ ОБН 150*** *(без ламп) – 400 / 900*				Напряжение / частота электропитания – 220 В / 50 Гц Суммарный бактерицидный поток ламп Вт – 9 0 / 11 2 Облученность на расстоянии 1 м Вт/кв м – 1 12 / 1,2 Потребляемая мощность ВА – 50							
7	Облучатель бактерицидный (потолочный)	**ОБП-300**		**то же**	ДБ 30/ TUV30	2	200/250 (при 99% обеззараживания)			110х80х940	3 5	
	Цена, руб - ***ОБП-300-03*** *(2 лампы) – 1 180* - ***ОБП-300****(4 лампы) – 2 350* ***ОБП-300-03/ ОБП-300*** *(без ламп) – 688 / 1 345*				Напряжение / частота электропитания – 220 В / 50 Гц Суммарный бактерицидный поток ламп Вт – 18 0 / 22 4 Облученность на расстоянии 1 м Вт/кв м – 2 2 / 2 4 Потребляемая мощность ВА – 100							
8	Облучатель бактерицидныи (передвижной)	**ОБПе-450**		«	ДБ 30/ TUV30	6	683/850 (при 99% обеззараживания)			580 х 1100	15	
	Цена, руб ***ОБПе-450*** *(6 ламп) – 4 070* - ***ОБПе-450****(без ламп) – 2 570*				Напряжение / частота электропитания – 220 В / 50 Гц Суммарныи бактерицидный поток ламп Вт – 54 0 / 67 2 Облученность на расстоянии 1 м Вт/кв м – 3 6 / 4 5 Потребляемая мощность ВА – 300							

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
	Камеры дезинфекционные предназначены для дезинфекции и дезинсекции пароформалиновым и паровоздушным методами одежды, обуви, белья, постельных принадлежностей а также книг и архивной документации					
9	**Камера дезинфекционная**	**ВФЭ-2/0,9 СЗМО ВФЭ-2/0,9-01 СЗМО** 94 5111	**ТУ 9451-001-07614018-2002**	**ОАО Медобо-рудование», г.Саранск**	***Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ04.В03440*** *действует до 31 12 2004г* Камера имеет собственный источник пара Управление камерой полуавтоматическое и ручное Питание от сети 3-фазного переменного тока Напряжение, В / частота Гц — 380 или 220 / 50 Потребляемая мощность, кВт — 12 Внутренние размеры мм — 1310x710x1950 Объем камеры, $м^3$ — 1 89 Габаритные размеры, мм — 1390x995x2150 Масса кг — 700	
	Цена, руб.: - ***ВФЭ-2/0,9 СЗМО*** *– 46 000,* - ***ВФЭ-2/0,9-01-СЗМО*** *(из нерж стали) – 112 000*					
10.	**Камеры дезинфекционные**	**ВФС-2/1,4; ВФС-3/2,1** 94 5110	**ТУ 9451-012. 07614018-2001**	**то же**	***Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ04.В03173*** *действует до 14 03 2003 г* Камеры оборудованы микропроцессором **МИНИТЕРМ 300** (управление автоматическое и ручное) с помощью которого устанавливается заданная температура и выдержка времени для дезинфекции	78 000 92 000
	Рабочая температура внутри дезкамер 0 от 40 до 98°С с предельным отклонением в контрольной точке +2°С Питание камер от сети трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 380 В и частотой 50 Гц Номинальная потребляемая мощность кВт – 1,5				**ВФС-2/1,4** / **ВФС-3/2,1** Габаритные размеры дезкамер мм - длина — 1830 + 8 / 2520 + 10 - ширина — 1674 + 8 / 1674 + 8 - высота — 2500 + 10 / 2500 + 10 Внутренние размеры дезкамер мм - длина — 1500 + 8 / 2200 + 8 - ширина — 950 + 3 / 950 + 3 - высота — 1600 + 8 / 1600 + 8 Рабочий объем дезкамер $м^3$ — 2,1 / 3 3 Площадь пола дезкамер, $м^2$ — 1,4 / 2 1 Масса кг не более — 1300 / 1600	
11.	**Камера дезинфекционная**	**ВФС-5/2.6** 94 51111009	**ТУ 9451-026-07614018-2002**	**«**	Состоит из следующих составных частей камеры проходного типа с двумя дверями, загрузочной тележки пульта управления Внутренние размеры камеры, мм — 1800+9,5x1400+8,5x1900+9,5 Площадь пола, $м^2$ — 2 6 Объем камеры, $м^3$ — 5 Габариты мм — 2350+10 5x2170+10,5x2050+10 5 Масса, кг — 2000	
	Цена с НДС, руб : ***ВФЭ-5/2,6*** *– 102 000* ***ВФЭ-5/2,6-01-****(из нерж стали) – 285 600*					

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
12.	**Парогенератор электрический**	**ПЭЛ-100** 94 5110	**ТУ 9451-027-07614018-01**	**ОАО Медоборудование», г.Саранск**	***Сертификат соответствия РОСС RU.ME20.B02236*** *действует до 14 03 2003 г* Предназначен для пароснабжения дезинфекционных камер водяным насыщенным паром в учреждениях здравоохранения, не имеющих централизованного пароснабжения Режим работы парогенератора автоматический Производительность, кг/ч 100 Рабочее давление, кгс/см^2 – 0,7- 3 0 (поддерживается автоматически в заданном диапазоне) Потребляемая мощность, кВт 85 Питание от сети переменного тока 380 В 50 Гц Габаритные размеры мм 1200x600x1600 Масса парогенератора кг 400	66 000
13.	**Кипятильники дезинфекционные**	**П-18-1; П-22-1 П-40-1**		**ОАО «Завод медицинского оборудования» п.Досчатое**	Предназначены для дезинфекции методом кипячения в дистиллированной воде хирургического инструмента и медицинских принадлежностей Изготавливаются из нержавеющей стали **П-18-1** / **П-22-1** / **П-40-1** Габариты, мм: 219x88x52 / 270x130x65 / 451x199x95 Объем заливаемой воды, л: 0 4 / 0,75 / 4,0 Масса кг: 0,8 / 1,4 / 3,2	390 480 760
14.	**Кипятильники дезинфекционные электрические автоматические**	**КДЭА-1-4; КДЭА-2-4**		**то же**	Предназначены для дезинфекции методом кипячения в дистиллированной воде Вместимость кипятильников – 4 л Кипятильник КДЭА-2-4 (двухрежимный) после истечения установленного времени режима кипячения (15 или 30 минут) автоматически отключается **КДЭА-2-4** / **КДЭА-1-4** Габариты, мм: 476x210x250 / 445x210x197 Масса, кг: 12 / 10 Напряжение сети, В: 220 / 220 Потребляемая мощность, Ва: 1500 / 1300 *Время нагрева воды до кипения, мин*: 30 / 30 Устанавливаемое время режима кипения воды мин режим I: 15 / - режим II: 30 / -	2 800

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
15.	**Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный**	**ОВУД «Солнышко»** 94 4430	**ТУ 9444-005-45844362-99**	**ОАО НИПОМ, г.Дзержинск**	***Сертификат соответствия РОСС RU.ИМ02.В09424*** *действует до 11.02.2005г.* Предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещения лечебных, профилактических, детских учреждения и т.д.	

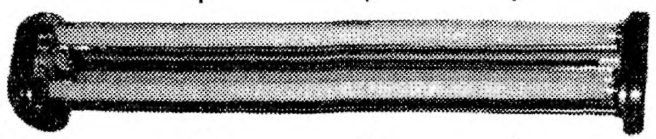

	ОВУД	
Источник излучения	ДБ30-1 (TUV 30W)	ДБ15 (TUV 15W)
Количество бактерицидных ламп, шт.	2	2
Дезинфицируемый объем, $м^3$	60	30
Мощность одной лампы, Вт	30	15
Напряжение питания	~220 В	
Потребляемая мощность, Вт	195	98
Время установления рабочего режима, мин	1,0	
Время непрерывной работы, ч	1,5 ÷ 2,0	
Время перерыва перед повторным включением, мин.	30 ÷ 60	
Габаритные размеры, мм: IP20	999x180x125	542x180x125
IP65	973x180x125	515x180x125
Масса, кг: IP20	5,4	4,5
IP65	6,0	5,0

Облучатель бактерицидный ОВУД-«Солнышко»-000 – комбинированный, настенно-потолочный – с 2-мя лампами производства «Philips»	1 300
Облучатель бактерицидный ОВУД-«Солнышко»-075 – открытый, настенный (модернизированный ОБН-75) – с 1 лампой производства «Philips»	750
Облучатель бактерицидный ОВУД-«Солнышко»-150 – комбинированный, настенный (модернизированный ОБН-150)– с 2-мя лампами пр-ва «Philips»	1 300
Облучатель бактерицидный ОВУД-«Солнышко»-300 – комбинированный, потолочный (модернизированный ОБН-300) – с 4-мя лампами пр-ва «Philips»	2 350

10. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

№ п/п	Код оборудования	Наименование и краткая техническая характеристика	Тип, марка оборудования	ГОСТ, нормаль, ТУ или каталог	Завод-изготовитель.	Основные параметры и размеры: Объем стерилизационной камеры, $дм^3$	Рабочее давление пара, $кгс/см^2$	Потребляемая мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса единицы оборудования, кг	Цена единицы оборудования руб.	Гарант. срок службы, год	Примечание
1	2	3	4	5	6	7а	7б	7в	7г	8	9	10	11
1.	945121	Стерилизатор паровой	ВК-75	ТУ64-1--3667-82	ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"	75	2,2	6	740х570х1070	140	56490		
						Род тока - переменный, трехфазный, 380В, 50 Гц							
						Способ управления стерилизатором- полуавтоматический							
						Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром.							
						Давление пара в стерилизационной камере поддерживается автоматически.							
						Стерилизационная камера и паровая рубашка изготовлены из нержавеющей стали.							
2.	945121	То же	ГК-100-3М	то же	то же	100	2,2	12	1330х710х1500	280	62150		
						Род тока - переменный, трехфазный, 380В, 50 Гц							
						Способ управления стерилизатором- полуавтоматический							
						Стерилизатор предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургического инструмента, хирургических перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром в стационарных лечебных учреждениях.							
						Стерилизационная камера и парогенератор изготовлены из нержавеющей стали.							

№ п/п	Код оборудования	Наименование и краткая техническая характеристика оборудования	Тип, марка оборудования	ГОСТ, нормаль, ТУ или каталог	Завод-изготовитель.	Основные параметры и размеры				Масса единицы оборудования, кг	Цена единицы оборудования, руб.	Гарант. срок службы, год	Примечание
						Объем стерилизационной камеры, $дм^3$	Рабочее давление пара, $кгс/см^2$	Потребляемая мощность, кВт	Габаритные размеры, мм				
I	2	3	4	5	6	7а	7б	7в	7г	8	9	I0	II
3.	9455 I2I0003	Стерилизатор паровой	ВКО-50	ТУ64-I--3667-82	ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"	50	2,2	—	570х5I0хII40	70			
						Управление - ручное							
						Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, операционного белья, хирургического инструмента, перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них пара в условиях стационарных и полевых медицинских учреждений.							
						Способ нагрева - от внешнего источника тепла.							
						Стерилизационная камера изготовлена из нержавеющей стали.							
4.	9451 2I0004	То же	ВКО-75	то же	то же	75	2,2	—	640х580хI240	85			
						Управление - ручное							
						Способ нагрева - от внешнего источника тепла							
						Назначение см. поз. 3							
5.		"	ВКУ-50	"	"	50	2,2	4,8	570х560хII40	90	61150 с кожухом		
						Род тока - переменный, однофазный, 220В, 50 Гц							
						Способ управления стерилизатором - ручной							
						Способ нагрева - от внешнего источника тепла или от ТЭНов.							
						Назначение см. поз. 3							

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
6.	**Стерилизаторы паровые**	**ВК**		**ОАО «Тюменьский завод медицинского оборудования и инструментов»**	Стерилизаторы паровые с вертикальной круглой камерой предназначены для стерилизации насыщенным паром под давлением материалов, инструментов и принадлежностей, применяемых в медицинской практике ❖ *Основные узлы стерилизаторов изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали,* ❖ *Имеют два режима стерилизации* - *132°С – 20 минут при давлении 0,2 МПа,* - *120°С – 45 минут при давлении 0,11 МПа*	49140 (ВК-30)
					ВК-30 / **ВК-75-ПТ** Габаритные размеры, мм: высота 920 / 1100; ширина 500 / 570; длина 700 / 755 Внутренние размеры стеркамеры, мм: диаметр 300 / 400; глубина 520 / 630 Объем стеркамеры, $дм^3$: 30 / 75 Напряжение, В: 220 / 380 Номинальная мощность, КВт: 4 / 6 Масса, кг: 60 / 80 Управление: полуавтоматическое Комплектация: кассеты 2 шт / КСК-18 – 3 шт	
7.	**Стерилизатор горизонтальный**	**ГК-10-1**		**то же**	Объем стерилизационной камеры, л: 10 Рабочее давление, МПа: 0,22 Температура, °С: 132 ± 2 Количество режимов: 1 Габаритные размеры, мм: 610х280х340 Масса кг: 21 Способ управления: полуавтоматический Электропитание от сети однофазного переменного тока - напряжение В / частота, Гц: 220 / 50 - мощность, кВт: 1	14000

ВК-30
ВК-75-ПТ

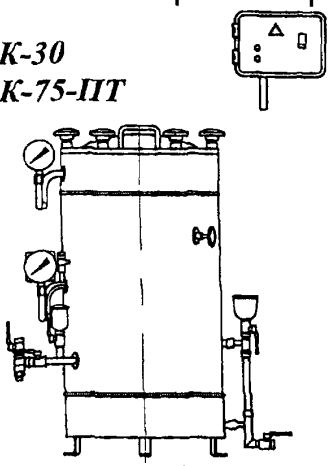

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
8.	**Стерилизаторы паровые шкафные**			**ОАО «Тюменьский завод медицинского оборудования и инструментов»**	Применяются для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением материалов инструментов и принадлежностей, применяемых в медицинской практике Основные узлы стерилизаторов изготовлены из коррозионностойкой нержавеющей стали Стерилизаторы типа ГПД имеют две двери в камеру с разделением на чистую и стерильную зоны Стерилизаторы ГПД-400 ГП-560, ГПД-560 могут комплектоваться самописцем для регистрации данных Для более удобной транспортировки и установки конструкция ГПД-400, ГП-560 ГПД-560 позволяет разделить стерилизатор на два блока блок камеры и электросекции	

Стерилизатор ГП-400

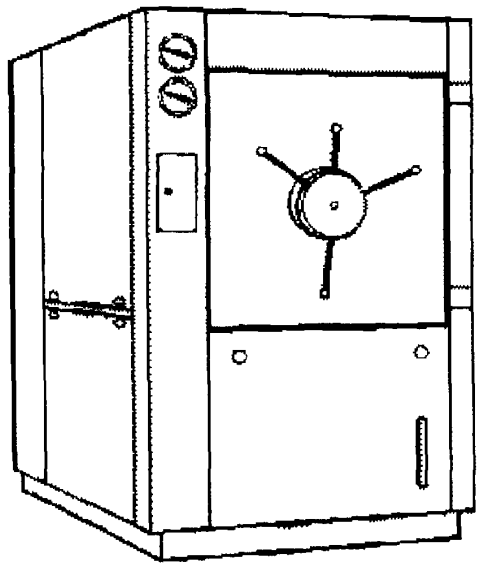

Характеристики	ГП-400	ГПД-400	ГП-560	ГПД-560	ГПС-560
Высота стерилизатора мм	1800	1800	1800	1800	1800
Ширина стерилизатора, мм	980	1240 (355+885)	1240 (355+885)	1240 (355+885)	980
Длина стерилизатора, мм	1285	1310	1460	1670	1460
Размеры стеркамеры мм	630x900x710		630x1050x900		
Объем камеры $дм^3$	400	400	560	560	560
1 режим (0,2 МПа), °С – мин	132 – 20	134 – 5	134 – 5	134 – 5	132 – 20
2 режим (0,11 МПа) °С – мин	120 – 45	121 – 20	121 – 20	121 – 20	120 – 45
Парогенератор и парогасетель	есть	есть	есть	есть	нет
Напряжение, В	380	380	380	380	220
Номинальная мощность кВт	22	24	45	45	1,2
Масса кг	900	1316	1416	1516	600

Стоимость, руб.

(Холдинг «МЕДСНАБ-Групп» ООО «ВЛАДМЕДПОСТАВКА» г Москва)

ГП400-1	ГПД400-2	ГП560-2	ГПД560-2 исп.00	ГПС560-1
294000	516600	550500	559800	294000

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	Поставщик	Технические характеристики	Цена, руб.
9.	Стерилизаторы воздушные	ГП-10МО; ГП-20МО; ГП-40МО; ГП-80МО	Холдинг «МЕДСНАБ-Групп» ООО «ВЛАД-МЕДПОСТАВКА» г.Москва	Стерилизаторы воздушные предназначены для стерилизации дезинфекции, и сушки всевозможного медицинского инструмента и материалов При работе со стерилизатором вся необходимая информация о текущих и установленных значениях температуры времени стерилизации, режиме работы и выбранной программе отображается на цифровых дисплеях и единичных индикаторах Для сокращения цикла стерилизации применено принудительное охлаждение рабочей камеры посредством дополнительного контура охлаждения, что исключает применение специальных фильтрующих сменных элементов Питание однофазная сеть переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц	10400, 10300, 11700, 13300

Характеристики	ГП-10МО	ГП-20МО	ГП-40МО	ГП-80МО
Мощность, кВт	1,0	1,3	1,8	2,8
Масса, кг, не более	25	45	53	65
Габаритные размеры, мм				
ширина	460	640	720	830
глубина	560	560	620	690
высота	440	440	520	620
Внутренние размеры стеркамер				
ширина	150	325	405	510
глубина	210	210	270	340
высота	275	275	350	455
Время нагрева стерилизатора до температуры 180°С, минут	30	35	48	55
Время охлаждения до температуры 60°С, минут	40			
Задаваемые температурные режимы, °С	от 60 до 200			

Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения не более ±3°С

Время непрерывной работы стерилизатора в сутки не более 16 ч

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, не более 235°С

Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, не более ± 6°С

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Диаметр коробки, мм	Высота коробки, мм	Условный объем, $дм^3$	Масса, кг	Цена, руб.
10.	Коробки круглые стерилизационные без фильтра	94 5125		ОАО «Завод медицинского оборудования» п.Досчатое	Предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов с целью их стерилизации в паровых стерилизаторах Изготавливаются из нержавеющей стали Сохраняют стерильность обрабатываемых изделий в течение 3-х суток				
		КСК-3		ОАО «Тюменьский завод медицинского оборудования и инструментов» (КСК-18)	190	145	3,0	1,25	520
		КСК-6			250	165	6,0	2,25	600
		КСК-9			290	165	9,0	2,9	660
		КСК-12			340	165	12,0	3,45	710
		КСК-18			390	195	18,0	5 0	800
				«Гродненский завод торгового машиностроения» изготавливает коробки стерилизационные КСК-3, 6, 9, 12, 18 по ТУ 92-00243346-04-93					
11.	Коробки круглые стерилизационные без фильтра	94 5125		ОАО «Завод медицинского оборудования» п.Досчатое	Предназначены для размещения в них перевязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других предметов с целью их стерилизации в паровых стерилизаторах Изготавливаются из нержавеющей стали Сохраняют стерильность обрабатываемых изделий в течение 20 суток Комплектуются сменными фильтрами из хлопчатобумажной ткани				
		КФ-3			190	145	3 0	1,25	570
		КФ-6			250	165	6,0	2,25	660
		КФ-9			290	165	9,0	2,9	760
		КФ-12			340	165	12,0	3,45	850
		КФ-18			390	195	18,0	5,0	1150
				«Гродненский завод торгового машиностроения» изготавливает коробки стерилизационные КФ-3, 6, 9, 12, по ТУ РБ – 14478107 012-98					

№ п/п	Наименование оборудования изделия	Тип, марка. Код ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Цена, руб.
12.	Стерилизатор	ГК-100		ОАО Медобо-рудование», г.Саранск	Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации водяным, насыщенным паром под давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургического инструмента и пр.), стекла (посуда и пр.), резины (хирургические перчатки и пр.), изделия из текстильных материалов, не портящихся при воздействии на них паром. Стерилизатор применяется в лечебно-профилактических и др. медицинских учреждениях. *В комплект стерилизатора входят 4 стерилизационных коробки КСК-18.* Рабочее давление в камере, МПа (кгс/см^2) 0,22 (2,2) Напряжение, В 380 Частота, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 18 Внутренний диаметр камеры, мм 400 Количество режимов стерилизации 4 Габаритные размеры, мм 1600x600x1290 Масса, кг, не более 270 Средний срок службы не менее 10 лет.	**163200** с НДС

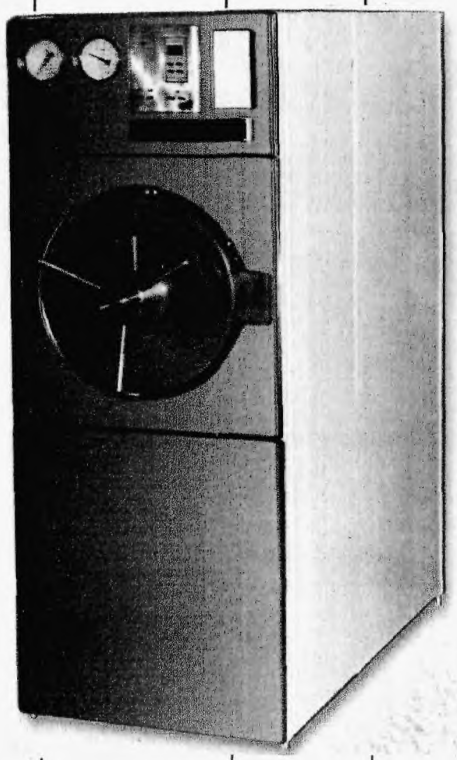

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб на 20.II.02
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Кровати функциональные	КФ4-3; КФ4-3М КТ4-2 КК4-2 945213		ОАО "Завод медицинского оборудования", р.п. Досчатое	Кровати предназначены для помещения на них взрослях больных: КФ4-3 -с заболеваниями нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем КФ4-3М- то же, регулирование секций при помощи пневмопружин КТ4-2 - с ортопедическими заболеваниями и травмами; КК4-2 - с заболеваниями костно-суставным туберкулезом. В кроватях КФ4-3, КК4-2 имеются боковые ограждения. Кровати КТ4-2, КК4-2 снабжены упором для ног. Кровать КТ4-2 снабжена кронштейном для поддержания шин в отведенном положении, устройством для подтягивания *Все кровати имеют: матрац пенополиуретановый (ватный), корзину под судно* Габариты, мм: длина - 2360, высота - II00, высота ложа - 600. ширина - 870(КФ4-3), 986(КТ4-2, КК4-2) Размеры подматрацной рамы (длина х ширина), мм 2000х800 *Углы наклона секции, град.*: спинной - 0 - +60 тазобедренной 0 +30 Угол наклона от горизонтали в сторону головы (вниз) 0° - I0 Номинальная нагрузка на кровать, кг I20	I20	9800 II400 9900 9900
	Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО 2.В00950.						
	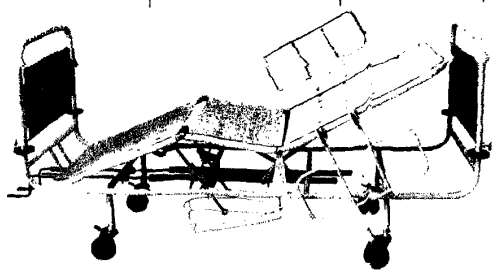 Кровать функциональная КФ 4-3						
2.	Кровати функциональные (подростковые)	КФД3-2 КТ3-2 КК3-2		то же	Предназначены для помещения на них больных детей в возрасте от 5 до I4 лет: КФД3-2 с заболеваниями нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем; КТ3-2 - с ортопедическими заболеваниями и травмами; КК3-2 - *с заболеванием костно-суставным туберкулезом.* Кровать состоит из основания, установленного на колеса с тормозом, подматрацной рамы со спинками и матрацев в чехле, поворотных ограждений (КФД3-2, КК3-2), регулируемых упоров для ног (КТ3-2, КК3-2), корзины для судна. Секции регулируются механически Еще входит в комплект: кронштейн для удержания верхних конечностей (КТ3-2); кронштейн для вытягивания нижних конечностей (КТ3-2, КК3-2) Габариты, мм: длина - I750, ширина - 775(КФД3-2, КК3-2), 887(КТ3-2) высота - I000(КФД3-2, КТ3-2), II00(КК3-2) Углы наклона секции, град.: спинной - 0 - +45 тазобедренной 0 +25 Номинальная нагрузка на кровать, кг 80	80	6600 6700 6700
	Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМО 2.В00950.						
	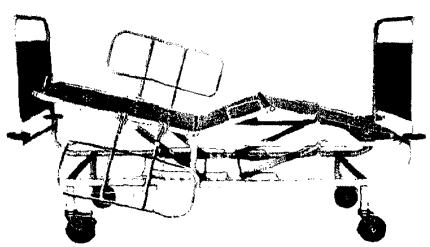 Кровать функциональная детская КФ3-2						

Изготовитель всех кроватей:
ОАО" ДЗМО", п. Досчатое

3. КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 2-Х СЕКЦИОННАЯ СО СЪЕМНЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ (на колесах и без колес) Код ОКП 945213

Кровать предназначена для общего ухода за больными и их реабилитации (КФВП-«ДЗМО» - для взрослых, КФД-01 для детей от 5 до 14 лет)

- Конструкция из стальных профилей с электростатическим лакокрасочным покрытием
- Спинки ламинированные * Колеса ∅ 125 мм с тормозами * Секции ложа съемные
- Разделенная ножная и головная секции * Головная секция регулируется механически

Стандартный комплект:
- корзина под судно

Дополнительное оснащение:
- матрац пенополиуретановый (ватный)
- откидывающиеся боковые ограждения
- устройство для подтягивания

Габариты:	**КФВП-«ДЗМО»**	**КФД-01**
•	Длина – 2280 мм	длина – 1880 мм
•	Ширина – 876 мм	ширина – 776 мм
•	Высота – 1730мм	высота – 1610 мм
•	Высота ложа –	зысота ложа -
•	Угол подъема - 60°	угол подъема - 60°

Цена,руб (по состоянию на 20.II.2002 г.
Кроватей КФВП-"ДЗМО" – 5300(с колесами)
4700 (бе колес)
КФД-01 – 3900(с колесами),3400(без колес)

4. КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ детская (для детей от 1 года до 5 лет)

КФД 2-2 – с заболеваниями нервно-мышечной и сердечно-сосудистой систем
КТ 2-2 – с ортопедическими заболеваниями и травмами
КК 2-2 – с заболеваниями костно-суставным туберкулезом

- Конструкция из стальных профилей с электростатическим лакокрас
- Боковые ограждения фиксируются в трех положениях
- Угловые роликовые бамперы * Колеса ∅ 125 мм с тормозами
- Высота ложа регулируется механически
- Наклон ложа в положение Тренделенбург и анти Тренделенбург

Стандартный комплект:
Корзина для горшка * Упоры для ног (КТ2-2, КК2-2)

Дополнительное оснащение:
- матрац пенополиуретановый (ватный)
- блок прикроватный для вытяжения (КТ2-2, КК2-2)
- кронштейн для удержания верхних конечностей (КТ2-2)
- кронштейн для вытяжения нижних конечностей (КТ 2-2, КК2-2)
- устройство для подтягивания

Габариты:
- Длина – 1360 мм
- Ширина – 775 мм
- Высота – 1200 мм
- Размер подматрацной рамы - 1200мм Х 640 мм
- Высота ложа - 520мм- 790мм
- Угол наклона ложа - 0°- 10°

Цена,руб:
КФД2-2 – 5900
КТ2-2,КК2-2 – 6000

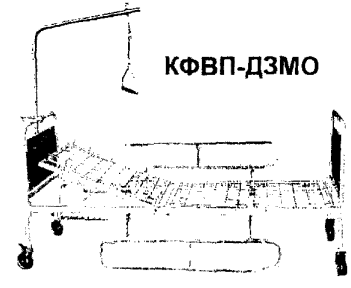
КФВП-ДЗМО


КФД2-2

5. КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 3-х СЕКЦИОННАЯ С КОМПЛЕКТОМ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

КФВ-01

Кровать предназначена для общего ухода за больными

- конструкция из стальных профилей с электростатическим лакокрасочным покрытием
- 3-х секционное ложе * спинки ламинированные
- колеса ∅ 125 мм с тормозами * сетчатые панели на секциях съемные
- головная, тазобедренная и ножная секции регулируются механически

Стандартный комплект: Цена,руб –5600
- корзина под судно

Дополнительное оснащение:
- съемные боковые ограждения
- устройство для подтягивания
- матрац пенополиуретановый (ватный)

Габариты:
* длина – 2280 мм * ширина – 876 мм * высота – 1730 мм
* высота ложа – 450 мм * высота по спинке – 1000 мм
* угол наклона спинной секции – 0°-60°
* угол наклона тазобедреной секции – не менее 20° * угол наклона головной секции не < 20°

5а. КРОВАТЬ БОЛЬНИЧНАЯ КБ-1

Кровать предназначена для общего ухода за больными

- конструкция из стальных профилей с электростатическим лакокрасочным покрытием
- ложе * спинки решетчатые

Дополнительное оснащение:
- матрац пенополиуретановый (ватный)

Габариты:
* длина – 2085 мм * ширина – 803 мм * высота – 1000 мм * высота ложа 450мм

№ п/п	Наименование изделия	Краткое описание	Цена, руб.
6	Подъемник для тяжелобольных с электромеханическим приводом **ПБ-01-«К»-К**	Используется для создания комфортных условий пациенту и облегчения труда обслуж. персонала Габариты 1410 х 700 х 1675. Подъем от 0 до 1 м.	**33 165**
7	Кровать функциональная четырех-секционная с электромеханическим приводом **КФ4-01-«К»-К**	Для размещения больных в отделениях реанимации, травматологии, хирургии, кардиологии и т.д. Ложе 2110 х 850, изм. высоты ложа 450 – 850 мм.	**64 189**
8	Кровать функциональная трех-секционная **КФ3-03-«К»-К**	Спинная секция на газовых пружинах, ножная на фитингах.Спинки метал. (СМФ), без колесных опор	**11 631**
9	Кровать функциональная трех-секционная **КФ3-03-«К»-К**	Спин. секция на газ. пружинах, ножн. на фитингах. Спинки с мебельн. вст. (СМВФ), без колес. опор.	**11 728**
10	Кровать функциональная четырех-секционная **КФ4-02-«К»-К**	Спинки металлические (СМФ), без колесных опор Ложе 2110 х 850, высота ложа от пола 450 мм.	**8 544**
11	Кровать функциональная четырех-секционная **КФ4-02-«К»-К**	Спинки с мебельной вставкой (СМВФ), без колес-ных опор.	**9 325**
12	Кровать функциональная трехсекци-онная **КФ3-02-«К»-К**	Спинки металлические (СМ Ф), без колесных опор.	**7 464**
13	Кровать функциональная трехсекци-онная **КФ3-02-«К»-К**	Спинки с мебельной вставкой (СМВФ), без колесных опор.	**8 539**
14	Кровать функциональная двухсек-ционая **КФ2-02-«К»-К**	Спинки металлические (СМФ), без колесных опор Ложе 2110 х 850, высота ложа от пола 450 мм.	**7 299**
15	Кровать функциональная двухсек-ционая **КФ2-02-«К»-К**	Спинки с мебельной вставкой (СМВ Ф), без колесных опор.	**8218**
16	Матрац трехсекционный **850х2050**	Со съемным чехлом из кожзаменителя	**1 485**
17	Матрац четырехсекционный **850х2050**	Со съемным чехлом из кожзаменителя	**1 518**
18	Кровать **ММ 56.08.01.**	Без колесных опор, спинки металлические (СМ). Ложе 2000 х 750, высота ложа 450 мм.	**3 305**
19	Кровать **ММ 56.08.01.**	Без колесных опор, спинки с мебельной вставкой (СМВ).Ложе 2000 х 750, высота ложа 450 мм.	**3 603**



ПОДЪЕМНИК
для тяжелобольных
с электромеханическим
приводом ПБ-01-"К"-К

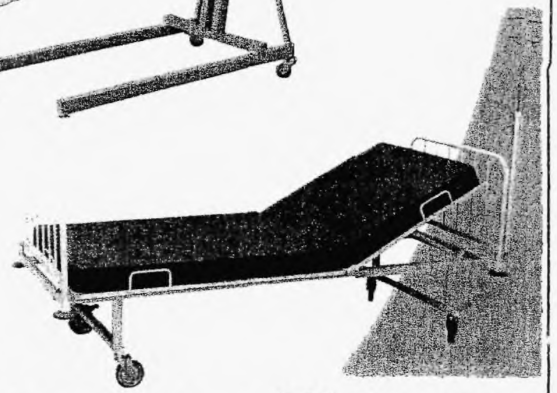

КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КФ2-02"-"К"-К

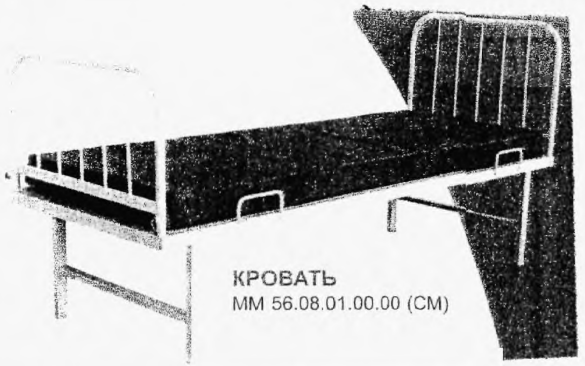

КРОВАТЬ
ММ 56.08.01.00.00 (СМ)

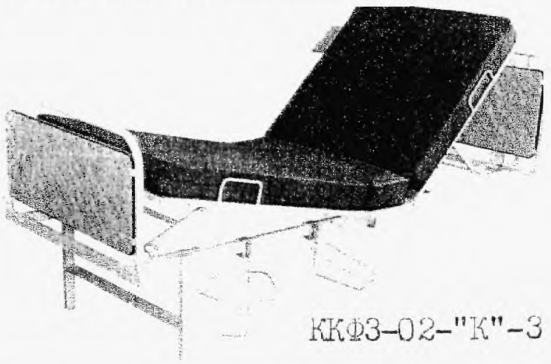

ККФ3-02-"К"-3



КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КФ4-01-"К"-К

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Стол операционный полевой	СОП		ОАО „Завод медицинского оборудования," п.Досчатое	Предназначены для проведения хирургических операций в подразделениях, частях и полевых медицинских учреждениях. Применяются для эксплуатации внутри полевых помещений. Стол состоит из основной рамы с двумя опорами, головной, средней, двух ножных секций с матрацами и съемных приспособлении: кронштейна для навешивания ширмы, ремня для фиксации рук и тела пациента, регулируемыми ногодержателями, столиком для рукл с подушкой,подголовником и подлобником, устанавливаемых на резьбе держателя для сосудов. Регулировка положений секций, подголовника, ногодержателей и др. осуществляется вручную с помощью винтовых зажимов и гребенок. Габаритные размеры, мм: длина-ширина-высота 2090x625x830 длина с подголовником 2385 ширина со столиком для рук 1070 Угол наклона головной панели, град.: вверх 60 вниз 30 Угол наклона основной рамы стола в сторону головы, в крайнем верхнем положении, град. 30 Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на секции, кг, не более: головную- 30, среднюю - 90, ножную(на каждую) - 15	46	9800
2	То же, с укладочным ящиком	СОПУ				80 (в укладочном ящике)	12900
	Сертификат соответствия № РОСС RU ИМО 2.В00951.						
3	Стол операционный универсальный	СОУр - I		ОАО"ПроМеТеЙ", г.Елец	Предназначен для проведения общехирургических,челюстно-лицевых, гинекологических,проктологических,урологических операций - механический привод(ручной)управления положениями панели и секции; - гидравлический ножной привод подъема и опускания панели; - большой выбор приспособлении,в том числе для рентгеноскопии. Конструкция стола обеспечивает его устойчивое положение и удобство работы медперсоналу. Все органы управления расположены со стороны головной секции, что позволяет управлять столом вне пределов операционной зоны.Панель стола изготовлена из алюминиевого сплава покрытого пластиком и состоит из 4-х секции: головной,спинной, тазобедренной, ножной и удлинительной. Головная и ножная секции съемные Изменение положения спинной секции производится вращением рукоятки,расположенной под спинной секцией.Регулировка наклонов панели осуществляется при помощи рукоятки и переключателя		53130
4	То же, с разрезной ножной секцией	СОУр-I					63200

5 **ТЕЛЕЖКА ВНУТРИКОРПУСНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТВК-1 Код ОКП 945152**

- Каркас выполнен из стального листа и профилей с электростатическим лакокрасочным покрытием
- Платформа установлена на 4 колеса ∅ 200 мм, два колеса самоориентирующиеся
- Ограждение поворачивается на 90°, съемное
- Бампер по периметру платформы

Стандартный комплект:

- ограждения; - съемный коврик платформы;
- механизм запора и фиксации ограждения

Габариты:

- Длина – 1120 мм Цена, руб-3500
- Ширина – 650 мм
- Высота – 900 мм
- Высота платформы – 320 мм
- Грузоподъемность – 100 кг

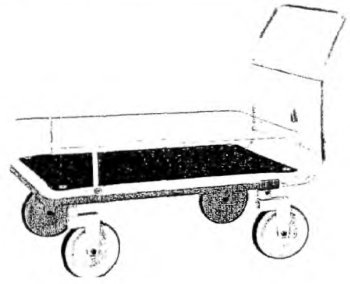

ТВК-I



ТПП



ТУП

6. **ТЕЛЕЖКА ДЛЯ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ ТУП**

- Каркас выполнен из хромированной стальной трубы
- Мешок для сбора мусора со съемным полиэтиленовым пакетом
- Съемный лоток, навесная полка для приспособлений
- 4 колеса ∅ 125 мм, 2 колеса с тормозами
- Угловые боковые бамперы Цена, руб:

Габариты:

- Длина – 920 мм 3600-с комплектацией
- Ширина – 500 мм 3300- без комплектации
- Высота –918 мм

7. **ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПИЩИ ТПП-1**

- Каркас выполнен из хромированной стальной трубы
- 4 колеса ∅ 125мм, 2 колеса с тормозами
- Две полки изготовлены из нержавеющей стали
- Угловые боковые бамперы

Габариты:

- Длина – 1026 мм
- Ширина – 680 мм Цена, руб - 6390
- Высота – 905 мм
- Грузоподъемность – 100 кг

Изготовитель всех тележек:
ОАО"ДЗМО",.Н.п. Досчатое

8. **ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ ВНУТРИКОРПУСНАЯ ТПБВ-01(Д)**

- Рама выполнена из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием
- 2-х секционное матрацное основание (пенополиуретан, обшитый искусственной кожей)
- Регулировка головной секции механическая * Угловые боковые бамперы
- Откидывающиеся боковые ограждения * Колеса ∅ 125 мм с тормозами

Габариты:

- длина – 2030 мм * ширина – 675 мм * высота – 1000 мм Цена, руб--3900
- угол наклона головной секции 0° - 35°

9. **ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ СО СЪЕМНОЙ ПАНЕЛЬЮ ТБС-01**

- Рама выполнена из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием
- Съемные носилки стальные 2-х секционные на опорах
- Регулировка головной секции механическая * Колеса ∅ 125 мм, 2 колеса с тормозами

Дополнительное оснащение:

- Матрац (пенополиуретан, обшитый искусственной кожей) Цена, руб- 4400

Габариты:

- длина – 2100 мм * ширина – 605 мм * высота – 800 мм
- угол наклона головной секции 0° - 45°



ТПБВ-01-Д

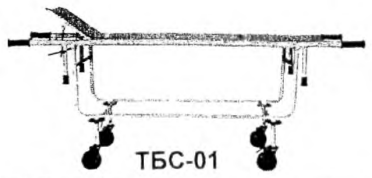

ТБС-01

10. ТЕЛЕЖКА больничная с подголовником ТБ-01

Масса,кг:45, грузоподъемность,кг:160,габариты,мм:1860х560х805.

Угол наклона зафиксированного подголовника от15 до 45°

Цена,руб: 3780

11. ТЕЛЕЖКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНАЯ ТБП-2

Масса,кг":85,нагрузка на панели тележки,кг не менее:160

Высота подъема нагруженной тележки за один ход педали,мм-6

Габариты,мм:1886х555х943 Цена,руб:ТБП-2:182006ТБП-03:21000

12. Тележка паталогоанатомическая типа ТАП-2. Цена,руб:14680

Иготовитель (поз.10-12):ЗАО"ПроМеТеИ",г.Елец



ТЕЛЕЖКА
для перевозки
пациентов
со съемной панелью
ТПСП-01-"К"-К

13	Тележка для перевозки пациентов со съемной панелью ТПСП-01-«К»-К	Габариты 2200х700х800, масса с носилками 40кг; ложе носилок 1800х550, масса носилок – 12кг.	5 869
14	Тележка для перевозки пациентов со съемной панелью ТПСП-01-2-«К»-К	См. ТПСП-01-«К»-К, носилки с регулируемым по высоте подголовником	6 634
15	Тележка для перевозки пациентов двухсекционная ТПБ2-01-«К»-К	С изменяемой высотой, боковыми ограждениями, угол наклона спинной секции 30,45, 60 градусов	12 650

16 Тележка для перевозки больных предназначена для транспортировки больных из машин скорой медицинской помощи в стационар, а также для транспортировки из палаты в операционный блок и т.п. Комплектуется съемной панелью, на которой размещается непосредственно больной. Конструкция тележки сварная из стальных труб. Имеется резиновый отбойник. Покрытие – порошковое напыление или лакокрасочное.

Габаритные размеры, мм 1500х625х800

Панель съемная предназначена для размещения больных. Устанавливается на тележку для перевозки больных. Конструкция сварная из труб алюминиевого сплава. Ложе из листа алюминиевого сплава. Возможно изготовление панели и ложа из стали с порошковым или лакокрасочным покрытием.

Габаритные размеры, мм 2100х540х250

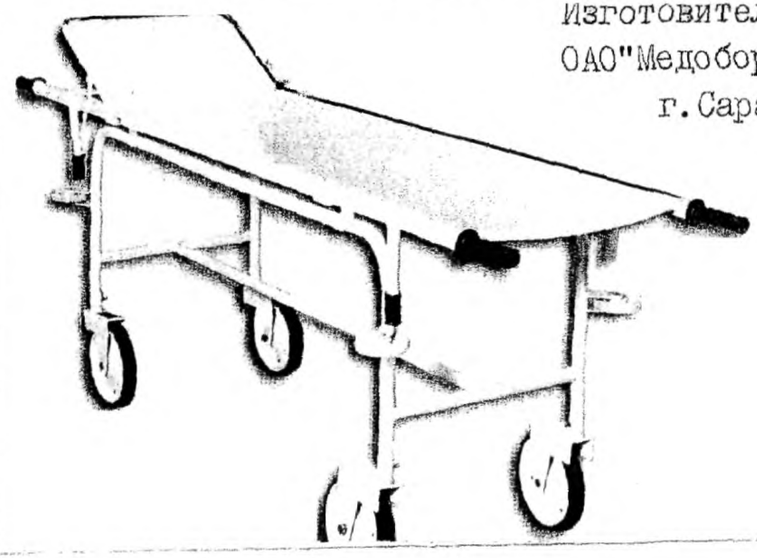

Изготовитель:
ОАО"Медоборудование
г.Саранск



ТЕЛЕЖКА
ТПБ2-01-К"-К

Изготовитель:
ЗАО"ПКЦ"КЕТГУТ",
г.Краснодар

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб на 22.09.03
1	2	3	4	5	6	7	8
I7	Стол перевязочный	СП 0I-"К"-К		ЗАО"ПКЦ "КЕТГУТ", г.Краснодар	Цельнометаллический на колесных опорах Габариты,мм: 2000 х 600 х 840		3074
I8	Стойка приборная	СПЗ-0I-"К"-К			Три полки ан четырех колесных опорах, две из которых оснащены тормрзами.		I892
I9	Столик процедурный	СПП-2		ОАО"ПроМеТеИ" г.Елец			3260
20	**Столик инструментальный**	СИ-5		ОАО"ДЗМО", р.п.Досчатое	**Предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов в перевязочных и операционных.** **Габаритные размеры, мм** 7I0x5I5x870 **Габаритные размеры верхней панели, мм** 580x400	I6	2300
2I	Столик инструментальный	ММ 56.I2.00		ЗАО"ПКЦ "КЕТГУТ", г.Краснодар	На колесах, две полки из металла.Габариты,мм:600 х 450 х 720		I85I
22		ММ 56.I2.0I			На колесах,две полки,верхняя полка из нержавеющей стали,выдвижной ящик. Габариты,мм: 850x500x800		8779
23	**Столик манипуляционный**	СМ-3		ОАО"ДЗМО", п.Досчатое	**Предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений и т.п., а также для доставки их в палаты в пределах больничного корпуса.** **Габаритные размеры столика, мм** 775x5I5x955 **Габаритные размеры верхней панели, мм** 600x400	27	2850
24	Столик	СВВ		ОАО"ПроМеТеИ", г.Елец	Для внутривенных вливаний		590
25	Стол перевязочный	ПН	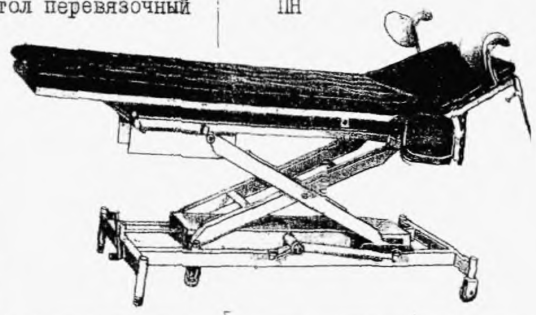		**Предназначен для** проведения перевязок и несложных хирургических операций.Привод подъема панели гидравлический ножной **Конструкция:** Основание, механизм подъема-опускания с гироприводом,рама с двухсекционной панелью головной и спинной. В основание ,установленное на два колеса и две опоры,вмонтирован механизм подъема опускания панели и егг гидропривод. Механизм подъема-опускания представляет собой устройство,состоящее из двух пар рычагов,соединенных крестообразно. Между колесамиймеется самоориентирующееся колесо,которое поднимается и опускается с помощью подпружиненного эксцентрика. Угол наклона секции,град:головной-15,спинной-20. Габариты:2062x600x530-930	I30 (В комплекте с приспособлениями)	20920

26. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ УЛВ-1

Устройство предназначено для лечения расстройств мозгового кровообращения,вызванных дегенеративно-дисирофическими и другими изменениями в шейном отделе позвоночника(остеохондроз,аномалии и др.)

Габариты:

- длина – 900 мм
- ширина (по креслу) – 440 мм
- высота –1255-1910 мм
- масса без кресла и грузов- не более 8 кг
- масса кресла – не более 12 кг
- масса одного груза – 0,5+-0,05 кг

Допускаемая нагрузка на кресло:

- на сиденье,массой – 80 кг
- на спинку, усилием – 300 Н

Угол (вектор) тяги, обеспечиваемый перемещением ползуна, можно изменять в пределах – от –15° до +30°
Перемещение шкалы траверсы в передне-заднем направлении – не менее 250 мм
Вертикальное выдвижение стойки с траверсой – 655 мм
Усилие фиксирования регулируемых частей – не более 100(10) Н(км)



27. УСТАНОВКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЫТЯЖЕНИЕМ ПЕРЕЛОМА ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ УВК

- Конструкция выполнена из стальной хромированной трубы
- вертикальные штанги * *горизонтальная штанга*
- кронштейны для протягивания шнура Цена, руб - 3400

Стандартный комплект:

- гамачки
- палочки для гамачков
- подстопники
- шнур
- распорка
- распорка малая

Габариты:

длина – 2400 мм * высота – 1500 мм



28. КРЕСЛО ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КВ-2

- Каркас выполнен из профильной стали с электростатическим лакокрасочным покрытием
- Ручной привод

Стандартный комплект:

- стойка с барабаном и тормозным механизмом
- каркас с сиденьем и подлокотниками
- ограждение, подножка
- стержень с ручкой
- толкатель с кнопкой

Кресло вращающееся КВ-2 предназначено для исследования функций вестибулярного аппарата человека. Применяется в медицинских учреждениях для эксплуатации внутри помещения.

ГАБАРИТЫ :

- длина - 600 мм * ширина – 550 мм * высота – 1600 мм
- высота сиденья от пола 500 мм
- номинальная нагрузка на сиденье 120 кг Цена, руб - 4800
- масса. мах. 43 кг



Кресло КВ-2

29. КРЕСЛО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ КО-I

Предназначено для проведения обследований и операций у взрослых и детей.
Грузоподъемность,кг- I20,масса,кг - I32
Габариты,мм: 840 x I800 x 680 Цена,руб - 2I520
Изготовитель(поз.):ОАО"ДЗМО",п.Досчатое

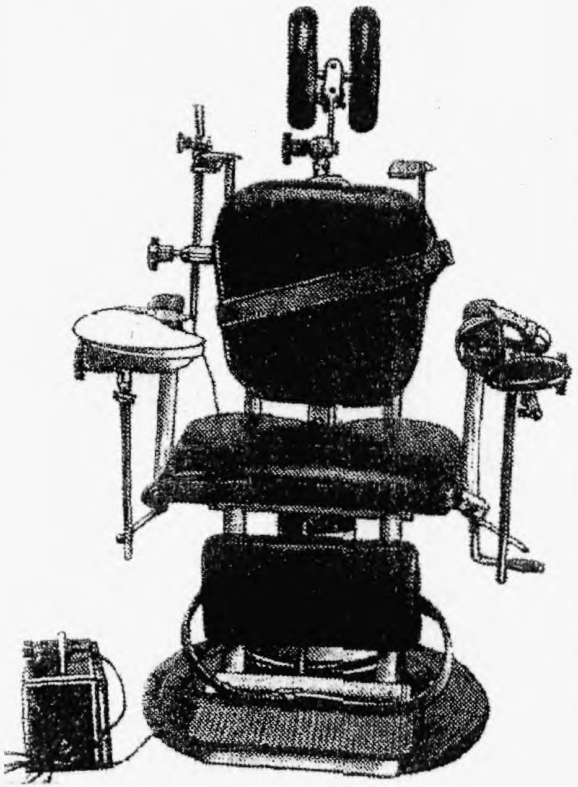

Кресло КО-I
Изготовитель:
ЗАО"ПроМеТеИ",г.Елец

11.1.3. Мебель общебольничная.

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб на 01.02.03
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Шкаф на пост дежурной медсестры (без сейфа)	МОН432.01 ОН-7-1289/1		ОАО "ГИПРОНИИ ЗДРАВ", г.Москва	 Габаритные размеры-872х420х1834 мм		5252
2.	То же	МОН432.01-01 ОН-7-1289/1а		то же	 Габаритные размеры -872х420х1834 мм		5404
3.		МОН432.02		"	 МОН432.02 ОН-7-1289/2  МОН432.02-01 ОН-7-1289/2а Габаритные размеры - 562х420х1834 мм		3025
4.		МОН432.02 01					3179
5.	Шкафы для кабинета врача	МОН432.04		"	МОН432.04 ОН-7-1289/4  МОН432.04-01 ОН-7-1289/4б  Габаритные размеры - 872 х 420 х 1834		5018
6.		МОН432.04 01					5166
7.	Шкаф для кабинета врача (одежда)	МОН432.05		"	МОН432.05 ОН-7-1289/5  МОН432.06 ОН-7-1289/6  МОН432.06-01 ОН-7-1289/6а  Габаритные размеры - 562 х 420 х 1834		2381
8.	То же (полки)	МОН432.06					2651
9.		МОН432.06-01					2840

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб на 01.02.03
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Стол врача двухтумбовый	МОН432.07		САО "ГИПРОНИИЗДРАВ", г.Москва	МОН432.07 ОН-7-1289/7  Габаритные размеры - 1500 х 704 х 750 мм		3166
11.	Стол медицинской сестры	МОН432.09		то же	 Габаритные размеры - 1300х704х750 мм		2470
12.	Тумба прикроватная	МОН432.13		"	МОН432.13 ОН-7-1289/11 МОН432.14 ОН-7-1289/11а  Габаритные размеры - 464 х 470 х 814 мм		1353
13.		МОН432.14					1353
14.	Кушетка смотровая на металлическом каркасе	МОН432.15 ОН-7-1289/12		"	 Габаритные размеры - 1930х600х		2840
15.	Шкаф медицинский	ШМмс2		ОАО"НИПОМ", г.Дзержинск	Конструкция: двухстворчатый, сварной металлический каркас; боковые стенки, створки дверей и полки из стекла; шкаф-контейнер-цельнометаллический с врезным замком; металлические ножки шкафа снаожены регулирующим механизмом Габариты, мм: высота ширина х глубина: 1590 х 800 х 400 Габариты сейфа, мм: 200 х 350 х 280 	90 (не более) 7 (сейфа)	3850
16.	То же, с 1 сейфом	ШМмс2-1					4620
17.	То же, с 2 сейфами	ШМмс2-2					5540
18.	Банкетка медицинская	МОН432.17		ОАО"ГИПРОНИИЗДРАВ", г.Москва	 МОН432.17 ОН-7-1289/13 Габариты, мм: 1440х 515х 740		2233
19.	Банкетка (сидение мягкое)	ММ 56.08.06		ЗАО"КЕТГУТ", г.Краснодар	 БАНКЕТКА ММ 56.08.06.00.00 Габариты, мм: 400 х 460х 410		480
20.	Стол обеденный	ММ 56.08.04			Каркас металлический, спецпокрытие Габариты, мм: 800 х 700 х 750		1452
21.	Стул	ММ 56.08.05			Каркас выполнен из стального профиля, основание и спинка полумягкие. Высота - 850, ширина-380, глубина сидения- 380 мм 		464

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Цена, руб на 01.02.03
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Шкаф для медикаментов и инструментария	МОН432.03		ОАО "ГИПРОНИИЗДРАВ", г.Москва	МОН432.03 ОН-7-I289/3 МОН432.03-01 ОН-7-I289/3а  Габаритные размеры - 872 х 420 х I834		5476
23.		МОН432.03-01					5870
24.	Стол для кабинета врача с подкатной тумбой	МОН43Х.07		то же	 Габаритные размеры мм: стола: I100x620x720 тумбы: 420x620x574		3222
25.	Стол палатный	МОН432.II			МОН432.II ОН-7-I289/9 МОН432.I2 445.02  Габаритные размеры: I058x704x755 704x704x755 838x600x760		I436
26.		МОН432.I2					I250
27.		445.02					I740
28.	Шкаф для инструментов (с сейфом)			САО"Завод медицинской аппаратуры, г.Казань	Габаритн.,мм: 1940х 550 х 454	I2 (не более)	3675 (с НДС)
29.	Стол для медикаментов				Нержавеющая сталь. Габаритн.,мм: 800 х 500 х 400	6	5090
30.					Полимерное покрытие. Габаритн.,мм: 800 х 500 х 400	6	I625
31.	Стол-подставка для аппарата УВЧ	447.05		ОАО"Гипрониизздрав", г.Москва	 Габаритные размеры - 570x4I6x7I3		I475
32.	Кушетка для ЭКГ	447.I0			447.I0  Габаритные размеры,мм: 2000 х7560 х 550		3307

33	Шкаф для медикаментов	ШМ-01-«К»-К	Цельнометаллический, четыре полки, с замком, двухдверный .Габариты 840 х 420 х 1800	5 329
34	Шкаф для медикаментов	ШМ-01-2-«К»-К	Цельнометаллический,встроенный сейф, с замком, двухдверный .Габариты 840 х 420 х 1800	5 682
35	Шкаф для одежды	ММ56.20.00.	Цельнометаллический , двухсекционный, двух-дверный (1800 х 1000 х 500).	6 431
36	Шкаф для белья	ММ56.21.00.	Цельнометаллический , односекционный, одно-дверный (18000 х 500 х 500).	4 269
37	Шкаф для одежды	ММ56.21.01.	Цельнометаллический , односекционный, одно-дверный (18000 х 500 х 500).	4 269
38	Шкаф для уборочного инвентаря	ММ56.21.02.	Цельнометаллический , односекционный, одно-дверный (1800 х 500 х 500).	3 745
39	Тумба прикроватная	**ММ 56.08.02.**	Цельнометаллическая, две полки, 400 х 400 х 860	2 729
40	Стол прикроватный	**ММ 56.08.03.**	С изменяемой высотой, на колесах. 750 х 380, изм. высоты 800 – 1200 мм.	1 617

ТУМБА ПРИКРОВАТНАЯ
ММ 56.08.02.00.00

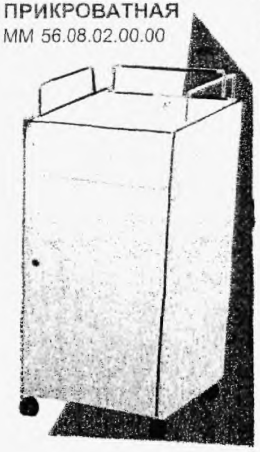

Изготовитель (поз. 33-40)
ЗАО"НТЦ"КЕТГУТ",
г. Краснодар



41. КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ МАССАЖНАЯ КММ-1 Код ОКП 945219

- Рама выполнена из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием
- 2-х секционное матрацное основание (пенополиуретан, обшитый искусственной кожей)
- Регулировка головной секции механическая
- Оснащается поворотной подножкой

Габариты:

- длина – 1900 мм
- ширина – 870 мм
- высота – 760 мм
- угол наклона головной секции 0° - 35°

Цена, руб: 2000

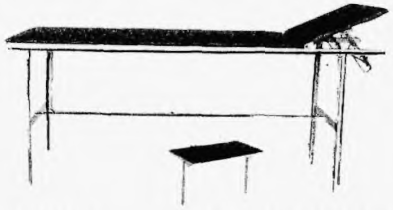

42. КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ КМС-1 Код ОКП 945219

- Рама выполнена из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием
- 2-х секционное матрацное основание (пенополиуретан, обшитый искусственной кожей)
- Регулировка головной секции механическая

Цена, руб – 1800.

Габариты:

- длина – 1900 мм
- высота – 550 мм
- ширина – 622 мм
- угол наклона головной секции 0° - 35°

43. СТОЛИК НАДКРОВАТНЫЙ СН-03 Код ОКП 945216

- Основание выполнено из стального профиля с электростатическим лакокрасочным покрытием
- Механизм подъема выполнен из хромированных труб
- Поворотная панель изготовлена из ламинированной фанеры
- Высота и уклон панели регулируется механически
- Колеса ∅ 60 мм, 2 колеса самоориентирующиеся с тормозами

Цена, руб – 1900

Габариты:

- Длина – 900 мм
- Ширина – 410 мм
- Высота регулируемая – 790 мм – 1140 мм

44. ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ ШМ-1

- Каркас выполнен из стали
- Стеклянные полки с возможностью регулировки высоты
- Регулируемые металлические ножки
- Дверцы снабжены замками

ГАБАРИТЫ:

- высота 1650 мм
- ширина - 450 мм
- масса . max. 60 кг
- глубина 440 мм

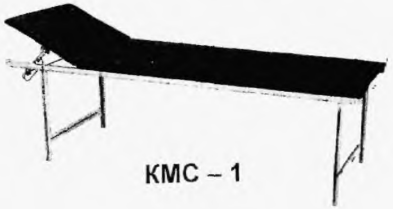

Изготовители:
КМС-I, КММ-I: ОАО"ДЗМО", п. Досчатое и
ОАО"Медоборудование", г. Саранск
СН-03, ШМ-I:
ОАО"ДЗМО", п. Досчатое

II.2. Шкафы медицинские для поликлиник ШМП-446

Шкафы для статистических талонов (металлические ножки)  446.02 - 838x437x820 446.01 - 838x437xI000 Цена, руб-10889	Шкафы для статистических талонов  446.02 - 838x437x820 446.03 - 838x437xI000 Цена, руб-I0755	Шкафы для карт диспансерного учета  446.05 - 838x437x820 446.04 - 838x437x1000 10433	Шкафы для карт диспансерного учета  446.05 - 838x437x820 446.06 - 838x437x1000 I0279	Шкафы для флюорографических карт  446.06 - 838x437x820 446.07 - 838x437xI000 9373
Шкафы для флюорографических карт  Цена, руб-92I6 446.08 - 838x437x820 446.09 - 838x437xI000	Шкафы для отчетной документации  8I26 446.II - 838x437x820 446.I0 - 838x437xI000	Шкафы для отчетной документации  Цена, руб -7996 446.II - 838x437x820 446.I2 - 838x437xI000	Шкафы для талонов к врачу  Цена, руб-I33I2 446.I4 - 838x437x820 446.I3 - 838x437xI000	Шкафы для талонов к врачу  Цена, руб - I3I60 446.I4 - 838x437x820 446.I5 - 838x437xI000
Шкафы для карт ЭКГ  Цена, руб-II953 446.I7 - 838x437x820 446.I6 - 838x437xI000	Шкафы для карт ЭКГ  Цена, руб - II799 446.I7 - 838x437x820 446.I8 - 838x437xI000	Шкаф санитарок  Цена, руб-4543 446.22 - 838x437xI820	Шкафы для индивидуальных простыней  Цена, руб-6504 446.20 - 838x437x820 446.I9 - 838x437xI900	Шкафы для индивидуальных простыней  Цена, руб-6350 446.20 x 838x437x820 446.2I - 838x437xI000

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ОАО "ТИПРОНИИЗДРАВ", г. Москва

Примечание: Цена, руб дана по состоянию на 01.02.2003 года

II.3. Встроенные шкафы для больниц и поликлиник ВШ-437

Шкаф медицинский



Цена, руб-5468

437.08 – 836x437xI834

Шкаф для медицинских инструментов



Цена, руб-5078

437.09 – 836x437xI834

Шкаф для кабинета врача



Цена, руб-4545

437.10 – 836x437xI834

Шкаф для одежды



437.II – 836x437xI834

Цена, руб- 3785

Шкаф для одежды



437.I2 – 562x437xI834

Цена, руб- 2381

Шкаф палатный



437.I3 – 442x437xI834

Цена, руб- 2161

Шкаф палатный (одежды)



437.I4 – 562x437xI834

Шкаф-витрина



437.I5 – 836x437xI834

Шкаф для хозяйственного инвентаря)



437.I6 – 836x437xI834

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО "ГИПРОНИИЗДРАВ" г.Москва

II.4. Шкафы медицинские ШМ-440

Шкаф для готовых питательных сред



440.0I, 0Х-4-I307/I-I
886x443xI870

Цена, руб-5005

Шкаф материальный



440.02, 0Х-4-I307/I-2
886x443xI870

Цена, руб- 4607

Шкаф для белья



440.03, 0Х-4-I307/I-3
886x443xI870

Цена, руб- 4385

Шкаф для лабораторной посуды



440.04, 0Х-4-I307/I-4
886x443xI870

Цена, руб-46I6

Шкаф для одежды



440.05, 0Х-4-I307/I-5
886x436x1906

Цена, руб- 4051

Шкаф для одежды



440.06, 0Х-4-I307/I-6
886x438xI906

Цена, руб- 3486

Шкаф для кабинета врача



440.07 0Х-4-I307/I-7
886x438xI906

Цена, руб-4542

II.5. Мебель для стоматологических отделений и зуботехнических лабораторий С03Л-412

Стол с вытяжным устройством для амальгам

4I2.I3 0Н-7-941/13



I300x565xI800

Цена, руб-25726

Шкаф для хранения истории болезни

4I2.I4 0Н-7-94I/14



I300x600x2250

Цена, руб- 5207

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ – ОАО "ГИПРОНИИЗДРАВ" г.Москва

Шкаф ручниста
426.01, ОН-7-1306/1



786x438x1910 Цена,руб-10358

Стол угловой
426.13, ОН-7-1306/13



900x390x1736 Цена,руб-6079

Шкаф ручниста 426.02, ОН-7-1306/2

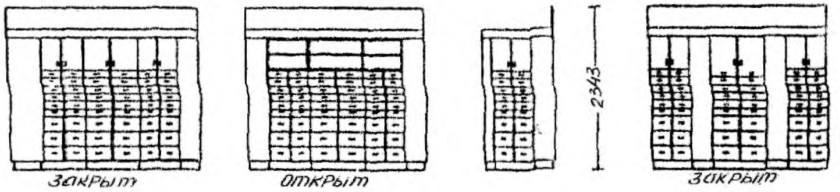

2530x1040x1910
Цена,руб- 34810

Наименование	Проект	Цена,руб
Стол - прилавок	426.08	6716
Стол журнальный	426.10	1412
Банкетка	426.11	1249
Цветочница	426.12	2665
Стол угловой	426.13	6079

Изготовитель мебели аптечной и для кабинетов физиотерапии:
ОАО"ГИПРОНИИЗДРАВ ,г.Москва

Стол рецептара-ручниста 426.06, ОН-7-1306/6

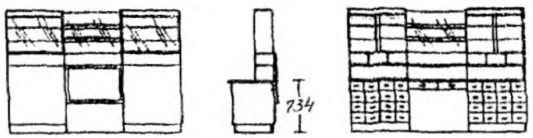

2514x657x1736 Цена,руб - 27859

Кушетка гимнастическая
413.08, ОН-7-983/8



2000x650x600
Цена,руб - 3017

Кушетка массажная
413.14, ОН-7-983/14



2000x650x800
Цена,руб - 3025

Стол для портативных физиотерапевтических аппаратов
413.22, ОН-7-983/22



660x350x650
Цена,руб - 2272

Кушетка смотровая на деревянном каркасе
404.12



2000x650x500
Цена,руб -" 2422

1. Ширма одно,-трех секционная с полимерными полотнищами ШП 1/3 Код ОКП 945210
-два колеса Ø 60 мм и опора или 3 опоры;
- количество секций-по желанию заказчика.
Габариты,мм:665x1810
Цена,руб-(за секцию): 600-на колесах,550-без.



2. Штатив (для длительных инфузионных вливаний типа ШВ
Имеет два держателя для флакона с жидкостью,два крючка для подвески флаконов
Габариты,мм: высота-1350-2200,цена,руб-450
Изготовитель;ОАО"ДЗМО",р.п.Досчатое

3. Ширма (1 секция)
Материал: эмалированное покрытие,щелк
Габариты,мм: высота х ширина 900 X 1600
Масса,кг - 2,6; цена,руб - 1190

4. Штатив передвижной типа ШДВ-1 (телескопический)
Выдерживает груз - 5 кг
Габариты,мм:616 x 2100 (не более)
Масса не более 3,7 кг
Цена,руб- 1000

5. Штатив типа ШДВ-2в
Выдерживает груз массой 5 кг
Габаритные размеры,мм: 600 x 1800 (не более)
Цена, руб - 310
Изготовитель(поз 3-5):
ОАО"Завод медицинской аппаратуры",г.Казань

6. Ширмы и перегородки

Изящные функциональные перегородки из алюминиевого профиля позволят выделить рабочие зоны различного назначения (смотровые, раздевалки, регистратуру, кабинеты и т.д.)



Изготовитель:ЗАО"ПОРСА",г.Санк-Петербург

11.8. . Набор мебели для клинико-диагностических лабораторий КДЛ-423.

Стол лабораторный химический пристенный КДЛ 423.01, ОН-7-1136/1  1200x850x1650 Цена,руб-	Стол лабораторный химический пристенный КДЛ 423.02, ОН-7-1136/2  3000x850x1650	Стол лабораторный химический островной КДЛ 423.03, ОН-7-1136/3  1200x1450x1650	Стол лабораторный химический островной КДЛ 423.04, ОН-7-1136/4  3000x1450x1650		Стол лабораторный физический КДЛ 423.06, ОН-7-1136/6  1200x700x1650
Стол лабораторный физический КДЛ 423.07, ОН-7-1136/7  1800x700x1650 Цена,руб -	Стол для взятия крови КДЛ 423.08, ОН-7-1136/8  1200x600x760 Цена,руо- 2831	Стол для микроскопирования КДЛ 423.09, ОН-7-1136/9  1200x700x760 Цена,руб- 3171	Стол для аналитических весов КДЛ 423.10, ОН-7-1136/10  1800x600x760 Цена,руб - 3849	Стол подкатной КДЛ 423.11 ОН-7-1136/11  974x600x760 Цена,руб - 2564	Стол подкатной КДЛ 423.11-01 ОН-7-1136/20  974x600x760 Цена,руо- 2630
Стол с вытяжным устройством (малый) КДЛ 423.12, ОН-7-1136/12  Цена,руб- 1200x840x2428	Стол с вытяжным устройством (оольшой) КДЛ 423.13, ОН-7-1136/13  Цена,руб- 38741 1800x840x2430	Шкаф для приборов КДЛ 423.14 ОН-7-1136/14  Цена,руб- 4675 886x443x1870	Шкаф для химических реактивов КДЛ 423.15 ОН-7-1136/15  Цена,руб- 5094 886x458x1800	Стол для врача КДЛ 423.19 ОН-7-1136/21  Цена,руб - 2605 1200x600x760	Стол для лаборанта КДЛ 423.19-01 ОН-7-1136/22  Цена,руб - 2816 1200x600x760
Тумба подсобная КДЛ 423.20 ОН-7-1136/23  1200x600x760 Цена,руб- 1756	Стол для работы студентов КДЛ 423.21 ОН-7-1136/24  1200x600x740 Цена,руб- 1747	Стол подсобный КДЛ 423.22 ОН-7-1136/25  900x700x750 Цена,руб- 1517	Примечания : 1. Изготавливается по заказам по 100% предоплате. 2. Цвет мебели оговаривается при заказе (белый- ламинат,пластик, светлое дерево- ламинат,пластик,черный,серый - ламинат) 3. Мебель НДС не облагается. 4. Возможно изменение размеров изделия по желанию заказчика. ОАО"ГИПРОНИИЗДРАВ",г.Москва (изготовитель мебели) Цены даны по состоянию на 01.02.2003 года		

11.9. Набор мебели для клинико-диагностических лабораторий КДЛ-455.

Стол лабораторный для химических исследований
КДЛ 455.01



732x800x1724
Цена,руь - 10651

Стол лабораторный для химических исследовании
КДЛ 455.02



1200x800x1724
Цена,руб- 13053

Стол лабораторный для химических исследовании
КДЛ 455.03



1550x800x1724
Цена,руб - 14960

Стол лабораторный для физических исследовании
КДЛ 455.04



732x800x1724
Цена,руб-8524

Стол лабораторный для физических исследовании
КДЛ 455.05



1200x800x1724
Цена,руб- 9930

Стол для окраски препаратов
КДЛ 455.08



732x800x1724
Цена,руб- 10621

Стол лабораторный островной для химических исследований
КДЛ 455.09



732x1400x1724
Цена,руб- 13321

Стол лабораторный островной для химических исследовании
КДЛ 455.10



1200x1400x1724
Цена,руб- 16809

Стол лабораторный островной для химических исследовании
КДЛ 455.11



1550x1400x1724
Цена,руб - 1884

Стол лабораторный островной для химических исследований
КДЛ 455.11-01

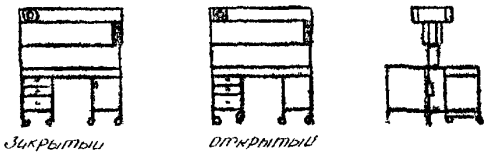

1550x1400x1724
Цена,руб - 16184

Стол для микроскопирования
КДЛ 455.12



1550x700x750
Цена,руб- 4165

Стол для разлива и укупорки питательных сред
КДЛ 455.13



1200x600x850
Цена,руб- 4783

Стол для весов
КДЛ 455.14



732x650x750
Цена,руб- 2503

Стол приставной
КДЛ 455.17



1200x600x850
Цена,руб- 2985

Стол приставной
КДЛ 455.18



1550x600x850
Цена,руб- 3168

Стол лаборанта
КДЛ 455.17-01



1200x600x750
Цена,руь - 2503

Стол лаборанта
КДЛ 455.18-01



1550x600x750
Цена,руо - 3038

Стол передвижной
КДЛ 455.19



732x600x750
Цена,руб - 2377

ЗАВОД - ИЗГОТОВИТЕЛЬ -ОАО "ГИПРОНИИЗДРАВ" г.Москва

Стол лабораторный для физических исследований
КДЛ 455.06
Цена,руб - 13087



1550x800x1724

Стол лабораторный с раковиной
КДЛ 455.07
Цена,руб- 9987



732x800x1724

Стол лабораторный островной для физических исследований
КДЛ 455.09-01
Цена,руб - 10823



732x1400x1724

Стол лабораторный островной для физических исследований
КДЛ 455.10-01
Цена,руб- 13269



1200x1400x1724

Стол для приема и регистрации анализов
КДЛ 455.15
Цена,руб- 7733



1200x600x1483

Стол приставной
КДЛ 455.16



732x600x850
Цена,руб- 2123

Стол передвижной двусторонний
КДЛ 455.20



1200x600x750
Цена,руб- 4440

Стол подсобный
КДЛ 455.21



1550x600x850
Цена,руб- 3321

Стол для монтажных работ
КДЛ 455.22



1200x650x750
Цена,руб- 2998

Стол с вытяжным устройством (малый)
КДЛ 455.23



1200x850x2000; Цена,руб-31965

Стол с вытяжным устройством (большой)
КДЛ 455.24

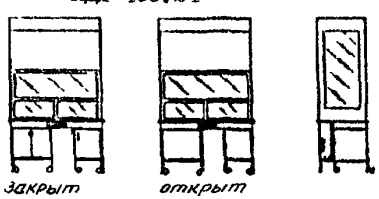

1550x850x 2500 Цена,руб- 35918

Шкаф для одежды
КДЛ 455.25



Цена,руб- 4043
886x437x1816

Шкаф для лабораторной посуды
КДЛ 455.26



Цена,руб- 6005
886x437x1816

Шкаф для химических реактивов
КДЛ 455.27



Цена,руб- 5590
886x437x1816

Наименование	Проект	Цена, руб
Тумба подкатная	455.33	1618
	455.34	1287
	455.35	1287
Стол тировальный	458.01	14155

Шкаф для диагностических препаратов
КДЛ 455.29



Цена,руб- 5994
886x437x1816

Шкаф материальный
КДЛ 455.30



Цена,руб- 6434
886x437x1816

Шкаф для архивной документации
КДЛ 455.31



Цена,руб - 5859
886x437x1816

Шкаф для документации и справочной литературы
КДЛ 455.32



Цена,руб - 5412
886x437x1816

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ - ОАО "ГИПРОНИИЗДРАВ" г.Москва

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Аквадистилятор электрический	**ДЭ-4-3-СЗМО** 94 5240	**ТУ 9452-003-07614018-2002**	ОАО "Медоборудование", г.Саранск	Предназначен для получения дистиллированной воды в аптеках, больницах, лабораториях и в других учреждениях всех отраслей народного хозяйства, где имеется потребность в дистиллированной воде. Производительность, л/ч 4 Питание – от сети переменного однофазного тока частотой 50 Гц Напряжение, В 220 Потребляемая мощность, кВт 3 Габаритные размеры, мм 320х300х610	18	Цена– **7250 руб.**
		***Сертификат соответствия № РОСС RU. ИМ04.Н03441** действует до 05 08 2005г*					
2.	Аквадистилляторы	ДЭ-10; ДЭ-25	ТУ9452-008. 07614018-98	то же	**Аквадистилляторы** производят дистиллированную, очищенную воду в соответствии с Фармокопеей ст.42-2619-89 ГФ XI. Аквадистилляторы могут производить как холодную так и горячую (+80°С) очищенную воду, что особенно необходимо для приготовления высоко насыщенных растворов. Аквадистилляторы легко объединяются с водосборниками в единую систему: когда уровень воды в водосборнике достигает верхней отметки, дистиллятор автоматически выключается. Аквадистилляторы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха +10°С ... +35°С, относительной влажности 80% при 25°С. Производительность, л/ч : ДЭ – 10 10 ДЭ – 25 25 Время разогрева, мин. : ДЭ – 10 30 ДЭ – 25 35 Энергопотребление, кВА : ДЭ – 10 9 ДЭ – 25 20 Напряжение, В : ДЭ – 10 220 ДЭ – 25 380 Габаритные размеры, мм: ДЭ – 10 845х622х275 ДЭ – 25 1163х736х385	35 50	
		***Сертификат соответствия № РОСС RU. ИМ04.Н03417** действует до 18.07.2003г*					

Наименование	Цена, руб.
Аквадистилятор ДЭ-10-СЗМО	**10 500**
Аквадистилятор ДЭ-10-СЗМО с дополнительным холодильником	**11 300**
Аквадистилятор ДЭ-25-СЗМО	**13 500**
Аквадистилятор ДЭ-25-СЗМО с дополнительным холодильником	**14 600**

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Производительность, л/ч	Потребляемая мощность, кВт	Расход охлаждающей воды, л/ч	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6а	6б	6в	6г	7	8
3.	Дистилляторы электрические	ДЭ		ОАС "Завод "Комсомолец", г. Тамбов	Предназначены для получения дистиллированной воды из питьевой в соответствии с ГОСТ 6709-72. В качестве исходной воды допускается применение артезианской, речной, озерной. Изготавливаются из стали коррозионностойкой 12Х18Н10Т.					Цена, руб., с НДС –
		ДЭ20-1К-01;			**20**	**15**	280	**Ø 230 x 500**	**15,5**	**33600**
		ДЭ40-1К-01;			**40**	**20**	320	**Ø 304 x 670**	**28,5**	**42000**
		ДЭ70-1К-01;			**70**	**40**	550	**Ø 422 x 845**	**56**	**54000**
		ДЭ130-1К-01			**130**	**70**	900	**Ø 545 x 1025**	**86**	**67800**
4.	Дистилляторы паровые	ПД		то же	Назначение то же, что для дистилляторов ДЭ.					**Цена, руб., с НДС –**
		ПД – 200			200		1800	900 x 2035	258	**126000**
					Расход пара, кг/ч – 220.					
		ПД – 450			450		3500	1100 x 2515	366	**146400**
					Расход пара, кг/ч – 495.					
5.	**Аквадистиллятор**	**ДЭ-10** 94 5243	ТУ64-1--308-84	ЗАО "Электромедоборудование", г. Санкт--Петербург	10	7,8	200	362 x 630 x 512	35	**Цена, руб., с НДС –** **10730** (модель 789)
					Напряжение сети, В – 220.					
					***Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.Н02414** действует до 12 02 2004г*					
6.	То же	**ДЭ-25** 94 5243	ТУ64-1--2718-78	то же	25	18	350	685 x 382 x 460	45	**Цена, руб., с НДС –** **13660** (модель 784)
					Напряжение сети, В – 220/300.					
					***Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ04.Н02413** действует до 12 02 2004г*					
7.	"	**ДЭ-4-02 «ЭМО»** 94 5243	**ТУ 9452-007-33142130-2000**	"	4	3,0	160	360 x 220 x 660	14	**Цена, руб., с НДС –** **7330** (модель 737)
					Напряжение сети, В – 220/380.					
					***Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ03.Н05056** действует до 21 04 2004г*					

№ п/п	Код оборудования	Наименование и краткая техническая характеристика	Тип, марка оборудования	ГОСТ, нормаль, ТУ или каталог	Завод-изготовитель	Основные параметры и размеры				Масса единицы оборудования, кг	Цена единицы оборудования руб.	Гарант. срок службы, год	Примечание
						Номинальная мощность, кВт	Напряжение сети, В	Количество производимой очищенной воды, дм^3/час	Габаритные размеры, мм				
1	2	3	4	5	6	7а	7б	7в	7г	8	9	10	11
8		Аквадистиллятор	ДЭ-4-3		ОАО "Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов"	3,5	220	4	670х320х315	23	7400		
9.		То же	ДЭ-10-2		то же	9	220	10	845х445х250	30	10800		
10.		"	ДЭ-25-2		"	20	380	25	1150х700х350	46	13900		
11.		"	ДЭ-60		"	48	380	60	1725х660х600	142	45970		

Род тока - переменный, 50 Гц

Аквадистилляторы предназначены для производства очищенной воды в аптеках, больницах, лабораториях и других медицинских учреждениях. Качество производимой очищенной воды соответствует требованиям статьи ФС 42-2619-89 ГФ XI издания, при условии соответствия исходной воды ГОСТ

В случае несоответствия исходная вода должна иметь предварительную очистку.

Аквадистилляторы наряду с медицинским назначением имеют широкое общехозяйственное применение в пищевой, транспортной, химической и прочих отраслях промышленности, где требуется получение дистиллированной воды по ГОСТ 6709-72.

ПРИМЕЧАНИЯ: По согласованию с заказчиком завод комплектует аквадистилляторы сборниками объемом 25, 50, 100, 250 и 500 литров, которые обеспечивают длительное сохранение очищенной воды удобный и тарированный разбор воды, а также имеют возможность подключения к цепи управления дистиллятора для регулирования уровня воды в сборнике. (Марки водосборников: С-25, С-50, С-100, С-250, С-500)

№ п/п	Код оборудования	Наименование и краткая техническая характеристика	Тип, марка оборудования	ГОСТ, нормаль, ТУ или каталог	Завод-изготовитель.	Основные параметры и размеры Техническая характеристика	Масса единицы оборудования, кг	Цена единицы оборудования руб.	Гарант. срок службы, год	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	944I2I	Весы технические аптечные	ВА-4М		ЗАО «НТМИЗ», г. Нижний Тагил	Диапазон измерений 0,I ... I кг Чувствительность и непостоянство показаний без нагрузки 25 мг. Применяются для взвешивания медикаментов, химикатов и других материалов в аптеках и лабораториях.		I397		
I3.	944I2I	Весы для сыпучих материалов	ВСМ-I	ТУ64-I-3849-84	то же	Диапазон измерений 0,02 ... I г	50	233,75 296,00		(комплект I) (комплект 2)
I4.	944I2I	То же	ВСМ-5	то же	"	Диапазон измерений 0,I ... 5 г	60	233,75 296,00		(комплект I) (комплект 2)
I5.	944I2I	"	ВСМ-20	"	"	Диапазон измерений I ... 20 г	70	247,50 3I6,00		(комплект I) (комплект 2)
I6.	944I2I	"	ВСМ-I00	"	"	Диапазон измерений 5 ... I00 г	I20	268,00 345,00		(комплект I) (комплект 2)
						Весы предназначены для измерения массы преимущественно порошкообразных лекарственных веществ и их смесей. Применяются в аптеках и контрольно-аналитических лабораториях.				

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Шкаф сушильно-стерилизационный	ШС -80п 945241	ТУ64-I--909-80	ОАО "Казанский завод мед-аппаратуры", г.Казань	Предназначен для сушки и суховоздушной стерилизации стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента. Размеры рабочей камеры, мм 400x403x500 Объем рабочей камеры, л 80 Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, °С от 50 до 200 Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры, °С ± 2 Электропитание от сети однофазного переменного тока: напряжением, В 220 частота, Гц 50 Потребляемая мощность,кВт 2,2 Габаритные размеры, мм 695x650xI580	I05	Цена - 8500 руб.
2.	Шкаф сушильный вакуумный	ШСВ-45к 945241	ТУ64-I--907-77	то же	Предназначен для сушки биологических, химических и др. веществ, свойства которых не позволяют подвергать их нагреву до высокой температуры без разрежения. Электропитание от сети однофазного переменчого тока: напряжение, В 220 частота, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт 0,85 Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, °С 40-200 Основаная погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры, °С ± 2 Остаточное давление, мм рт.ст. 40 Время нагрева рабочей камеры шкафа до максимальной температуры, мин. I00 Габаритные размеры, мм I3I0x6I0xI820 Климатическое исполнение УХЛ4.2	I65	Цена - 58600 руб.

№ п/п	Наименование оборудования, изделия	Тип, марка. Код по ОКП	ГОСТ или ТУ	Завод-изготовитель	Технические характеристики	Масса, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Устройство термостатирующее	УТ-40М 945241	ТУ64-1-2307-82	ОАО"Казанский завод медаппаратуры", г.Казань	Предназначен для поддержания температуры +37°С в рабочей зоне помещения. Электропитание от трехфазной сети переменного тока: напряжение, В — 380-220 частота, Гц — 50 Потребляемая мощность, кВт, не более — 4,6 Точность поддержания температуры воздуха в помещении, °С — ± 0,5 Габаритные размеры, мм: пульт управления — 300х245х112 устройство нагревательное — 500х150х100 Комплектность: блок терморегулирующий (1 шт.); нагреватель мощностью 250 Вт (5 шт.), нагреватель мощностью 500 Вт (4 шт.), нагреватель мощностью 1050 Вт (1 шт.).	25	Цена - 6864 руб. в т.ч. НДС
4.	Термостат водяной комбинированный	ТК-37		то же	Предназначен для выращивания в нем культур микробов на соответствующих питательных средах при температурах 28 и 37°С. Поддержание и автоматическая регулировка в рабочей камере фиксированных температур, °С — 28 и 37 Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры, °С: в стационарных лабораториях — ± 0,5 на передвижных автолабораториях — ± 1 Предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры от температуры в опорной точке, °С — ± 1 Термостат работает: - от сети однофазного переменного тока напряжение, В — 220 частота, Гц — 50 - от источника постоянного тока напряжение, В — 12-9 - от керосинового нагревателя Потребляемая мощность,: от сети переменного тока, ВА — 286 от источника постоянного тока, Вт — 143 Размеры рабочей камеры, мм — 400х260х250 Габаритные размеры, мм — 460х420х1045	50	Цена - 17100 руб. в т.ч. НДС

14. Адреса заводов – изготовителей.

№ п/п	Наименование завода	Краткое наименование завода	Адрес завод	Код города	Телефон, факс.
1	ООО «СТОМЭЛ-К»		394033, г Воронеж ул Витрука 13	0732	23-33-05, 56-24-09 факс 23-24-46
2	ОАО «Научно-исследовательское предприятие общего машиностроения"	ОАО НИПОМ	606007, г Дзержинск, Нижегородской обл , ул Зеленая, 10	8313	344-629, 287-555, 287-171 факс 331-136
3	ОАО «Завод медицинского оборудования»	ОАО «ДЗМО»	607033, Нижегородская обл , Выксунский р-он, п Досчатое	83177	3-46-30, 3-01-63 факс 3-46-30, 7-83-44
			Представительства: г Москва ЗАО «Медэкс-Интер» - тел (095) 189-06-22, 189-04-07, 775-63-65 г Москва ЗАО «Компания Киль-М» - тел (095) 267-09-16, 267-17-07, 261-36-63		
4	«Гродненский завод торгового машиностроения»		Республика Беларусь, 230030, г Гродно, ул Тимирязева, 16	[375](152)	77-13-18, 72-00-30 факс 47-12-18 77-14-33
5	ЗАО «Завод электромедицинской аппаратуры»	ЗАО «Завод ЭМА»	620151, г Екатеринбург ВИЗ-бульвар 13	3432	71-61-06 факс 71-46-92, 46-39-21
6	ОАО Уральский приборостроительный завод	ОАО «УПЗ»	620151, г Екатеринбург ул Горького,17	3432	59-94-52, 59-94-54 факс 71-25-66, 71-59-14
7	ОАО ПроМеТеИ-плюс»		389780, г Елец, Липецкая обл , ул Заводская, 2	07467	41-226, 42-335, 28-467 факс 20-312, 42-267
8	Научно-производственное медико-техническое объединение «Кредо»	НПМТО «Кредо»	456206 г Златоуст Челябинская обл ул Аносова, 177	35136	3-14-03, 3-65-18 факс 6-52-32
9	ООО «НейроСофт»		153003, г Иваново ул Парижской Коммуны, 16	0932	Тел /факс 41-30-15, 41-15-00, 30-40-0+++++8
10	ОАО «Казанский завод медицинской аппаратуры»		420030, г Казань, ул Набережная, 11	8432	Т /факс 55-33-84 54-94-63
11	ЗАО «Производственно-коммерческий центр «Кетгут»	ЗАО «ПКЦ «Кетгут»	350000, г Краснодар, ул Красноармейская 58	8612	62-53-44 Т /факс 62-56-66, 62-62-82
12	ОАО «Краснодарский ЗИП»		350010, г Краснодар, ул Зиповская 5	8612	523-109, 523-229 факс 523-515
13	ФГУП Курский завод «Маяк»		305016 г Курск ул 50 лет Октября 8	07122	2-66-15, 2-15-74, 2-58-11 факс 2-06-90
14	ЗАО «ВНИИМП-ВИТА»		127422 г Москва ул Тимирязева 1	095	Т /ф 211-1733 211-4638, 979-6990
15	ОАО «ГИПРОНИИЗДРАВ»		117246 г Москва, Научный проезд, д 12	095	120-93-81 факс 120-73-77
16	ЗАО «АМИКО»		117279, г Москва, а/я 50	095	742-941-60 факс 742-94-14

Адреса заводов – изготовителей.

№ п/п	Наименование завода	Краткое наименование завода	Адрес завод	Код города	Телефон, факс.
17	ОАО Завод электронной медицинской аппаратуры «ЭМА»	Завод «ЭМА»	109028, г Москва, пер Большой Николоворобинский, д 9/11	095	917-71-55, 917-13-54 факс 917-90-55 916-01-48
18	ОАО «Мосрентген»		142711, п/о Мосрентген, Московская обл	095	339-23-88, 339-11-44 факс 339-67-03
19	ЗАО «Нижнетагильский Медико-инструментальный завод»	ЗАО «НТМИЗ»	622001, г Нижний Тагил, ул Ломоносова, 49	3435	25-62-56, 25-75-77 факс 25-02-01, 25-73-56
20	ОАО «ПКП «Респиратор»		142602, Московская обл , г Орехово-Зуево, ул Гагарина, 1	0964	13-16-41, 13-16-69 факс 12-76-18, 12-50-82
21	Государственный Рязанский приборный завод	ГРПЗ	390000, г Рязань, ул Каляева, 32	0912	Факс 21-61-47
22	ОАО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма»	ОАО «Плазма»	390023, г Рязань, ул Циолковского, д 24	0912	44-90-74, 44-90-62 факс 44-06-81
23	Научно-исследовательская производственная компания «Электрон»	НИПК «Электрон»	198188, г Санкт-Петербург, а/я 12	812	325-02-02 факс 325-04-44
24	ОАО «Красногвардеец»		197376, г Санкт-Петербург, ул Инструментальная, д 3	812	234-73-76, 234-72-52 факс 234-36-91, 234-96-66
25	ЗАО «Электромедоборудование»		198095, г Санкт-Петербург, ул Шевцова, 41	812	Тел /факс 252-52-03, 252-14-23, 252-18-86
26	ООО «СП Минимакс»		197376, г Санкт-Петербург, ул Льва Толстого, 7	812	234-95-46, 234-38-95 факс 234-38-77
27	НПП «Буревестник», ОАО		195112, г Санкт-Петербург, Малоохтинский пр , 68	812	528-72-72 528-02-69 факс 528-66-33
28	ОАО «Медоборудование»		430904, Республика Мордовия, г Саранск, п/оЯлга	8342	33-83-59 33-87-90 факс 32-15-64
29	АО «Утес»		432002, г Ульяновск, ул Крымова, 14	8422	Т /ф 34-46-12, 39-20-94, 41-66-51
30	ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им Н С Артемова»		392620, г Тамбов, ул Советская, 51	0752	72-77-73, 79-37-80 факс 71-1—19, 72-37-57
31	ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»		625035, г Тюмень ул Республики, 205	3452	22-84-55, 21-23-77 факс 21-19-88, 21-07-77
			Представительство Холдинг «МЕДСНАБ-Групп» ООО «ВЛАДМЕДПОСТАВКА» - 105264, г Москва ул Верхняя Первомайская д 43 Тел /факс (095) 367-50-54, 163-81-90 **786-76-86 (многоканальный).**		

gost.e-ecolog.ru