

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

СЧЕТЧИКИ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 21634—76

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 539.1.074.22.08 : 006.354 Группа Ф27

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СЧЕТЧИКИ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ
Основные размеры
Gas-discharge counters. Basic dimensions

ГОСТ 21634—76*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 марта 1976 г. № 638 срок введения установлен
Проверен в 1982 г.

с 01.07.77


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндрические и торцевые газоразрядные счетчики с наружными выводами электродов, оформленных в виде штырьков цоколей или выводов-колпачков, и устанавливает их основные размеры.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Присоединительные размеры газоразрядных счетчиков должны соответствовать выводу-колпачку ВКЦ-1 по ГОСТ 21057—75 (черт. 1—4) и расположению штырьков РШ5—1, РШ9 по ГОСТ 7842—71 (черт. 5 и 6).

3. Основные размеры цилиндрических газоразрядных счетчиков должны соответствовать указанным на черт. 1—3 и в табл. 1.

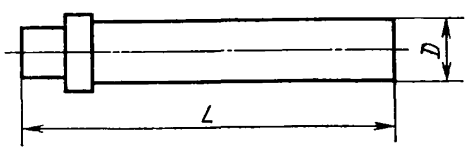


Черт. 1

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**


★

** Переиздание (февраль 1987 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июле 1982 г. (ИУС 11—82)*

© Издательство стандартов, 1987

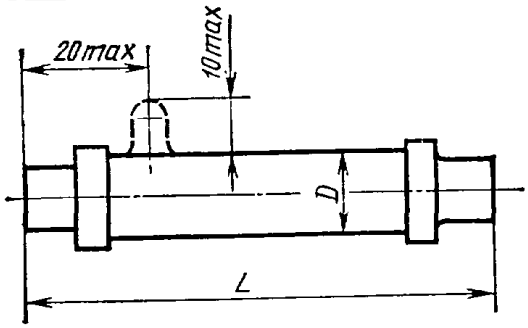

Черт. 2

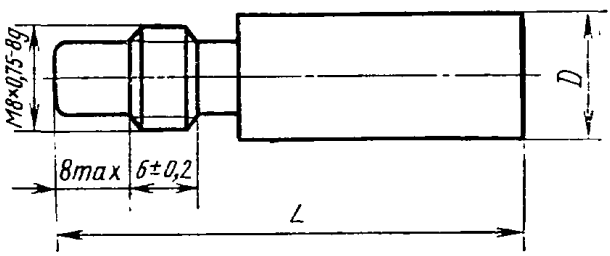

Черт. 3


мм

Таблица 1


D		L			Номера чертежей
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
			металл	стекло	
(4); 6; 8; 10	±1,0	30; 40; 50	—1,6	—3,0	1; 2
		56; 63; 71; 80	—2,0	—3,0	
		90; 100	—2,2	—4,0	
12; 16; 18; 20; (22); 25; 30	±1,5	56; 63; 71; 80	—2,0	—3,0	1; 2; 3
		90; 95; 100; 112; 118	—2,2	—4,0	
		125; 140; 150; 160	—2,4		
		180; 200; 212; 224; 250	—3,0	—5,0	
		315; 335; 355	—4,0	—6,0	
		400; 450; 500			
32; (35); 50; 60; 71; 100; 140	±2,5	160	—2,4	—4,0	
		200; 212; 224; 250	—3,0	—5,0	
		315; 335; 355	—4,0	—6,0	
		400; 450; 500			
		560; 630	—4,4		
		710; 800	—5,0		
		900; 1000	—5,4		

Примечание. Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

4. Основные размеры торцевых газоразрядных счетчиков должны соответствовать указанным на черт. 4, 5 и в табл. 2; на черт. 6 и в табл. 3.



Черт. 4




Черт. 5

Таблица 2

мм

D		L		Номера чертежей
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
10; 14	—1,1	20; 25; 30	±0,6	4
		40; 50	±0,8	
20; 25; 30	—1,3	63; 71; 80	±1,0	
40; 50	—1,6	100	±1,1	4; 5
63; 71; 80	—1,9	150	±1,2	
		200; 250	±1,5	
100	—2,2	300; 350	±1,7	
		400; 500	±2,0	

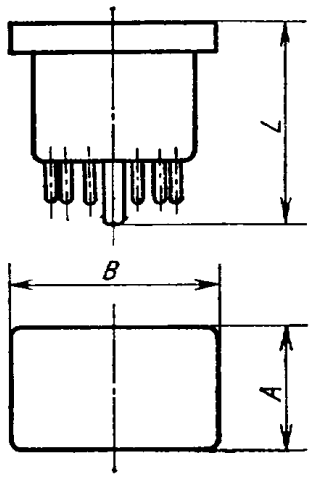

Черт. 6

Таблица 3

мм

A		*B*		*L*	
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
16	—1,1	16; 25	—1,1	16	±0,5
			—1,3	25	±0,6
25	—1,3	30; 40	—1,6	40; 50	±0,8
40	—1,6				
63	—1,9	63; 71	—1,9	63	±1,0
100	—2,2	100	—2,2	90; 100	±1,1

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *М. И. Максимова*
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 05.01.87 Подп. в печ. 31.03.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,22 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3.
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 160

gost.e-ecolog.ru